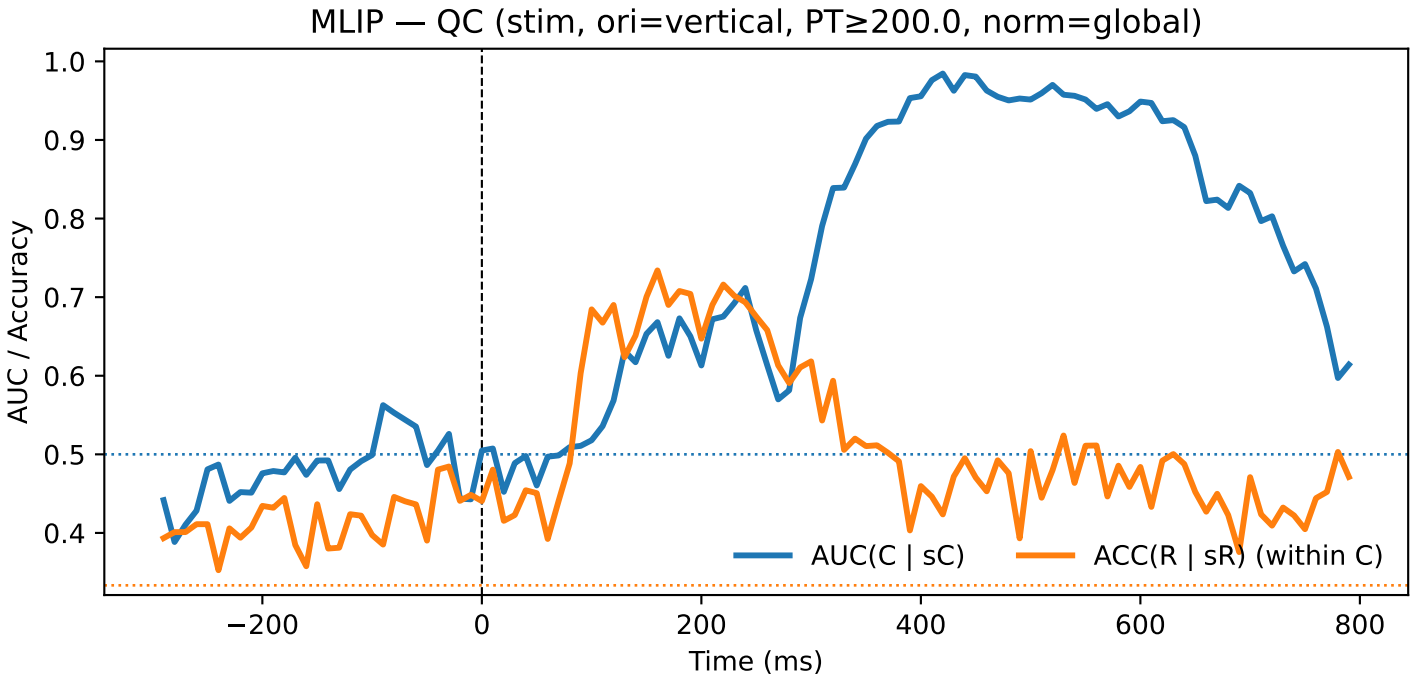
MLIP — QC (stim, ori=vertical, PT≥200.0, norm=global)
AUC / Accuracy
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
−200
0
200
400
600
800
Time (ms)
AUC(C | sC)
ACC(R | sR) (within C)