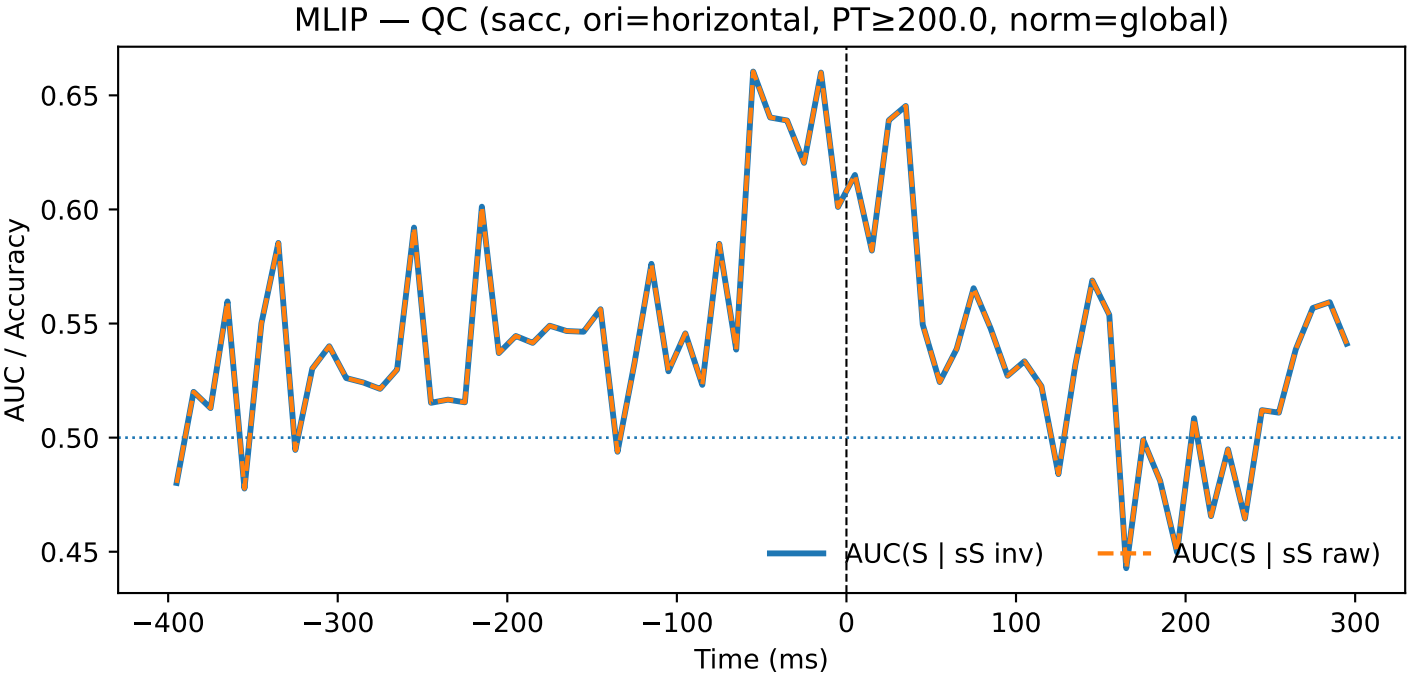
MLIP — QC (sacc, ori=horizontal, PT≥200.0, norm=global)
AUC / Accuracy
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300
Time (ms)
AUC(S | sS inv)
AUC(S | sS raw)