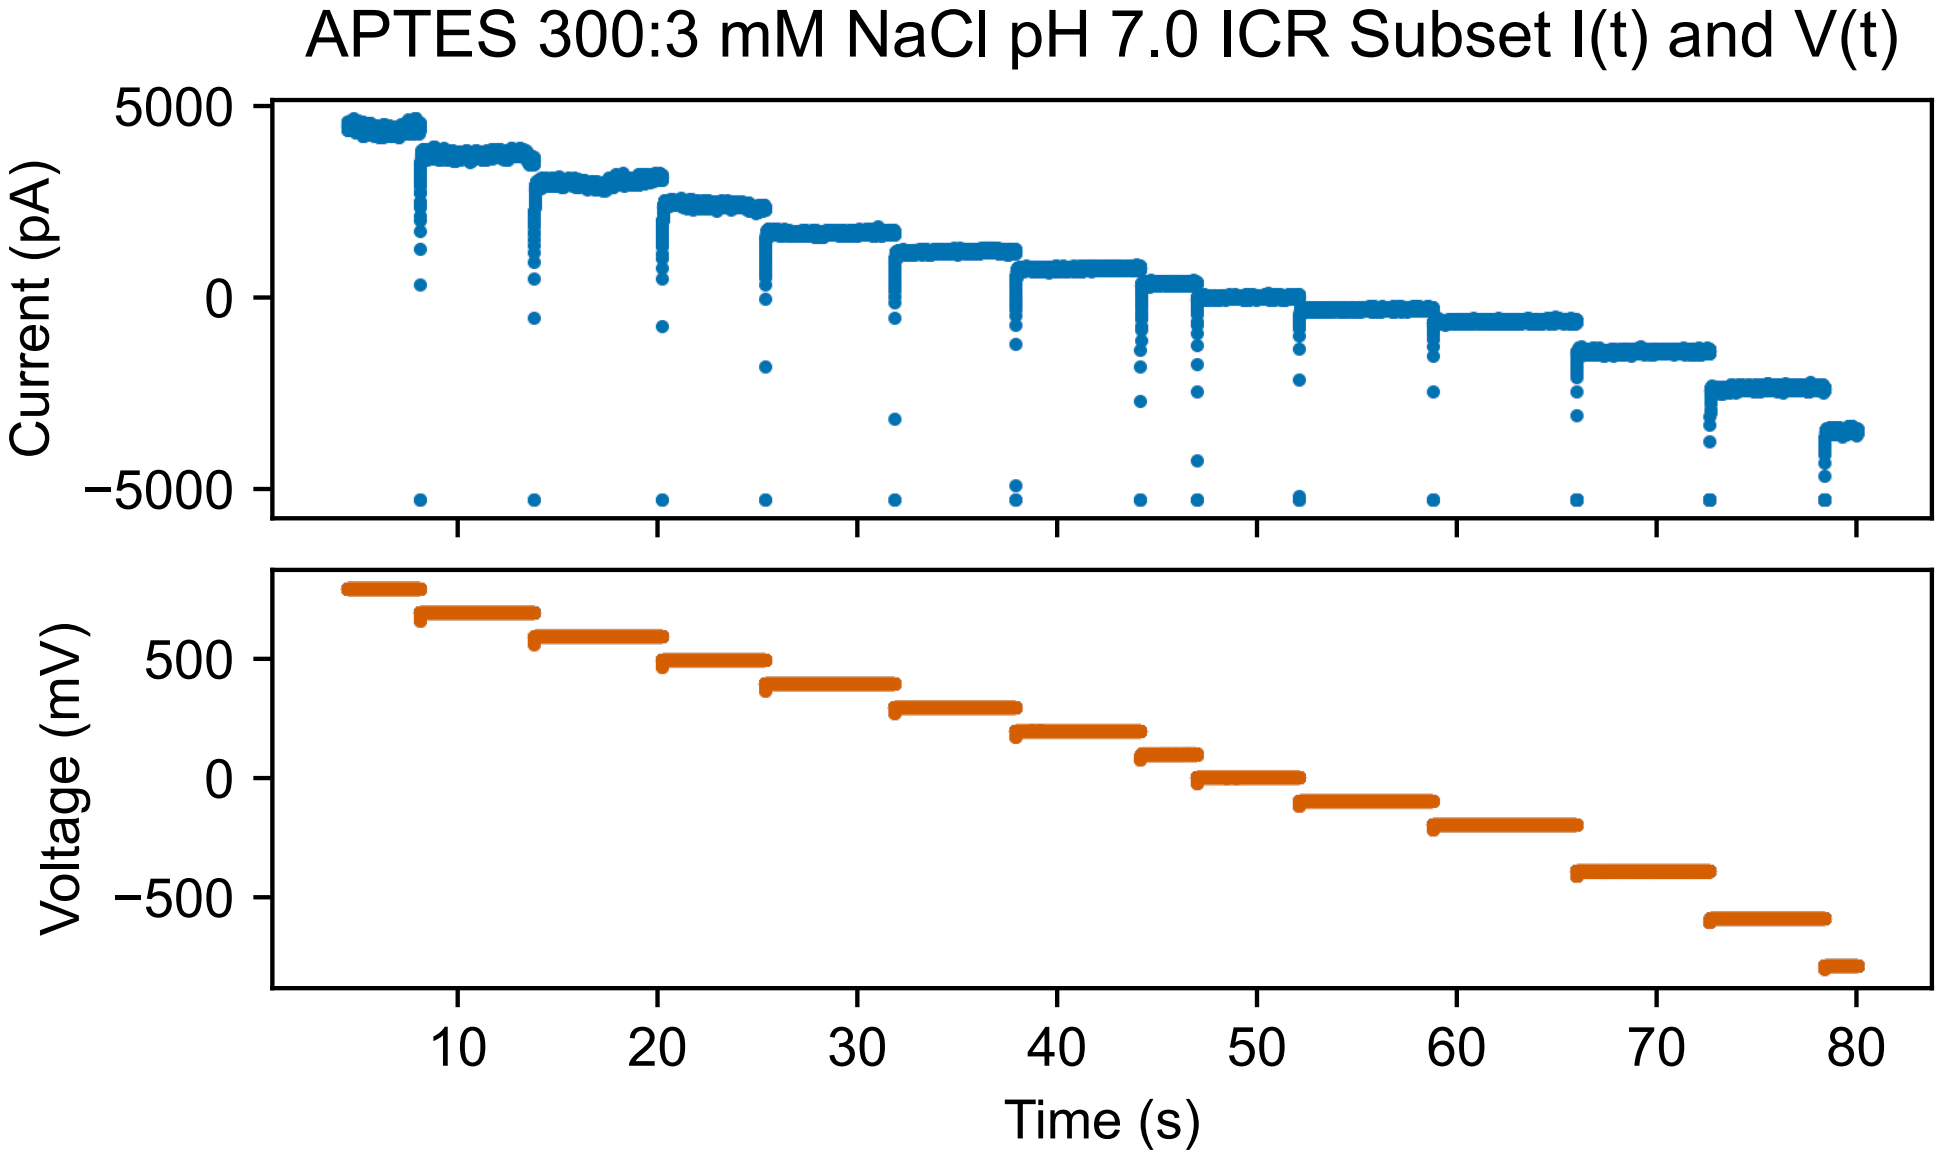
APTES 300:3 mM NaCl pH 7.0 ICR Subset I(t) and V(t)
Current (pA)
5000
0
−5000
Voltage (mV)
500
0
−500
10
20
30
40
50
60
70
80
Time (s)