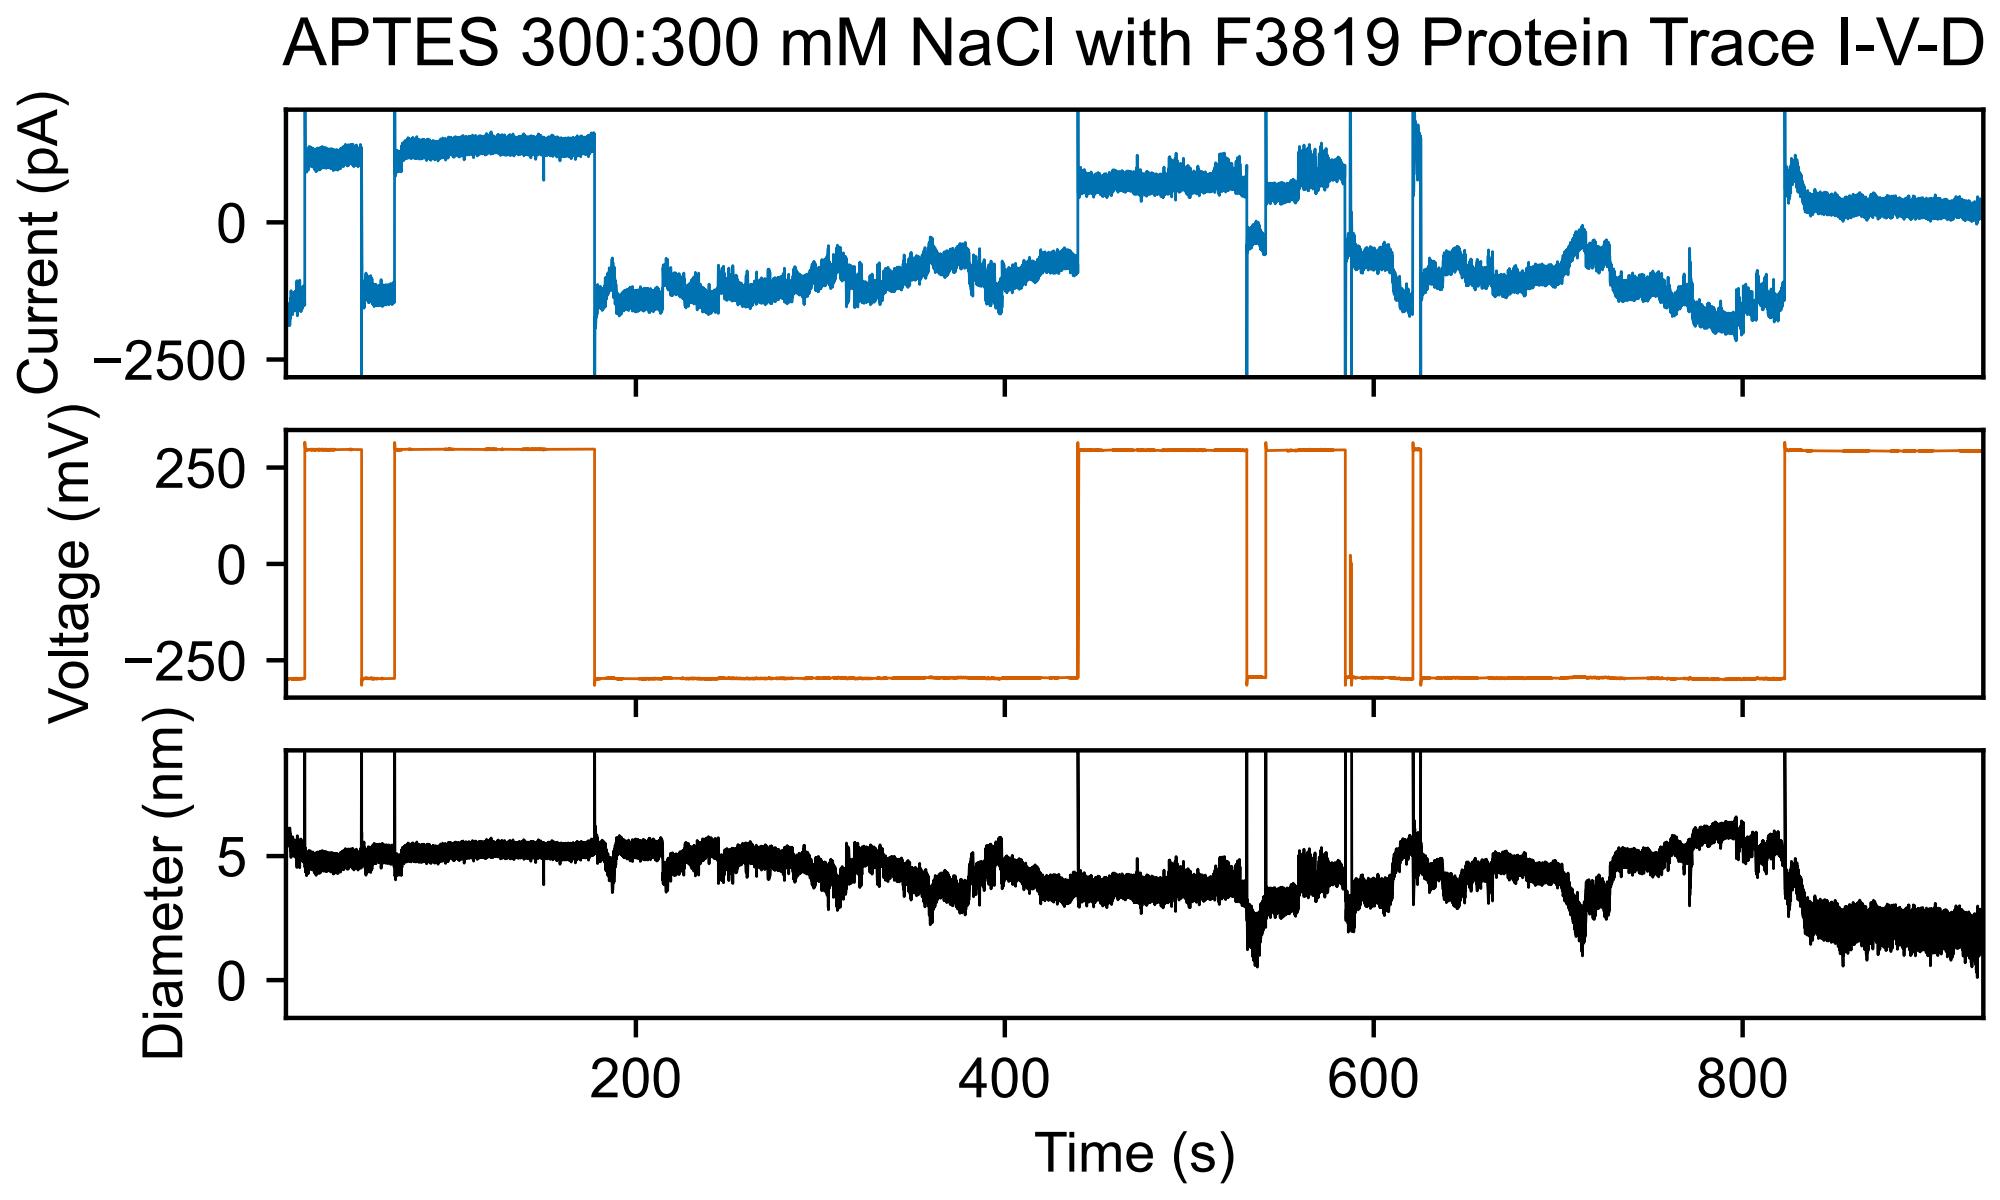

APTES 300:300 mM NaCl with F3819 Protein Trace I-V-D
Current (pA)
0
−2500
Voltage (mV)
250
0
−250
Diameter (nm)
5
0
200
400
600
800
Time (s)