



A) Señal de ECG Cruda Original (n01 - Canal 1, $f_s = 128$ Hz)

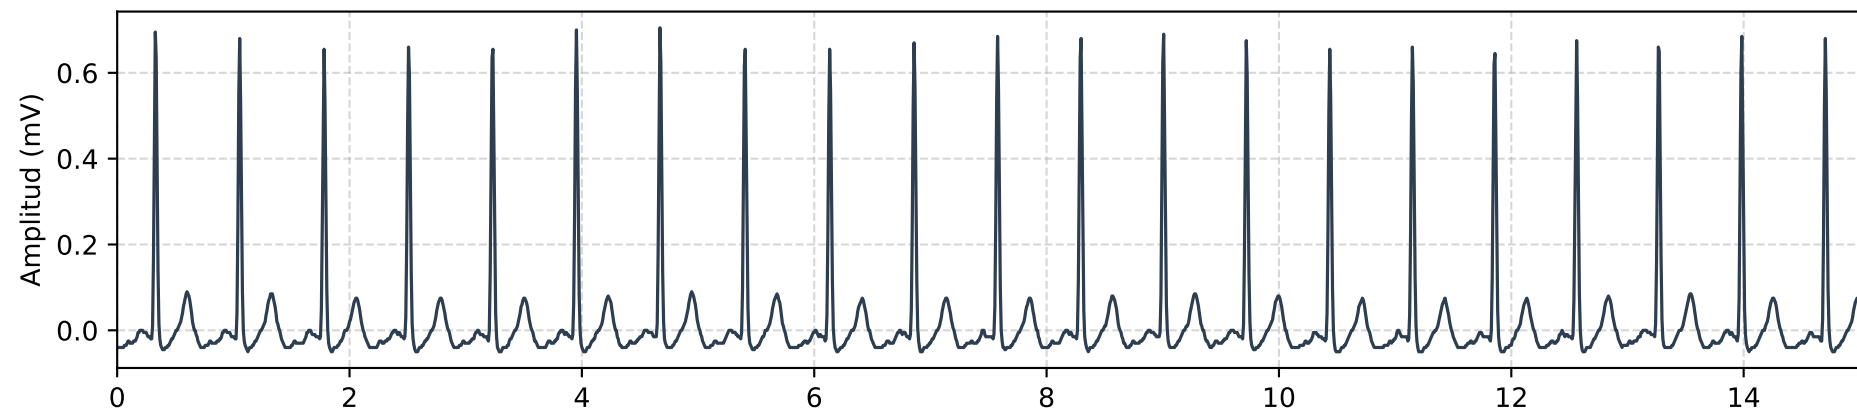

B) Señal Armonizada a $f_s = 128$ Hz y Detección de Latidos

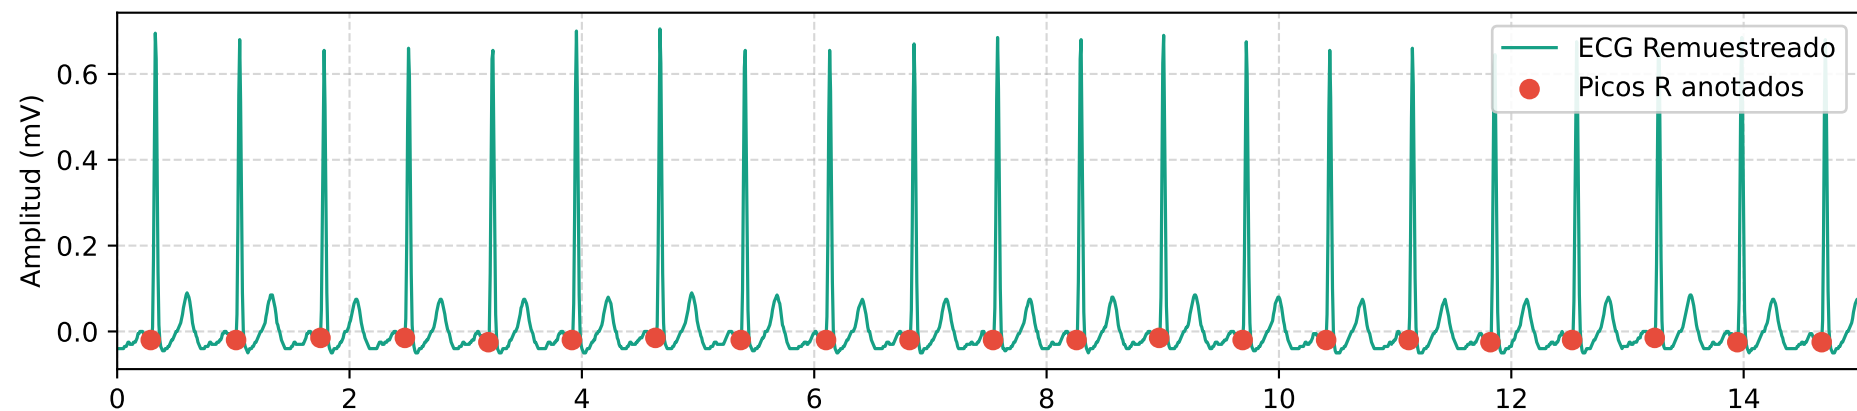

C) Ventana de Entrada del Clasificador (10s, Normalización Z-score)

