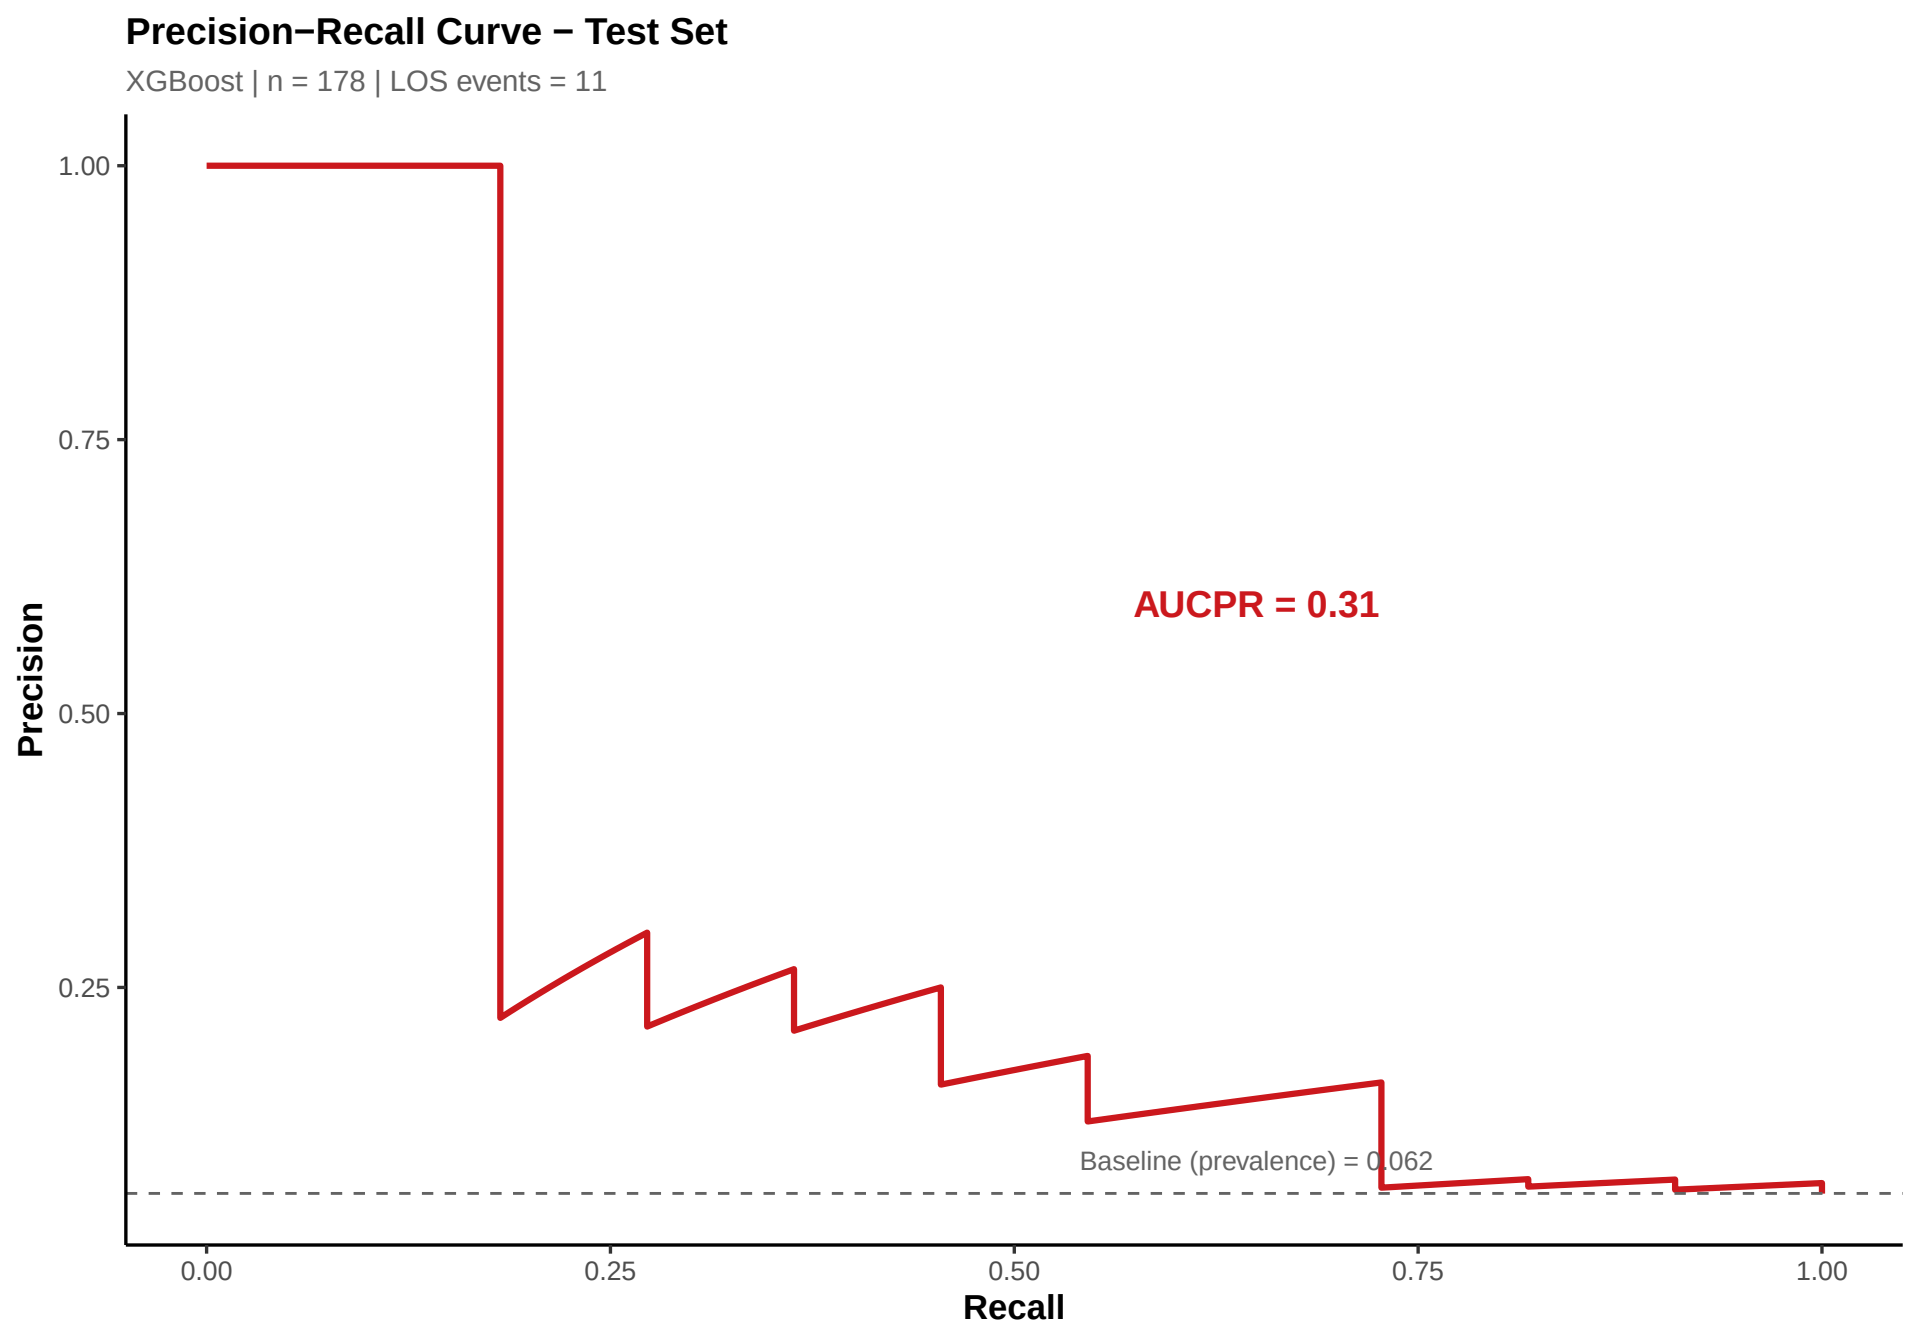
Precision−Recall Curve − Test Set
XGBoost | n = 178 | LOS events = 11
1.00
0.75
0.50
0.25
Precision
AUCPR = 0.31
Baseline (prevalence) = 0.062
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Recall