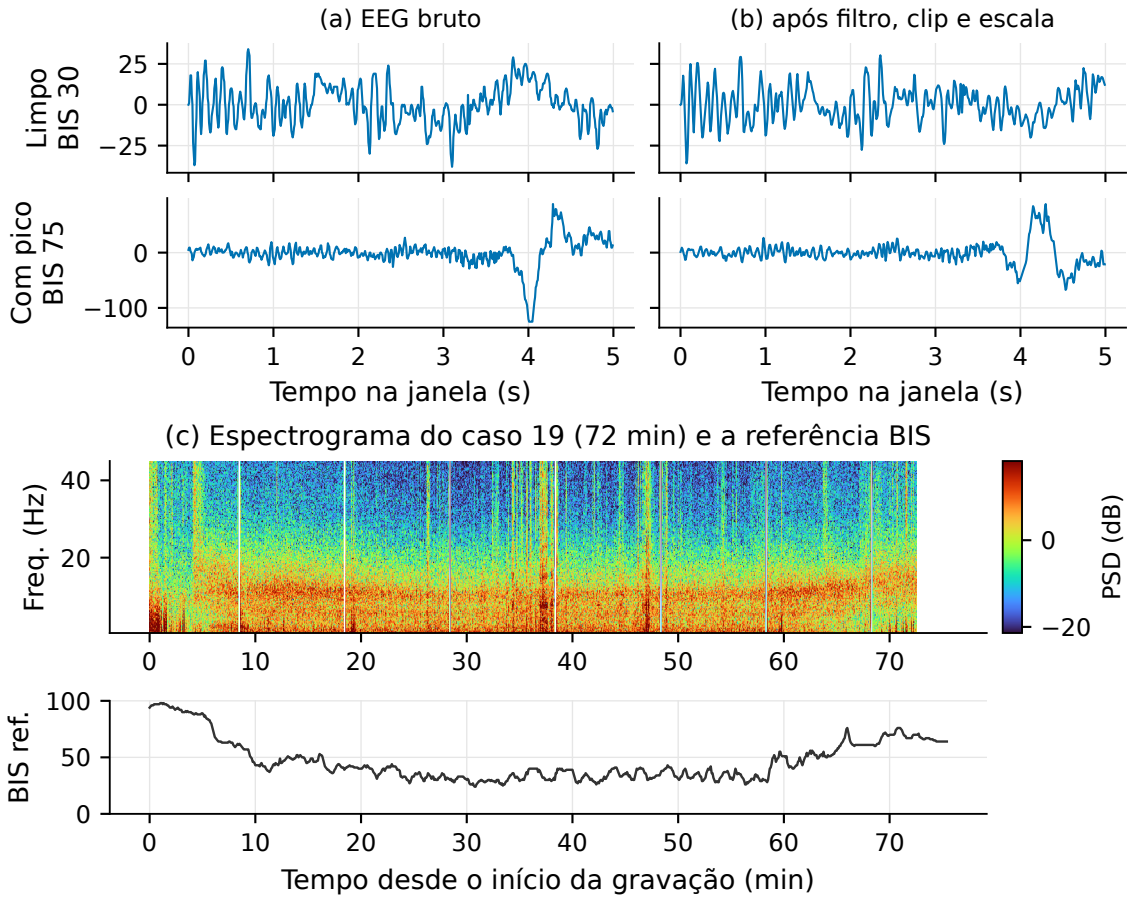

(a) EEG bruto
(b) após filtro, clip e escala
Limpo
BIS 30
Com pico
BIS 75
25
0
−25
−100
0
1
2
3
4
5
Tempo na janela (s)
(c) Espectrograma do caso 19 (72 min) e a referência BIS
Freq. (Hz)
40
20
PSD (dB)
−20
10
30
50
60
70
BIS ref.
100
50
Tempo desde o início da gravação (min)