


noise_amp: -130

Scope

FFT

Scope Plot

XY

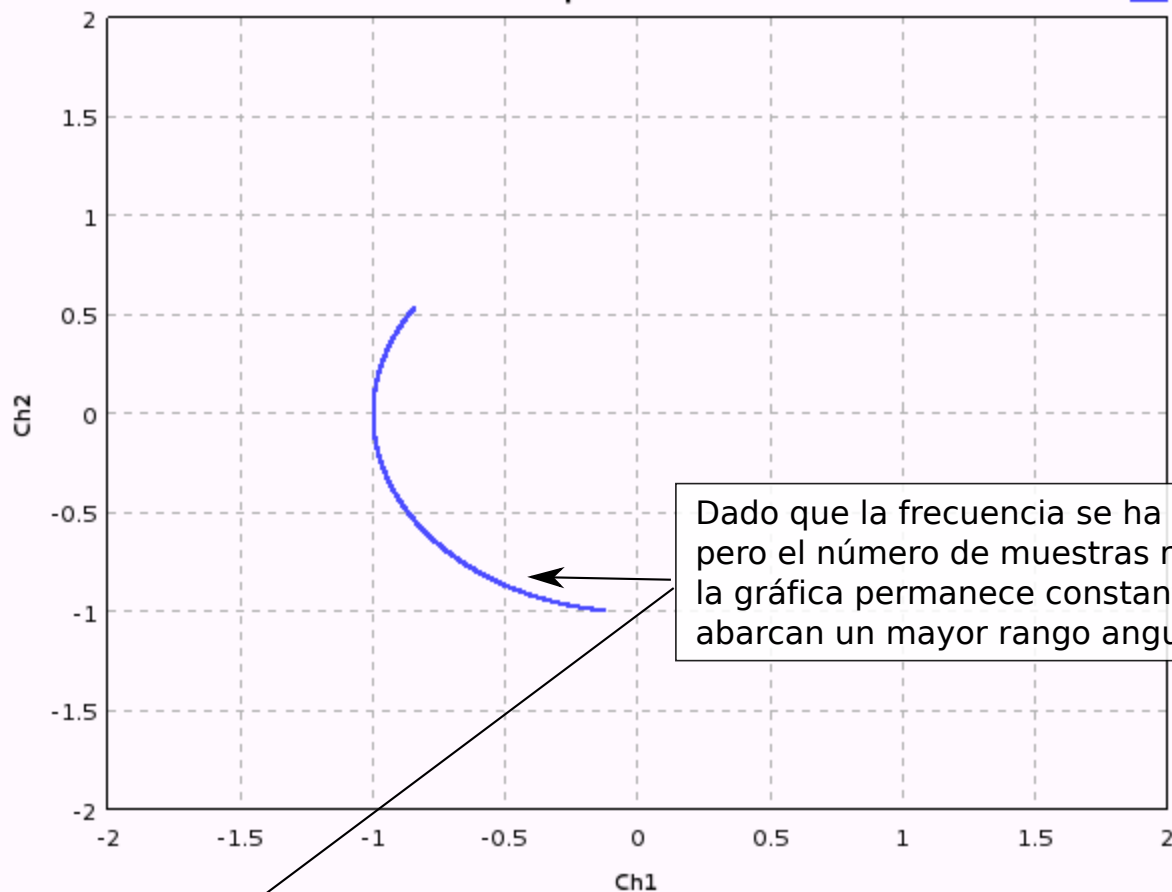

Dado que la frecuencia se ha incrementado, pero el número de muestras recogidas por la gráfica permanece constante, las muestras abarcan un mayor rango angular (arg)

☐ Persistence

Analog Alpha: 0.0994

Axes Options

X/Div:

+

-

Y/Div:

+

-

X Off:

+

-

Y Off:

+

-

☐ Autorange

Channel Options

XY

>

Channel

Ch 2

Marker:

Dot Med

Stop

Frequency: 10

Signal Amp: 1