



Intensität I = I<sub>0</sub> - Spektrum Hg - Spectralab

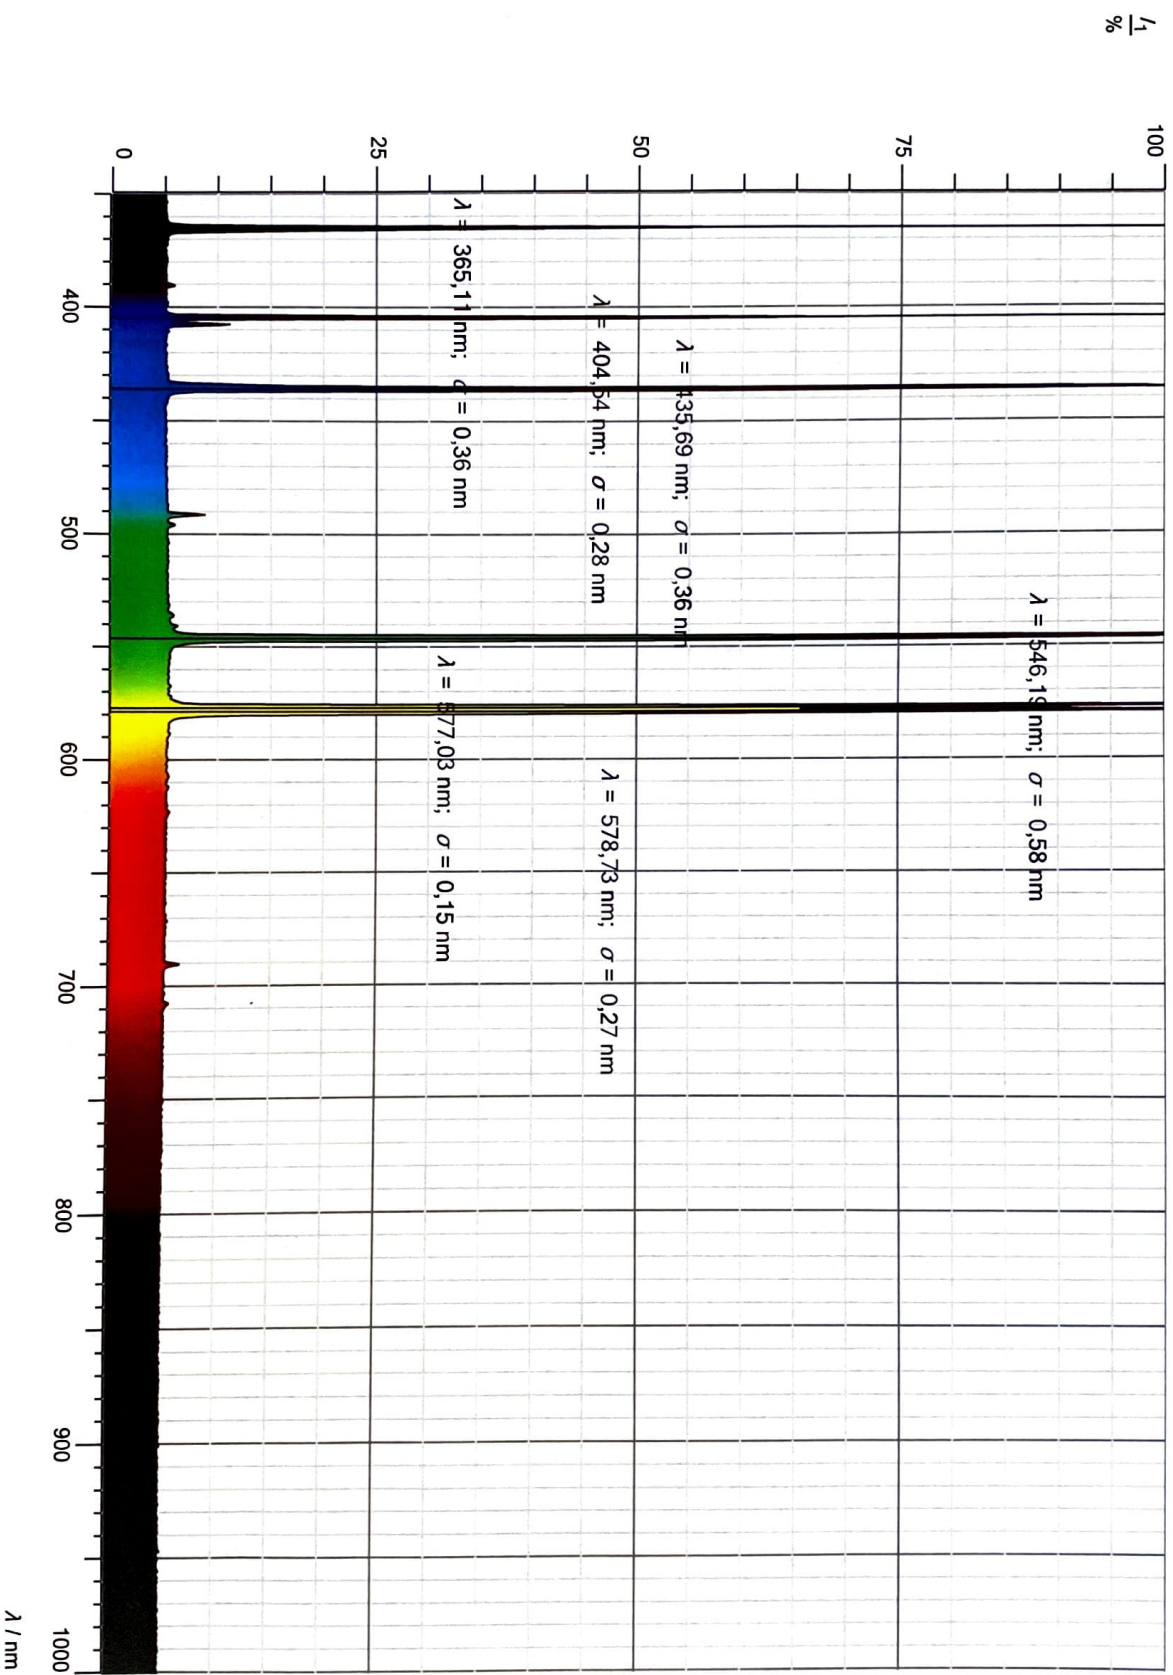


Intensität I = I-10 - Spectralab

# Spektrum Hg 2. Aufnahme

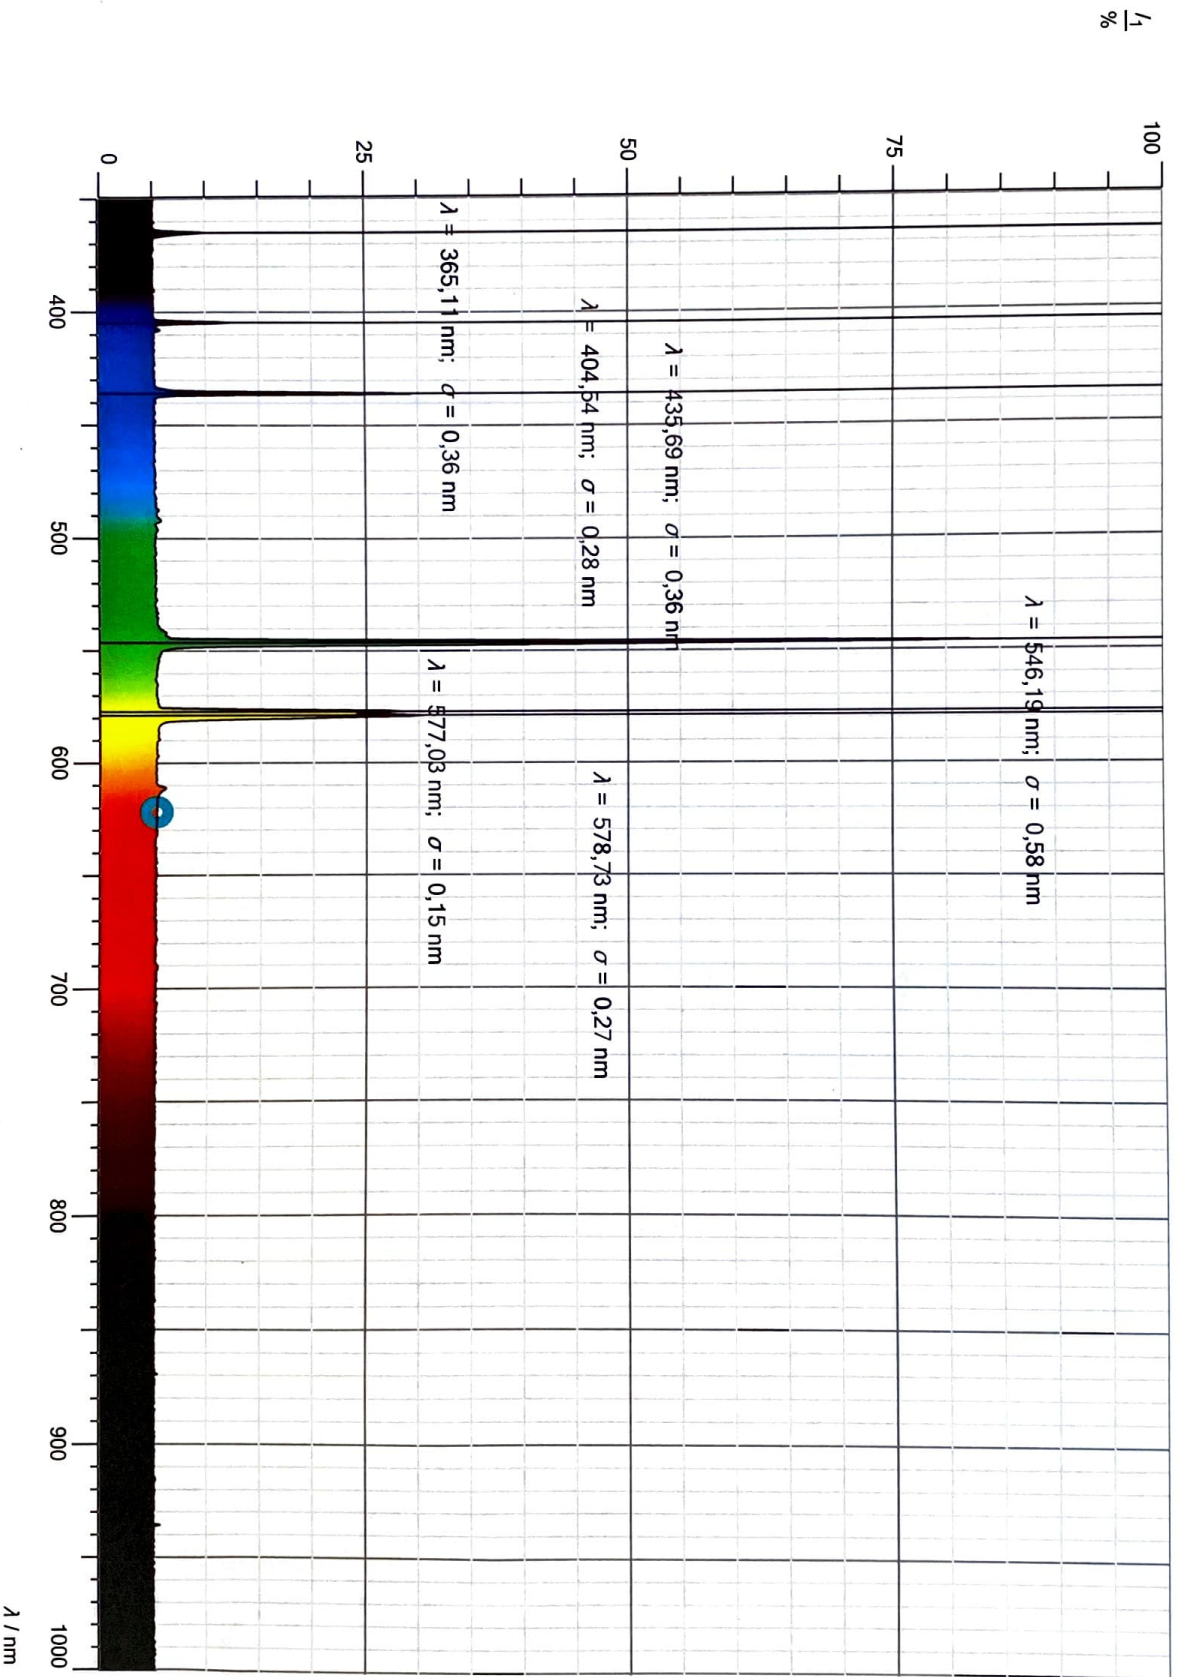

Intensität I1 = I-I0 - Spektrum Xenon ohne Filter - Spectralab

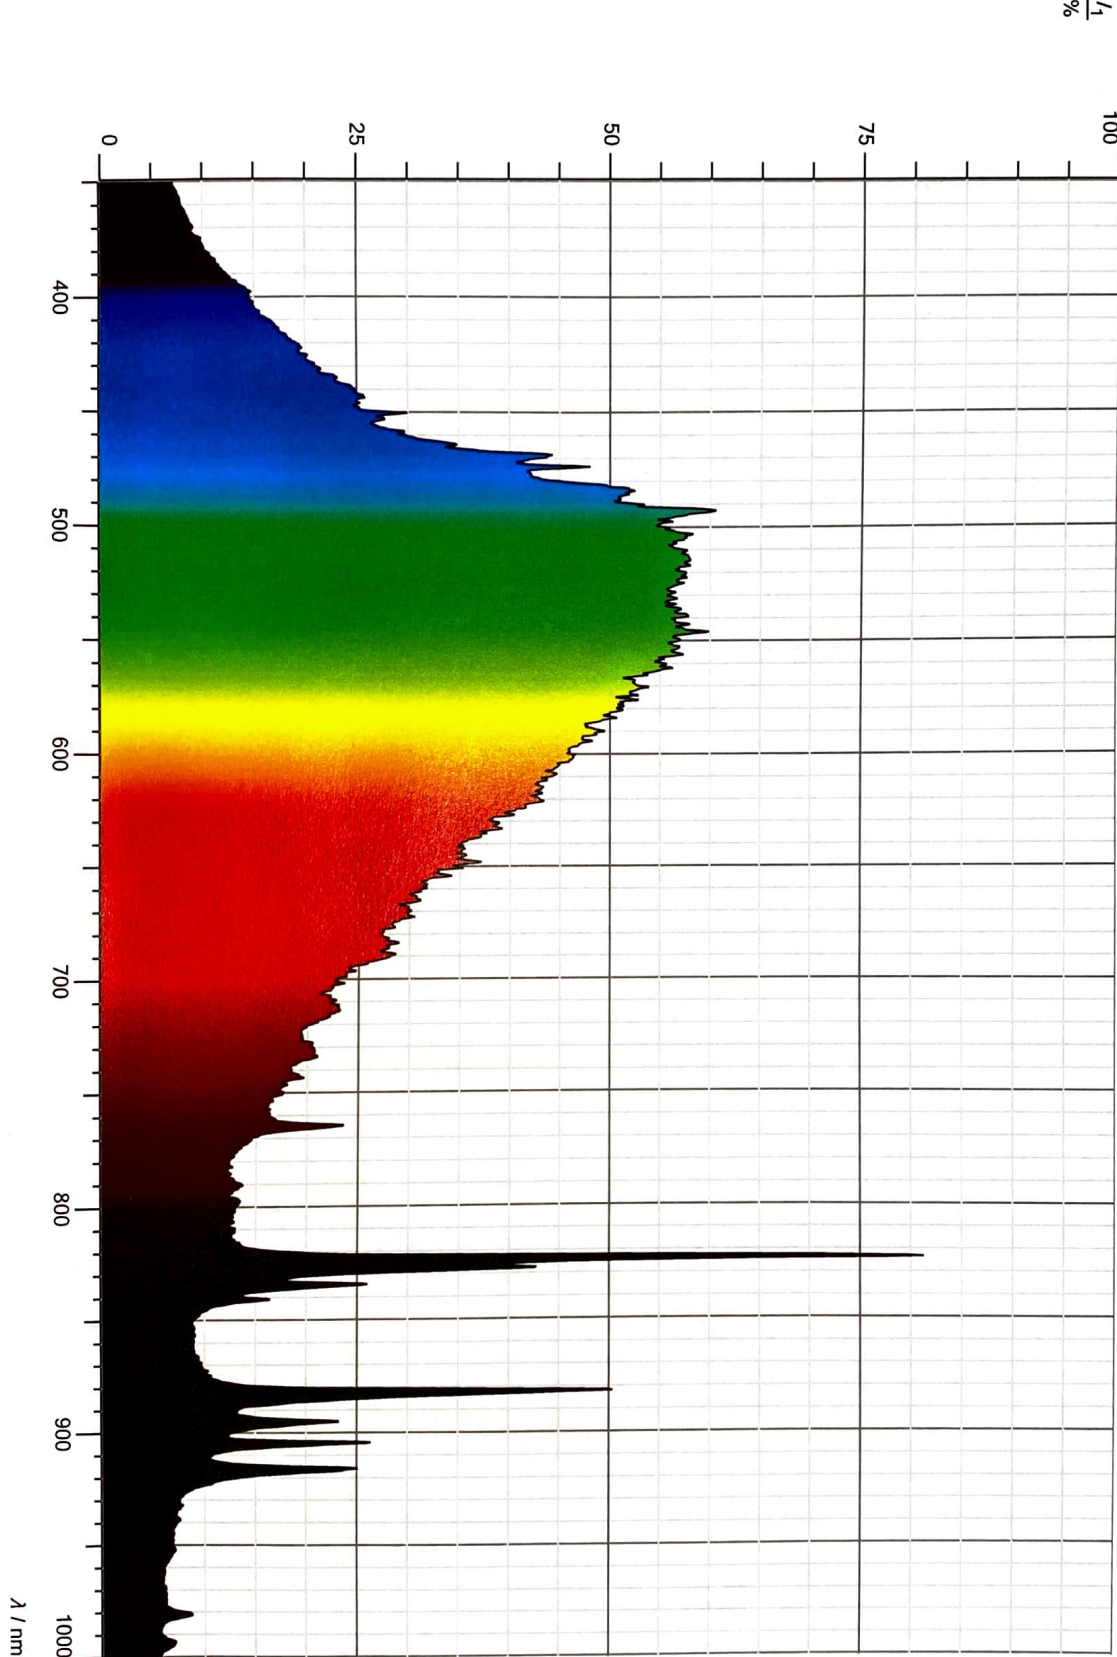



Intensität I1 = I-I0 - Xenon Spektrum Filter 1-5 SB - Spectralab

