

Reporte de Análisis de Células Cervicales

Sistema SiPakMed-AI

Fecha y Hora del Análisis: 2026-07-08 03:22:41

Paciente: Test User

ID de Paciente: 12345

1. Análisis de la Imagen

Nombre del Archivo	test.png
Dimensiones	100x100
Formato	PNG
Modo	N/A

2. Imágenes Analizadas


3. Resultados de Predicción



Modelo	Clase Predicha	Confianza (%)	Tipo de Modelo
MobileNetV2	Koilocitosis	85.50	Clásico
ResNet50	Koilocitosis	92.30	Clásico
EfficientNetB0	Células Intermedias	78.00	Clásico

Resumen del Análisis

Total de Modelos	3
Confianza Promedio	85.27%
Clase con Mayor Consenso	Koilocitosis
Votos para la Clase Principal	2 de 3

Distribución de Probabilidades

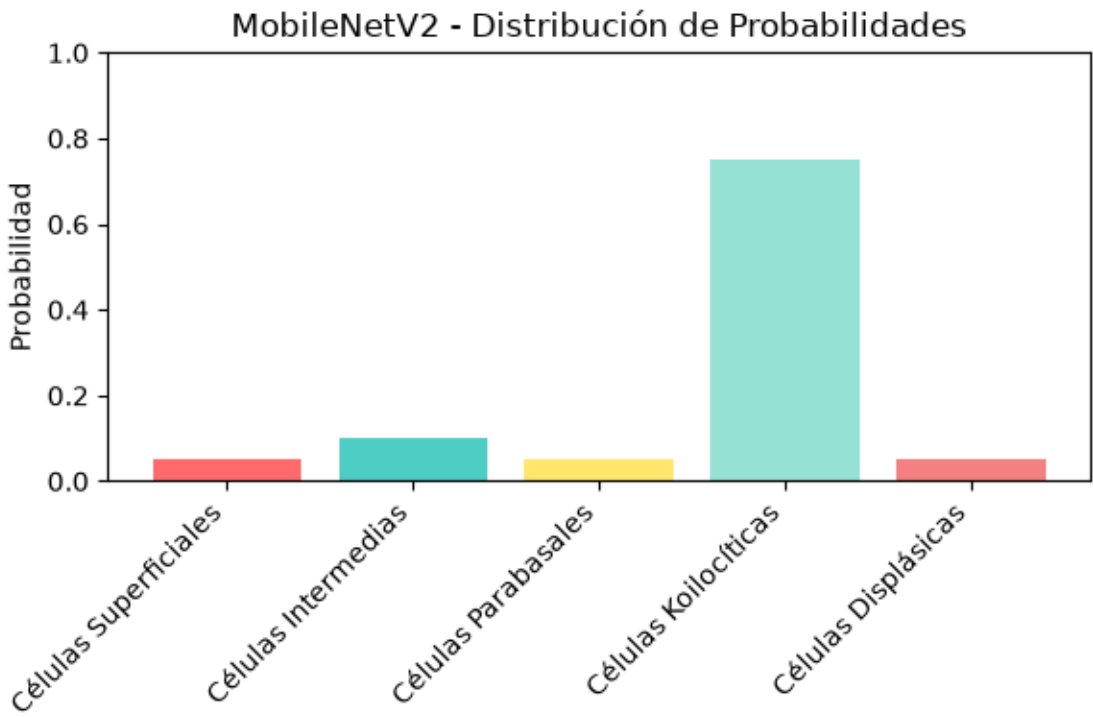

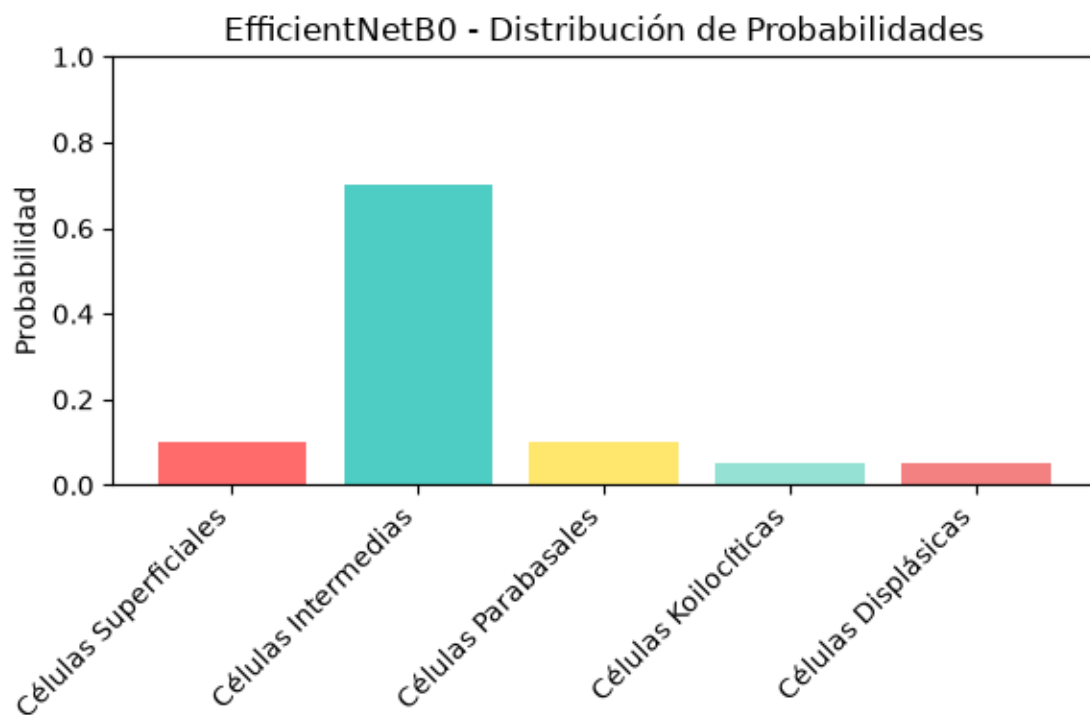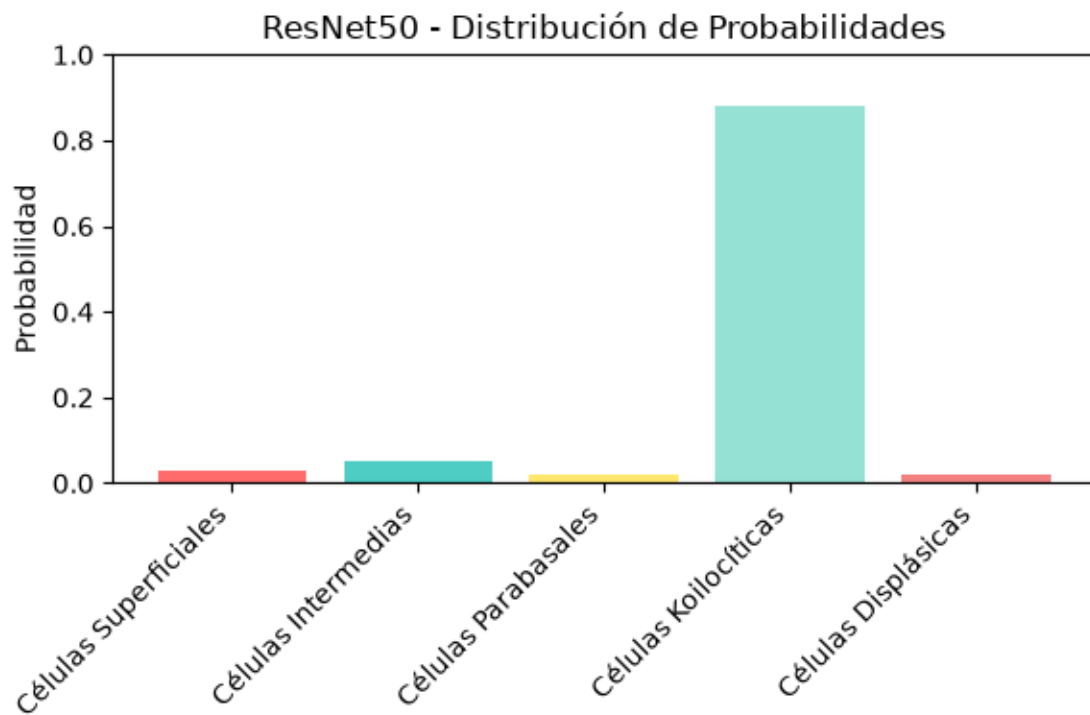

MobileNetV2:

• Células Superficiales: 5.00% • Células Intermedias: 10.00% • Células Parabasales: 5.00% • Células Koilocíticas: 75.00% • Células Displásicas: 5.00%


ResNet50:

• Células Superficiales: 3.00% • Células Intermedias: 5.00% • Células Parabasales: 2.00% • Células Koilocíticas: 88.00% • Células Displásicas: 2.00%

EfficientNetB0:

• Células Superficiales: 10.00% • Células Intermedias: 70.00% • Células Parabasales: 10.00% • Células Koilocíticas: 5.00% • Células Displásicas: 5.00%

Consenso entre Modelos

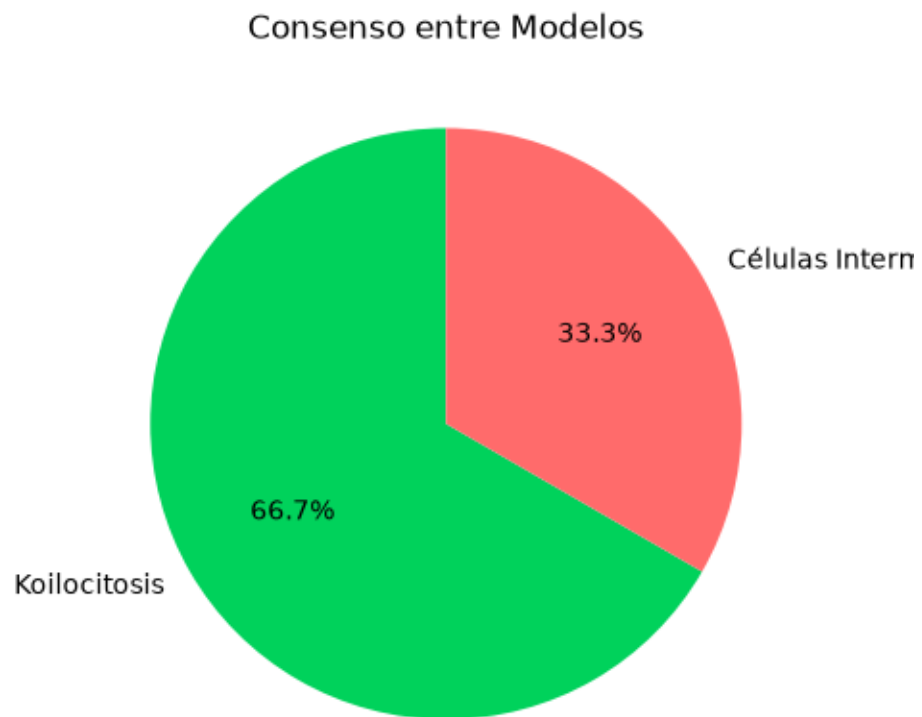

4. Interpretación y Información del Sistema

Modelos Disponibles	5 (3 clásicas + 2 híbridas)
Precisión del Sistema	84-93%
Clases de Células	5
Modo de Procesamiento	CPU/GPU