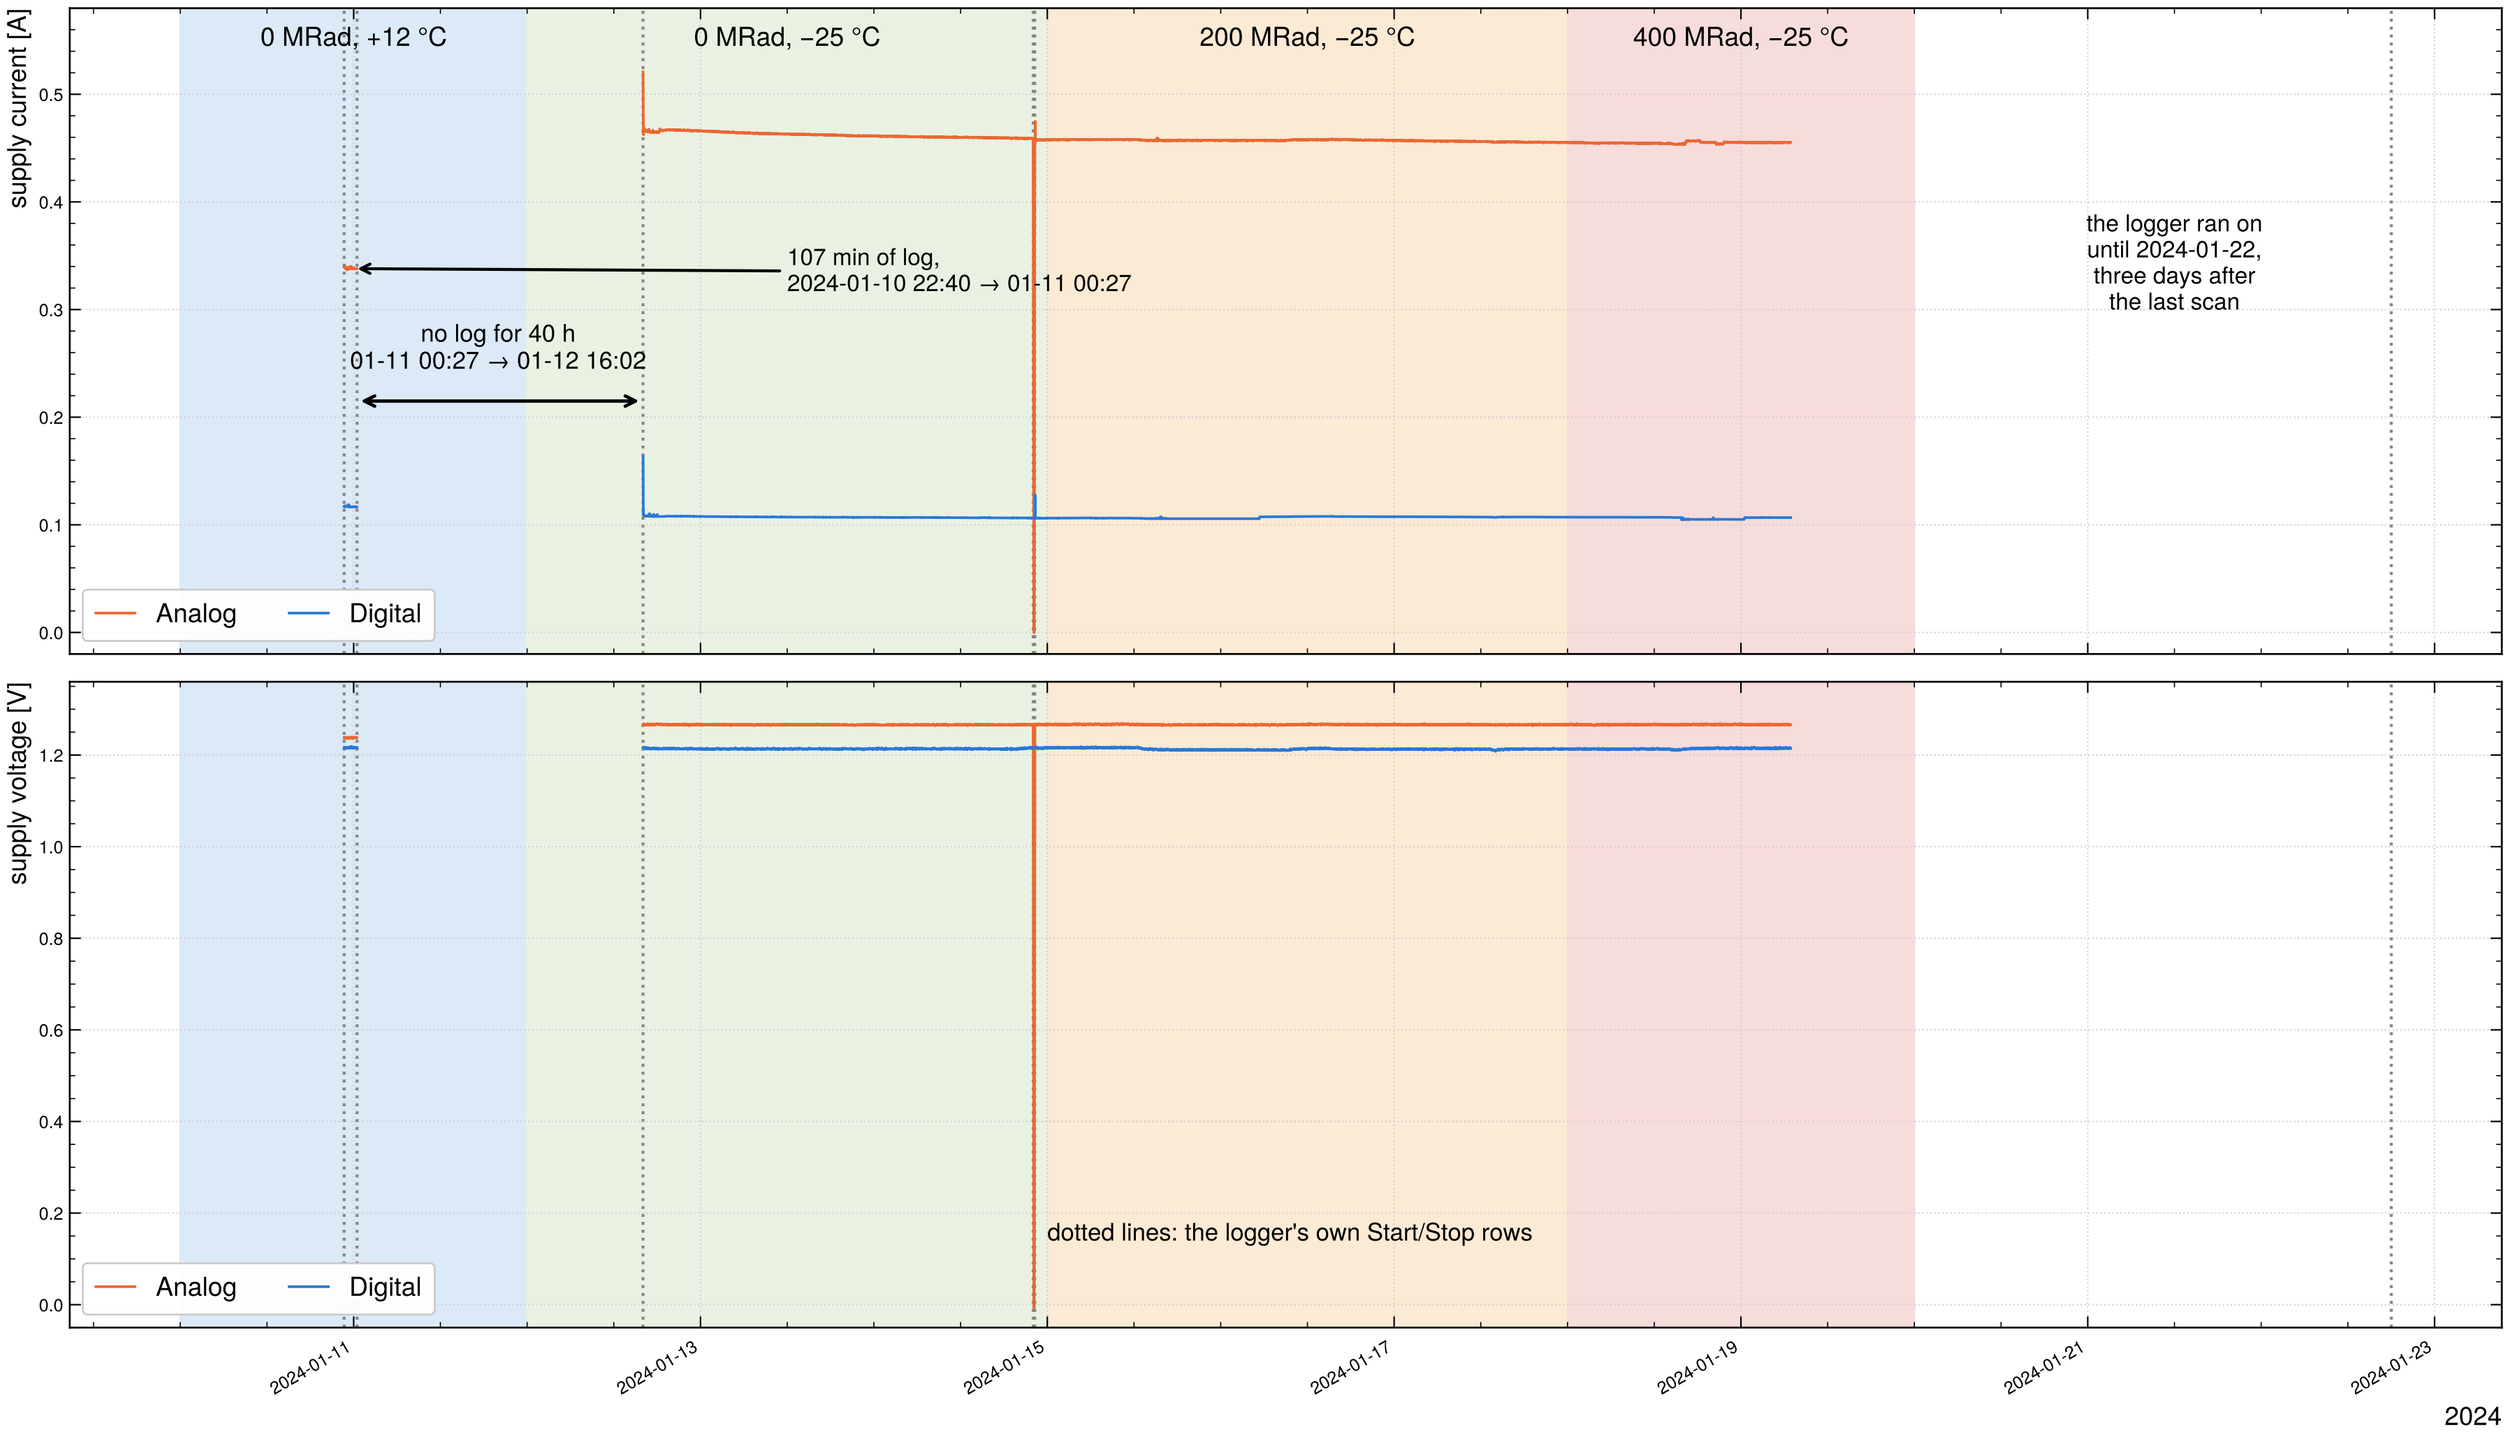

0 MRad, +12 °C
0 MRad, −25 °C
200 MRad, −25 °C
400 MRad, −25 °C
supply current [A]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
107 min of log,
2024-01-10 22:40 → 01-11 00:27
no log for 40 h
01-11 00:27 → 01-12 16:02
the logger ran on
until 2024-01-22,
three days after
the last scan
Analog
Digital
supply voltage [V]
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
dotted lines: the logger's own Start/Stop rows
2024-01-11
2024-01-13
2024-01-15
2024-01-17
2024-01-19
2024-01-21
2024-01-23
2024