S401 DIG/N

Électrode de pH/T° numérique

- **pH 0 à 14 et température**
- **Précision ± 0,05 pH**
- **Sortie numérique Modbus RTU**
- **Sonde de température NTC**
- **Diaphragme en PTFE**
- **Jusqu'à 100 °C et 11 bar**
- **Porte-électrode PPS 3/4" NPT**
- **Câble intégré de 10 m**



Présentation

L'électrode **S401 DIG/N** mesure le pH et la température et transmet ses valeurs en numérique, par liaison Modbus RTU. Elle se raccorde aux transmetteurs numériques Séries 50, 70 et 80.

Elle convient aux eaux pures, aux stations d'épuration, aux procédés chargés en matières en suspension ou en polluants et aux procédés galvaniques.

Son diaphragme poreux en PTFE résiste à l'encrassement et aux attaques chimiques. La sonde de température NTC, placée derrière la membrane de verre, mesure la température au plus près du point de mesure du pH pour la compensation.

Les avantages

La mesure est numérisée dans l'électrode et transmise en Modbus RTU, avec les avantages suivants :

- ☞ **pH et température dans une seule électrode**
- ☞ **Compensation en température intégrée**
- ☞ **Diaphragme PTFE résistant à l'encrassement**
- ☞ **Électrolyte gel**
- ☞ **Montage à la main, sans outil**
- ☞ **Consommation inférieure à 1 W**

Montage

L'électrode s'insère dans son porte-électrode en PPS puis se visse à la main, sans outil (clé, pince…), afin de ne pas casser le verre.

L'ensemble se monte sur un support grâce au filetage 3/4" NPT du porte-électrode ; l'électrode seule dispose d'un filetage Pg 13,5.

En bassin, notamment en station d'épuration, il se fixe en bout de support tubulaire d'immersion, de longueur adaptée à la profondeur. L'électrode, placée en partie basse, est protégée par le tube et le raccord est étanche ; le câble remonte à l'intérieur du tube jusqu'au transmetteur.

Fourniture et applications

Fourniture

- ☞ 1 électrode S401 DIG/N avec câble de 10 m
- ☞ 1 porte-électrode en PPS
- ☞ 1 notice technique

Applications

- ☞ Stations d'épuration, eaux usées
- ☞ Suivi et contrôle de procédés
- ☞ Eaux pures, procédés galvaniques

Raccordement

- ☞ Transmetteurs numériques Séries 50, 70 et 80


COMETEC • ZA de Longifan – 172 rue des Belledonnes, 38530 Chapareillan • Serv. Tech. / SAV : 9 bis rue du Général Leclerc, 94520 Mandres-les-Roses
Tél : +33 (0)1 48 90 40 79 • contact@cometec.fr • SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00047 RC Grenoble • N° de TVA : FR 64 352 570 444

Caractéristiques techniques


Mesure	
Grandeurs mesurées	pH et température
Gamme de mesure	0 à 14 pH
Résolution	0,01 pH
Précision / répétabilité	± 0,05 pH / ± 0,05 pH
Temps de réponse	< 30 s (de pH 4 à pH 7)
Température	Sonde NTC 30 kΩ ; résolution 0,1 °C ; précision ± 0,5 °C
Conductivité minimale	50 µS/cm
Conditions de service	
Température de service	0 à 100 °C
Pression maximale	11 bar
Construction	
Matériaux	Corps d'électrode en verre et PPS ; porte-électrode en PPS ; joints toriques en Viton® ; diaphragme en Teflon® (PTFE)
Électrolyte	Gel
Filetages	Porte-électrode 3/4" NPT ; électrode seule Pg 13,5
Dimensions	Ø 27 × 213 mm (avec porte-électrode)
Électrique et communication	
Sortie	Numérique, protocole Modbus RTU
Alimentation	12 à 24 Vdc ; consommation inférieure à 1 W
Câble	10 m, solidaire de l'électrode (autres longueurs sur demande)

Références de commande	
9701010097	Électrode pH numérique S401 DIG/N avec porte-électrode, câble 10 m
9701011097	Électrode pH numérique S401 DIG/N sans porte-électrode, câble 10 m
7600970000	Porte-électrode en PPS pour électrodes pH, redox et conductivité


Dimensions et montage

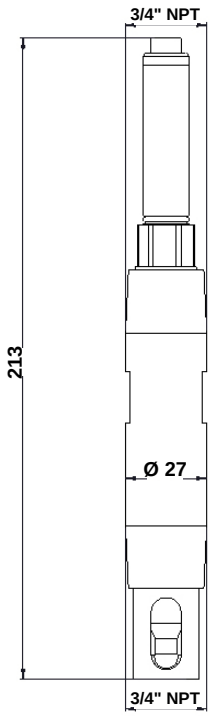


Cotes en mm

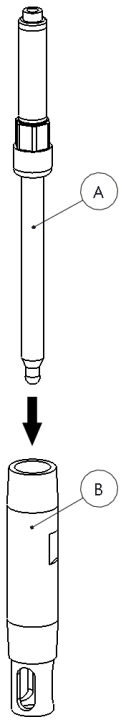

1 – Insérer délicatement l'électrode (A) dans le porte-électrode (B).

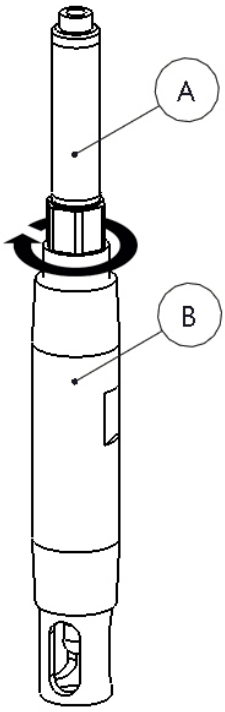

2 – Visser l'électrode à la main, sans outil, pour ne pas casser le verre.

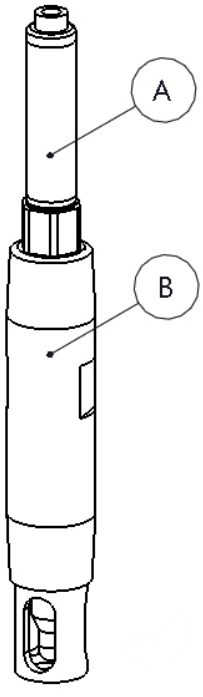

3 – L'ensemble est prêt à être installé sur le procédé.