
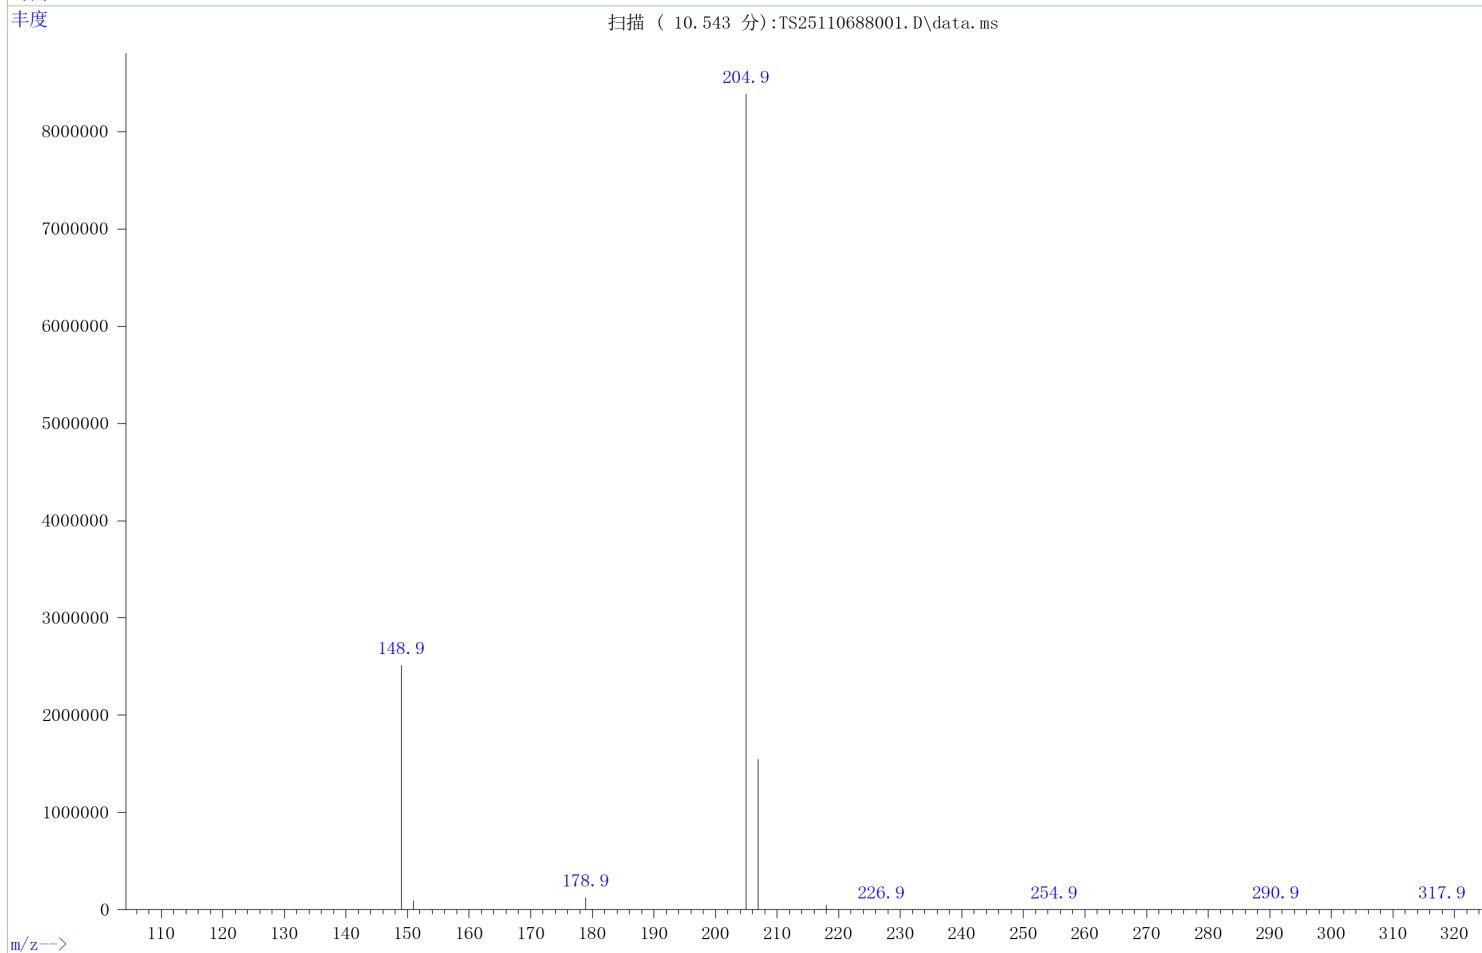


文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1110 OT\TS25110688002.D
操作员 :
已采集 : 12 Nov 2025 16:38 , 使用采集方法 OT-EN-SIM-DB-5MS-20251024.M
仪器: GCMS
样品名称 : TS25110688001
其他信息 :
样品瓶号 : 32

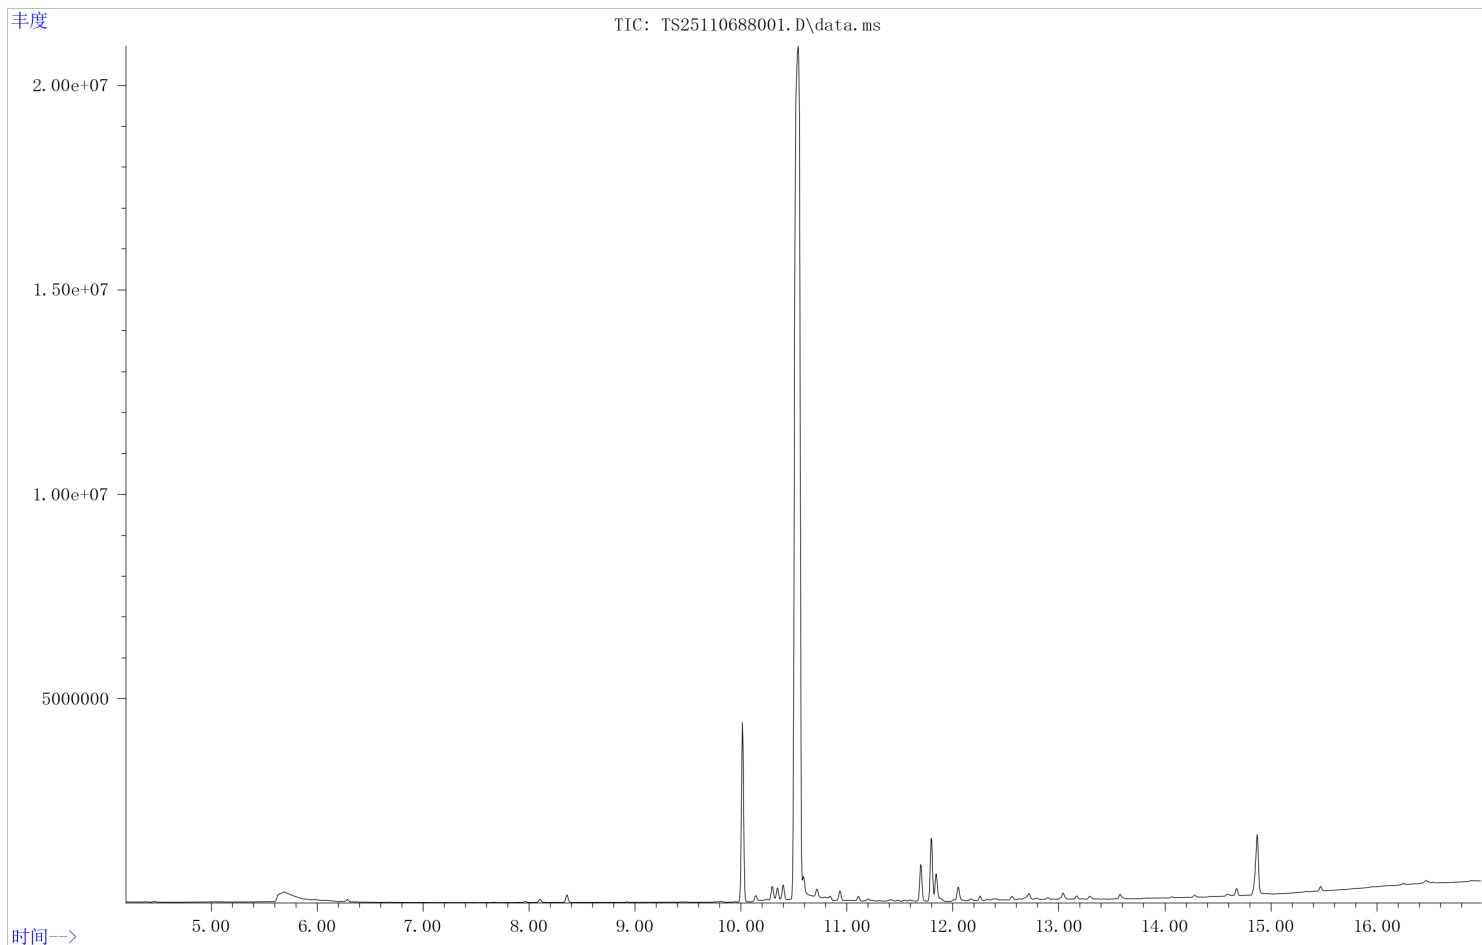

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1110 OT\
数据文件 : TS25110688002.D
采集 : 12 Nov 2025 16:38
操作者 :
样品 : TS25110688002
其他 :
ALS 样品瓶: 32 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 13 08:58:08 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\有机锡-CAL-1.M
定量方法标题: PBDE 209
上一次定量更新: Tue Nov 11 14:09:00 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) 单丁基锡-D9	8.366	242	38592	1.00	mg/L	0.00
9) 三丁基锡d27	10.350	217	126674	1.00	mg/L	# 0.00
11) 四丁基锡d36	11.114	318	21481	1.00	mg/L	# 0.00
13) 三苯基锡d15	14.680	366	146397	1.00	mg/L	0.00
目标化合物						定性离子
2) 二甲基锡	4.775	179	692	N. D.		
3) 甲基锡	6.094	193	1109	N. D.		
4) 二丙基锡	8.333	193	54	N. D.		
5) 丁基锡	8.371	235	196	N. D.		
6) 二丁基锡	10.398	179	13538	N. D.		
7) 辛基锡	10.954	179	5312	N. D.		
8) 二辛基锡	13.607	263	8203	N. D.		
10) 三丁基锡	10.452	151	9289	N. D.		
12) 四丁基锡	11.257	291	72	N. D.		
14) 一苯基锡	10.237	197	1749	N. D.		
15) 二苯基锡	12.701	303	1859	N. D.		
16) 三苯基锡	14.717	351	71	N. D.		
17) 三环己基锡	14.753	233	4522	N. D.		

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号