
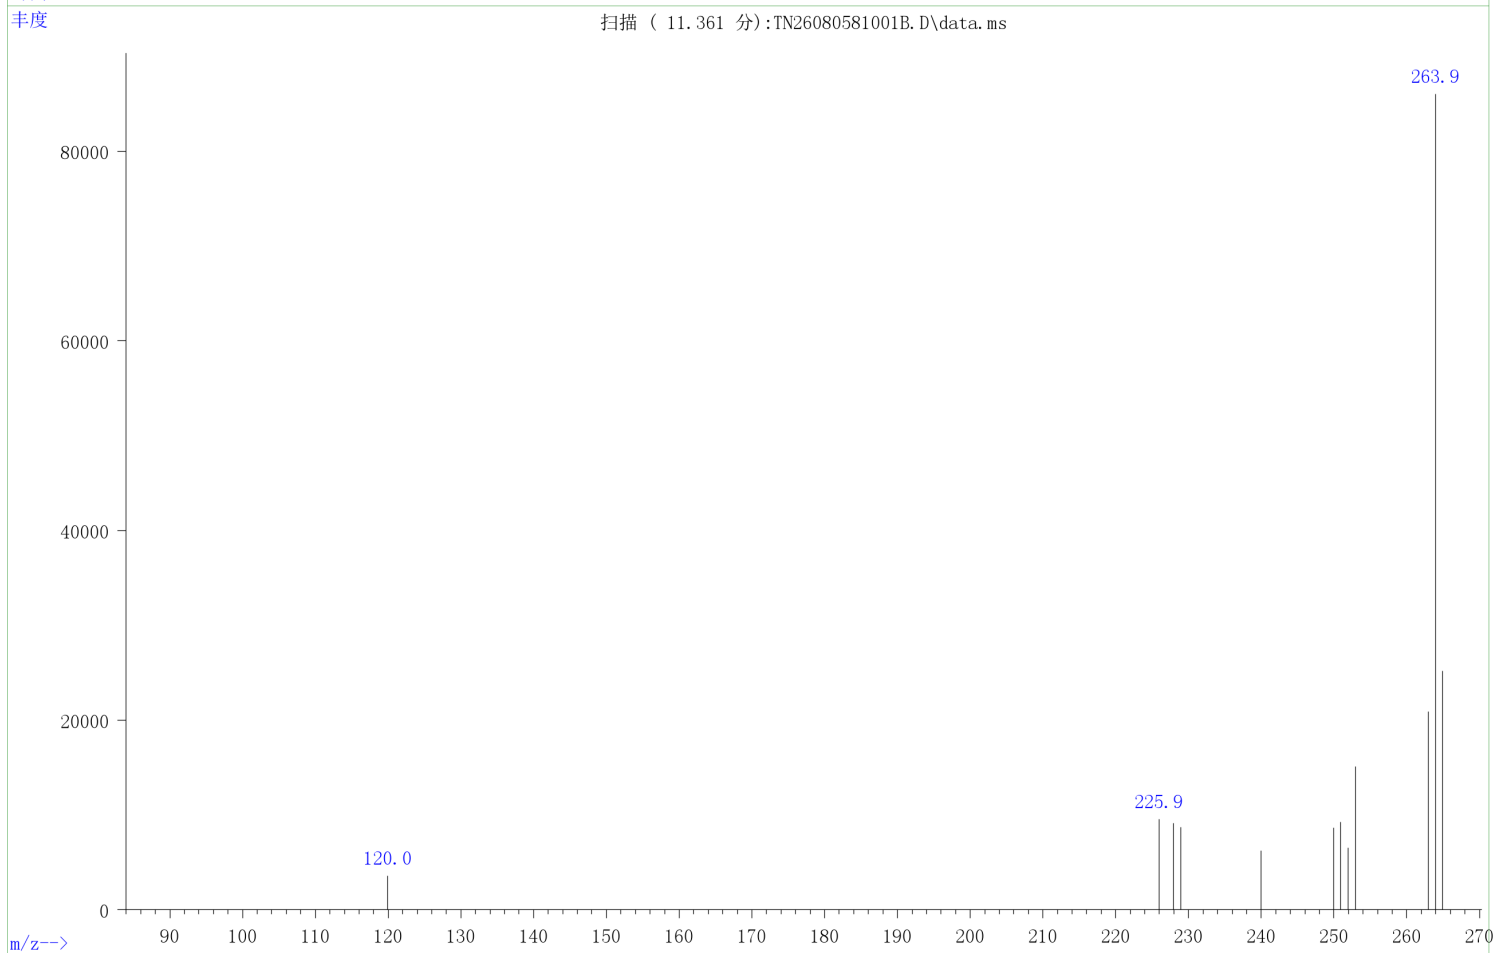


文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\TN26080581001B.D
操作员 :
已采集 :
仪器 : GCMS
样品名称 : TN26080581001B
其他信息 :
样品瓶号 : 149

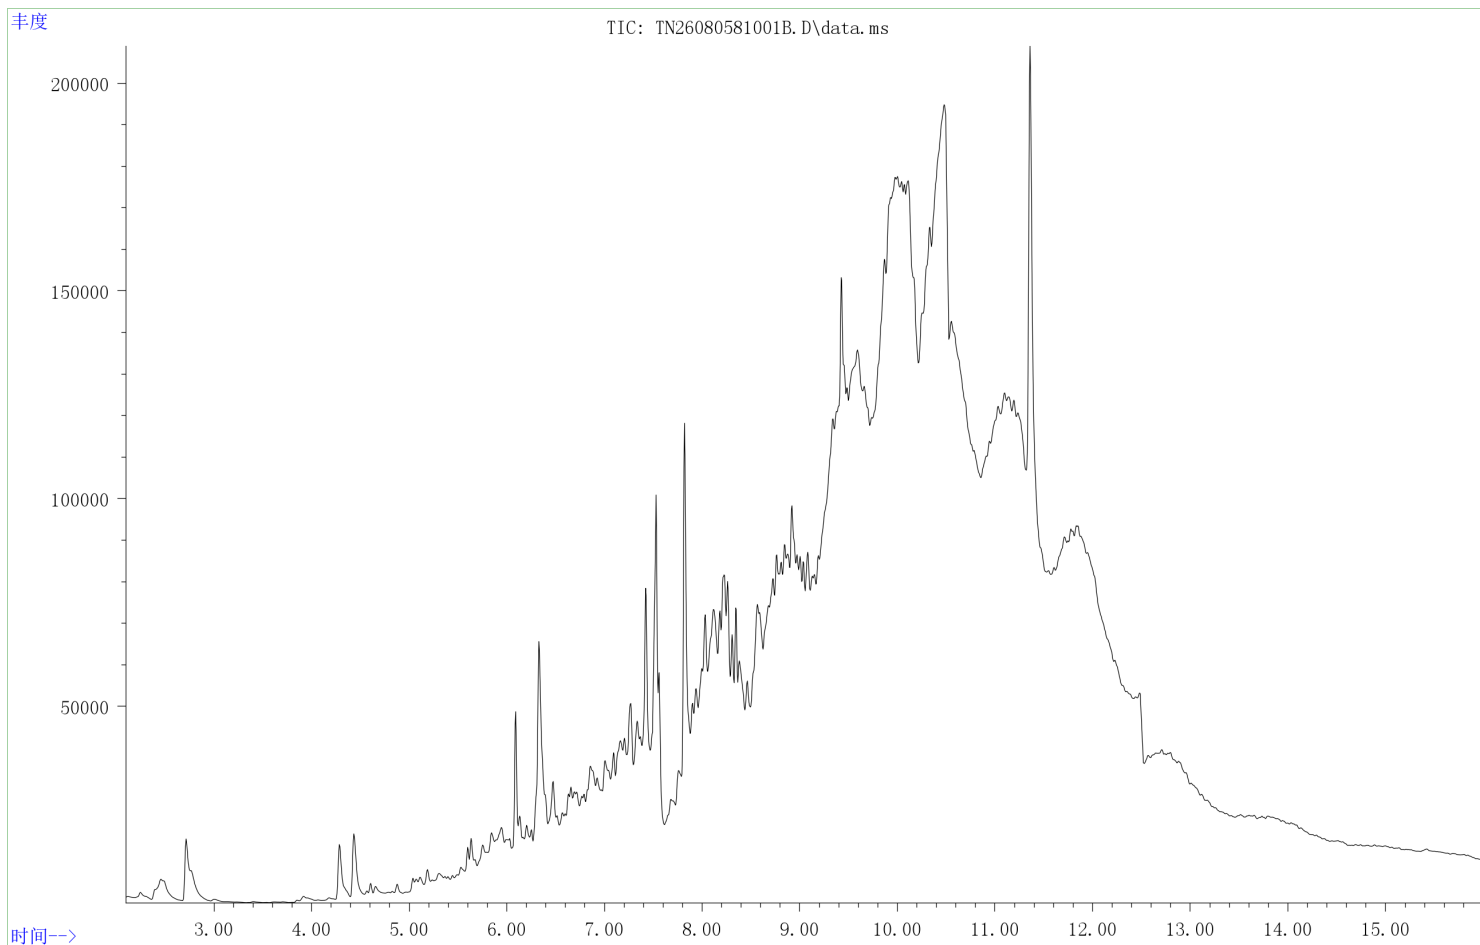

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\
数据文件 : TN26080581001B.D
采集 : 13 Aug 2026 19:40
操作者 :
样品 : TN26080581001B
其他 :
ALS 样品瓶: 149 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 14 13:44:56 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 11 13:01:18 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.718	136	69912	0.25	mg/L	#-0.01
3) Anthracene-d10	6.331	188	98957	0.50	mg/L	-0.02
13) Perylene-d12	11.361	264	202155	1.00	mg/L	# 0.01
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.825	128	360m	0.002	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.382	152	150	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	4.608	153	316m	0.001	mg/L	
6) Fluorene	5.191	165	420m	0.002	mg/L	
7) Phenanthrene	6.306	178	8844	0.024	mg/L #	85
8) Anthracene	6.341	178	694m	0.002	mg/L	
9) Fluoranthene	7.770	202	353m	0.001	mg/L	
10) Pyrene	8.030	202	557m	0.001	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.521	228	225m	0.001	mg/L	
12) Chrysene	9.599	228	307m	0.001	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	10.882	252	375	0.001	mg/L #	47
15) Benzo[j]fluoranthene	10.882	252	375	0.001	mg/L #	47
16) Benzo[k]fluoranthene	10.882	252	375	0.001	mg/L #	47
17) Benzo[e]pyrene	11.196	252	210m	0.001	mg/L	
18) Benzo[a]pyrene	11.284	252	223m	0.001	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.517	276	150	0.001	mg/L #	25
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.492	278	7	0.000	mg/L #	3
21) benzo[g,h,i]perylene	14.037	276	77m	0.001	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-08-14 周五 13:45:32