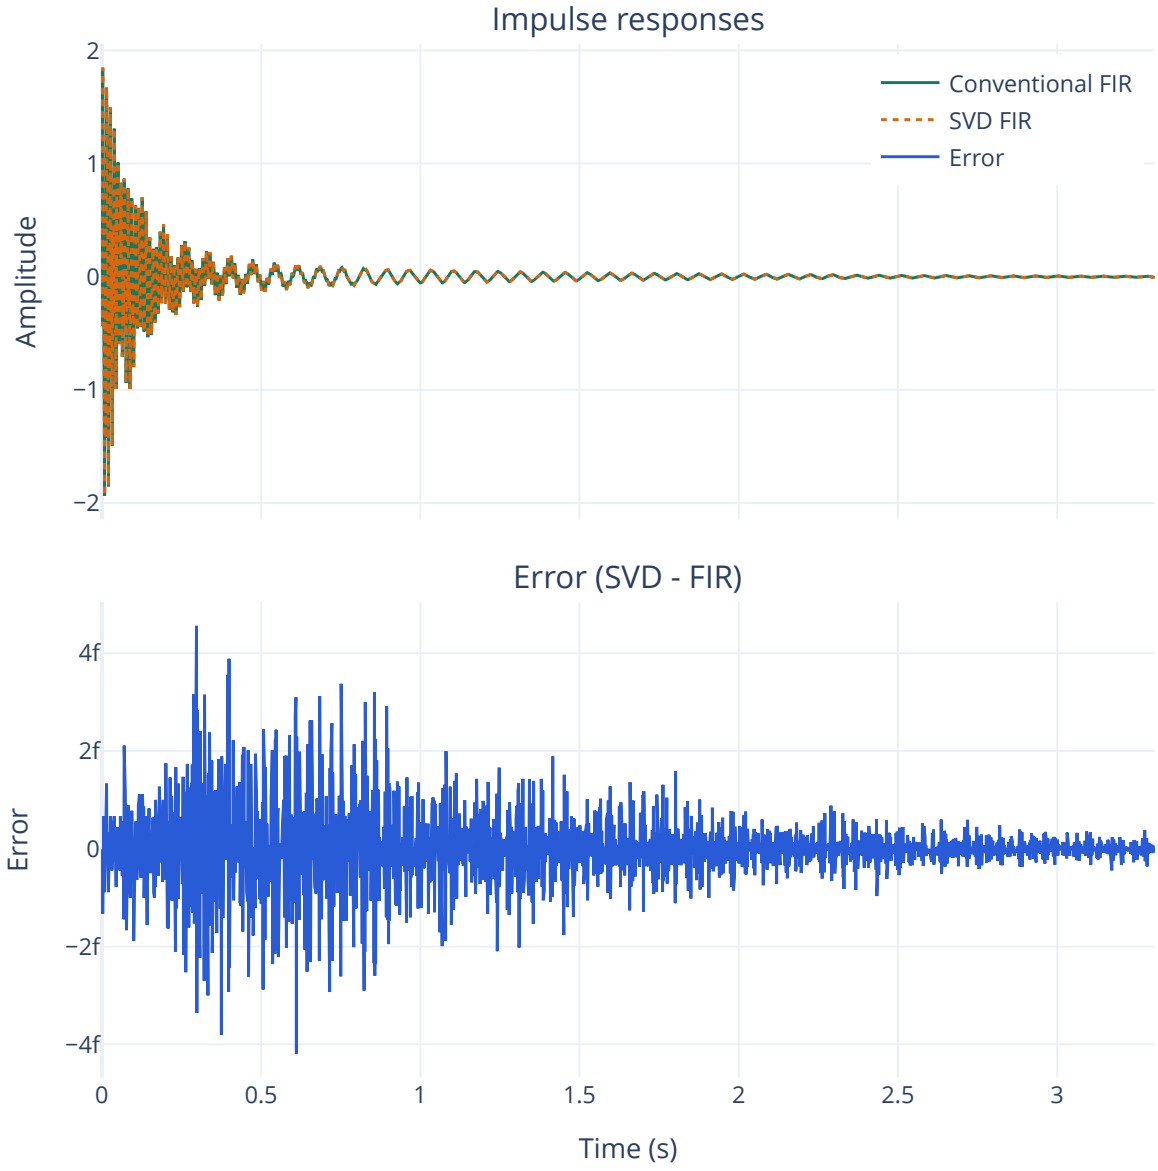

Impulse responses
Conventional FIR
SVD FIR
Error
Amplitude
2
1
0
−1
−2
Error (SVD - FIR)
Error
4f
2f
0
−2f
−4f
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (s)