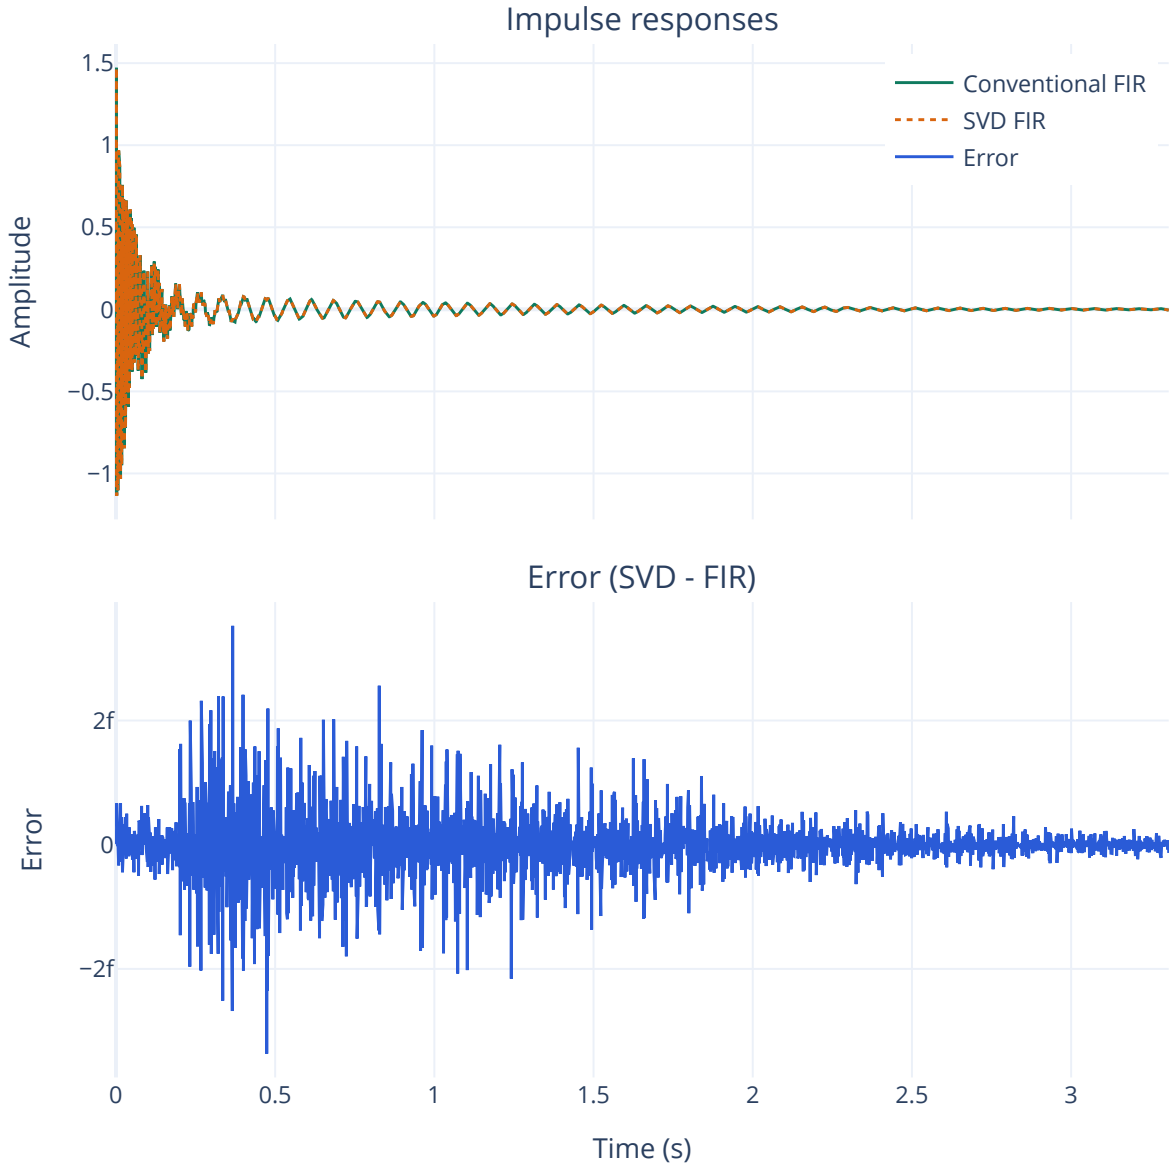

Impulse responses
Conventional FIR
SVD FIR
Error
Amplitude
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
Error (SVD - FIR)
Error
2f
0
−2f
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Time (s)