

**Raport z analizy statystyk z urządzenia
do pomiaru jakości chemicznej
powietrza**

Cezary Dampc

153225

1. Motywacja

Określenie efektywności czujnika tlenków metali, dane zostały wygenerowane przez urządzenie do pomiaru jakości chemicznej powietrza.

2. Cel

Głównym celem jest zbadanie dokładności pomiarów czujnika tlenków metali.

3. Opis danych

Wygenerowane dane są zawarte w jednym pliku csv.

Ilość rekordów wynosi 9358 pomiarów.

Zbiór zawiera następujące dane:

Data – zawiera dzień, miesiąc, rok

Czas – godzina i minuty

CO – rzeczywiste, uśrednione godzinowo stężenie CO w mg/m^3

PT08.S1(CO) – stężenie tlenku cyny

NMHC(GT) – rzeczywiste stężenie węglowodoru w microg/m^3


C6H6(GT) – rzeczywiste stężenie benzenu w microg/m^3

4. Analiza danych


Statystyki dla poszczególnych zmiennych

Poniżej znajdują się poszczególne statystyki wszystkich zmiennych razem z histogramami.


Zmienna: CO(GT)
MIN: -200.0
MAX: 11.9
ŚREDNIA: -34.207523778989
MEDIANA: 1.5
ZAKRES: 211.9
ODCHYLENIE STANDARDOWE: 77.6530205528113
WARIANCJA: 6029.991600975308
PERCENTYL 90%: 3.9




Zmienna: PT08.S1(CO)
MIN: -200.0
MAX: 2040.0
ŚREDNIA: 1048.9900609169606
MEDIANA: 1053.0
ZAKRES: 2240.0
ODCHYLENIE STANDARDOWE: 329.8150844975584
WARIANCJA: 108777.98996213159
PERCENTYL 90%: 1407.0

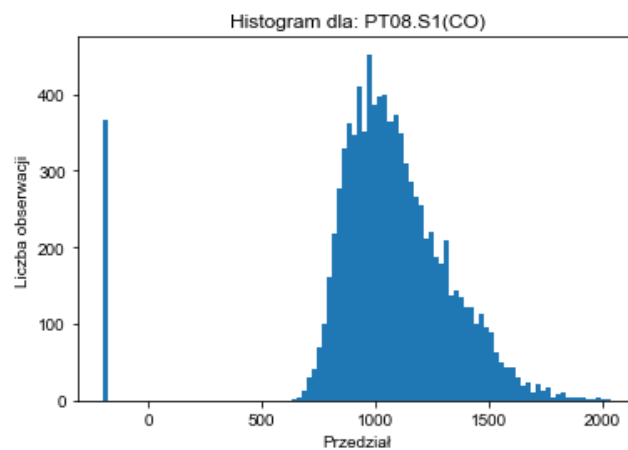

Zmienna: C6H6
MIN: -200.0
MAX: 63.7
ŚREDNIA: 1.8656834455487863
MEDIANA: 7.9
ZAKRES: 263.7
ODCHYLENIE STANDARDOWE: 41.37799518739072
WARIANCJA: 1712.1384857277294
PERCENTYL 90%: 20.1

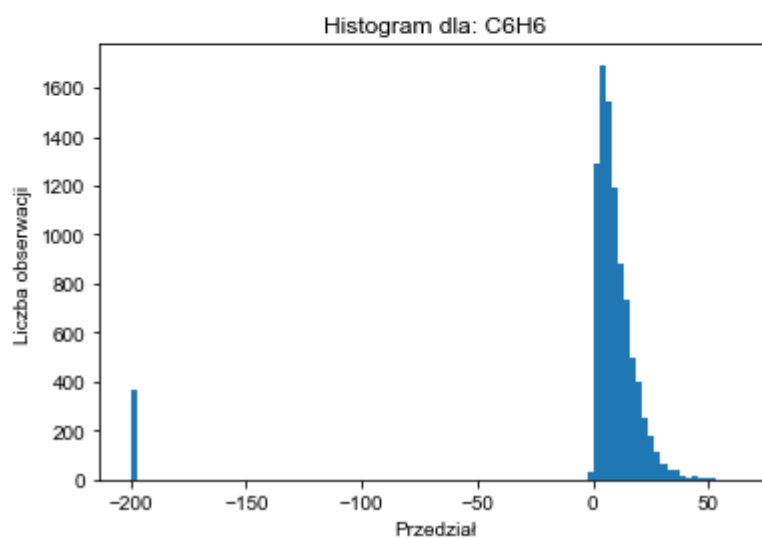

Zmienna: NMHC(GT)
MIN: -200.0
MAX: 1189.0
ŚREDNIA: -159.09009297851875
MEDIANA: -200.0
ZAKRES: 1389.0
ODCHYLENIE STANDARDOWE: 139.78162293696653
WARIANCJA: 19538.902110892286
PERCENTYL 90%: -200.0



Tablica korelacyjna

Tablica przedstawia poszczególne zależności między zmiennymi.

Index	CO(GT)	PT08.S1(CO)	NMHC(GT)	C6H6(GT)	PT08.S2(NMHC)	NOx(GT)	PT08.S3(NOx)	NO2(GT)	PT08.S4(NO2)	PT08.S5(O3)	T	RH	AH
CO(GT)	1	0.0414114	0.128351	-0.0313783	0.0299258	0.526451	-0.0899808	0.671127	-0.073724	0.0803096	-0.0689389	-0.0482274	-0.0458922
PT08.S1(CO)	0.0414114	1	0.170007	0.052687	0.933102	0.277993	0.0870194	0.15403	0.845149	0.892434	0.754044	0.745375	0.764903
NMHC(GT)	0.128351	0.170007	1	0.0373225	0.110104	-0.00442725	0.0488209	0.103307	0.16268	0.101185	-9.00792e-06	0.00828427	0.0125001
C6H6(GT)	-0.0313783	0.052687	0.0373225	1	0.767433	-0.00117398	0.512193	-0.0109925	0.774673	0.641334	0.971375	0.925062	0.984555
PT08.S2(NMHC)	0.0299258	0.933102	0.110104	0.767433	1	0.331272	-0.0736674	0.176488	0.874782	0.909905	0.669025	0.585803	0.646572
NOx(GT)	0.526451	0.277993	-0.00442725	-0.00117398	0.331272	1	-0.436084	0.817139	0.035546	0.461889	-0.138452	-0.0530088	-0.0958468
PT08.S3(NOx)	-0.0899808	0.0870194	0.0488209	0.512193	-0.0736674	-0.436084	1	-0.256232	0.122734	-0.208865	0.588111	0.573549	0.621618
NO2(GT)	0.671127	0.15403	0.103307	-0.0109925	0.176488	0.817139	-0.256232	1	-0.0221736	0.253439	-0.0841037	-0.0813047	-0.0604396
PT08.S4(NO2)	-0.073724	0.845149	0.16268	0.774673	0.874782	0.035546	0.122734	-0.0221736	1	0.72369	0.75506	0.640707	0.691913
PT08.S5(O3)	0.0803096	0.892434	0.101185	0.641334	0.909905	0.461889	-0.208865	0.253439	0.72369	1	0.5037	0.524955	0.519467
T	-0.0689389	0.754044	-9.00792e-06	0.971375	0.669025	-0.138452	0.588111	-0.0841037	0.75506	0.5037	1	0.885911	0.981001
RH	-0.0482274	0.745375	0.00828427	0.925062	0.585803	-0.0530088	0.573549	-0.0813047	0.640707	0.524955	0.885911	1	0.943995
AH	-0.0458922	0.764903	0.0125001	0.984555	0.646572	-0.0958468	0.621618	-0.0604396	0.691913	0.519467	0.981001	0.943995	1

