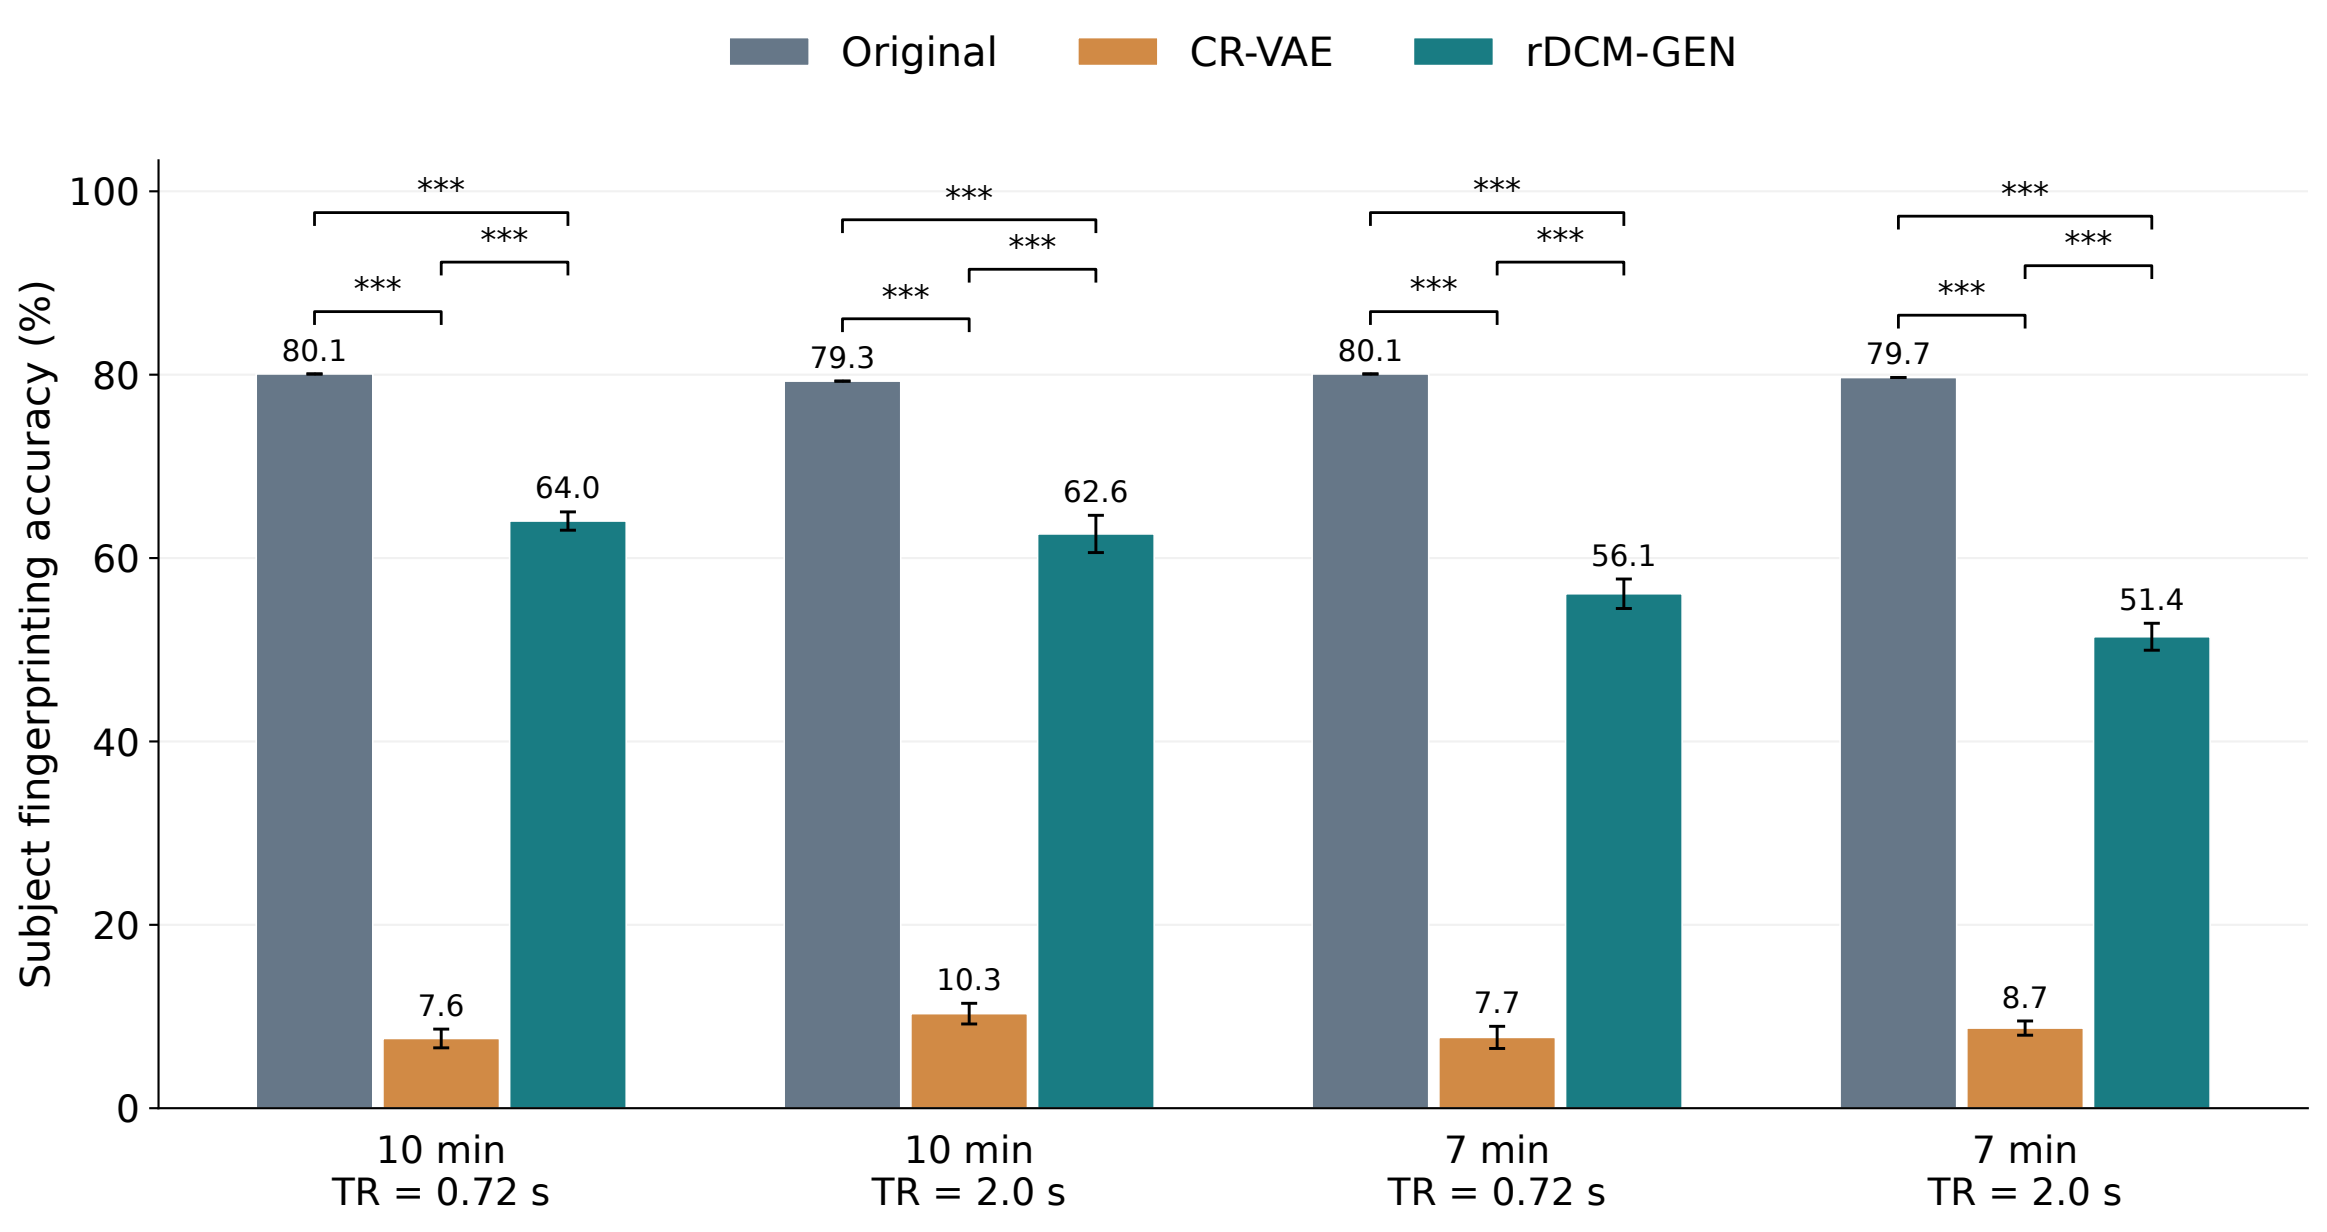
Original
CR-VAE
rDCM-GEN
Subject fingerprinting accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
***
***
***
80.1
7.6
64.0
79.3
10.3
62.6
80.1
7.7
56.1
79.7
8.7
51.4
10 min
TR = 0.72 s
10 min
TR = 2.0 s
7 min
TR = 0.72 s
7 min
TR = 2.0 s