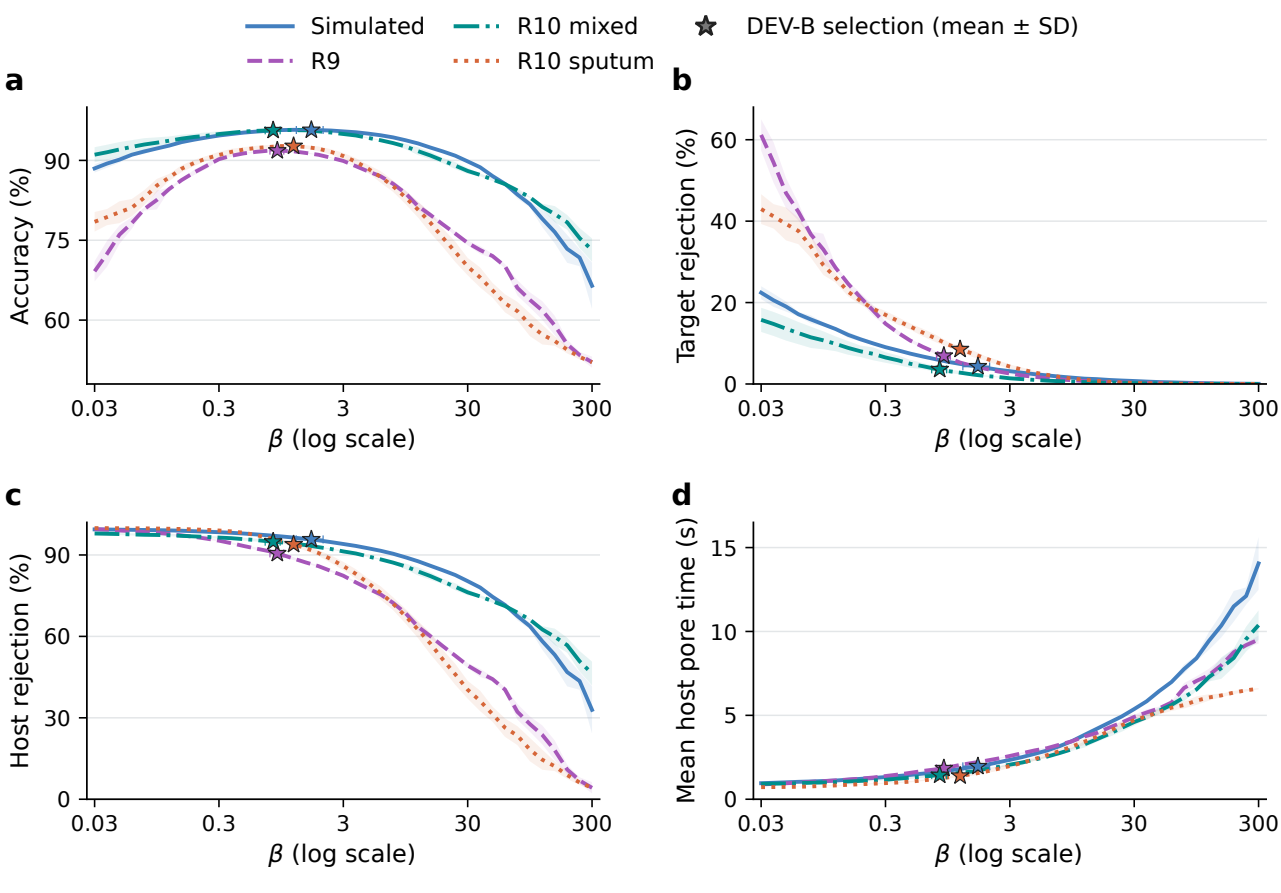
Simulated
R9
R10 mixed
R10 sputum
DEV-B selection (mean ± SD)
a
Accuracy (%)
90
75
60
0.03
0.3
3
30
300
β (log scale)
b
Target rejection (%)
60
40
20
0
0.03
0.3
3
30
300
β (log scale)
c
Host rejection (%)
90
60
30
0
0.03
0.3
3
30
300
β (log scale)
d
Mean host pore time (s)
15
10
5
0
0.03
0.3
3
30
300
β (log scale)