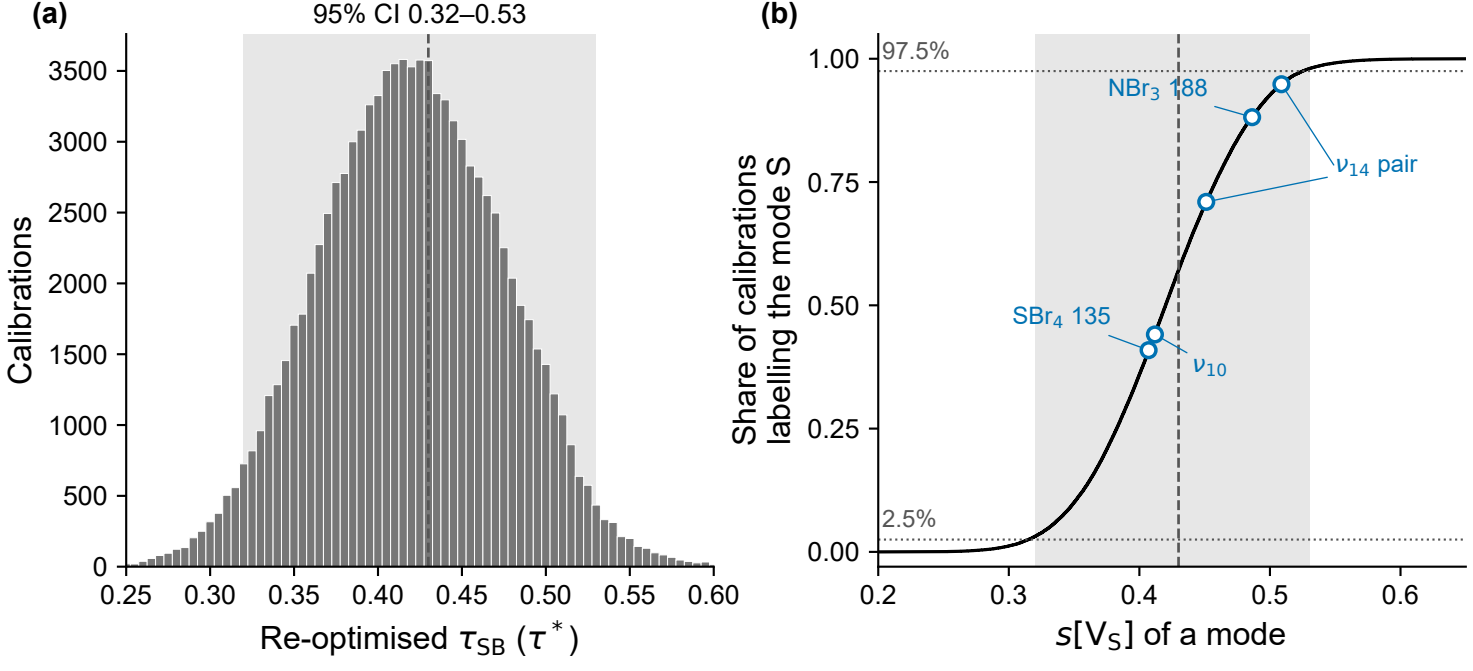
(a)
95% CI 0.32–0.53
Calibrations
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
Re-optimised τ_{SB} (τ^*)
(b)
97.5%
2.5%
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Share of calibrations labelling the mode S
NBr_3 188
ν_{14} pair
SBr_4 135
ν_{10}
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
$s[V_S]$ of a mode