


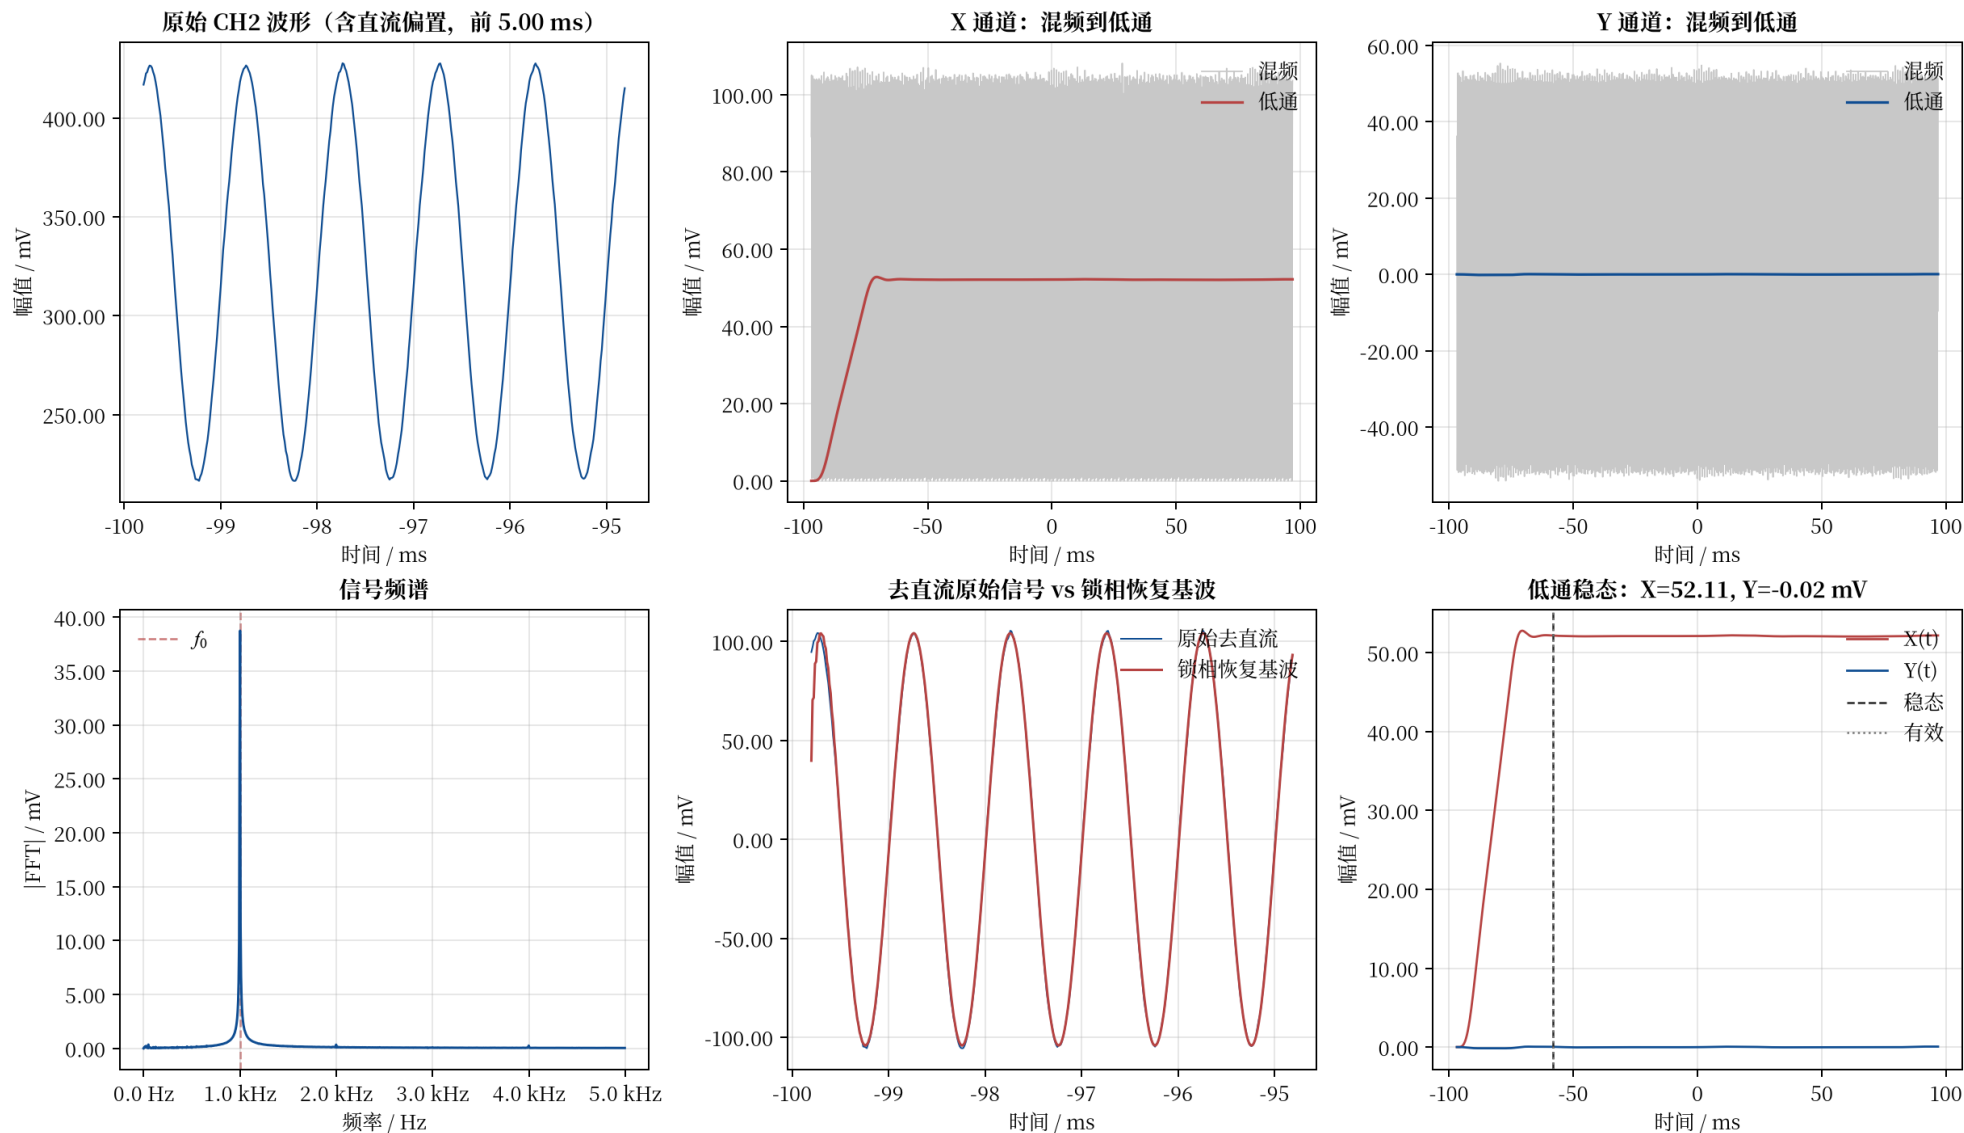

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
104.24 mV	104.22 mV	-0.01°	-0.02°	0.03 mV	0.01°	+28.62 dB