


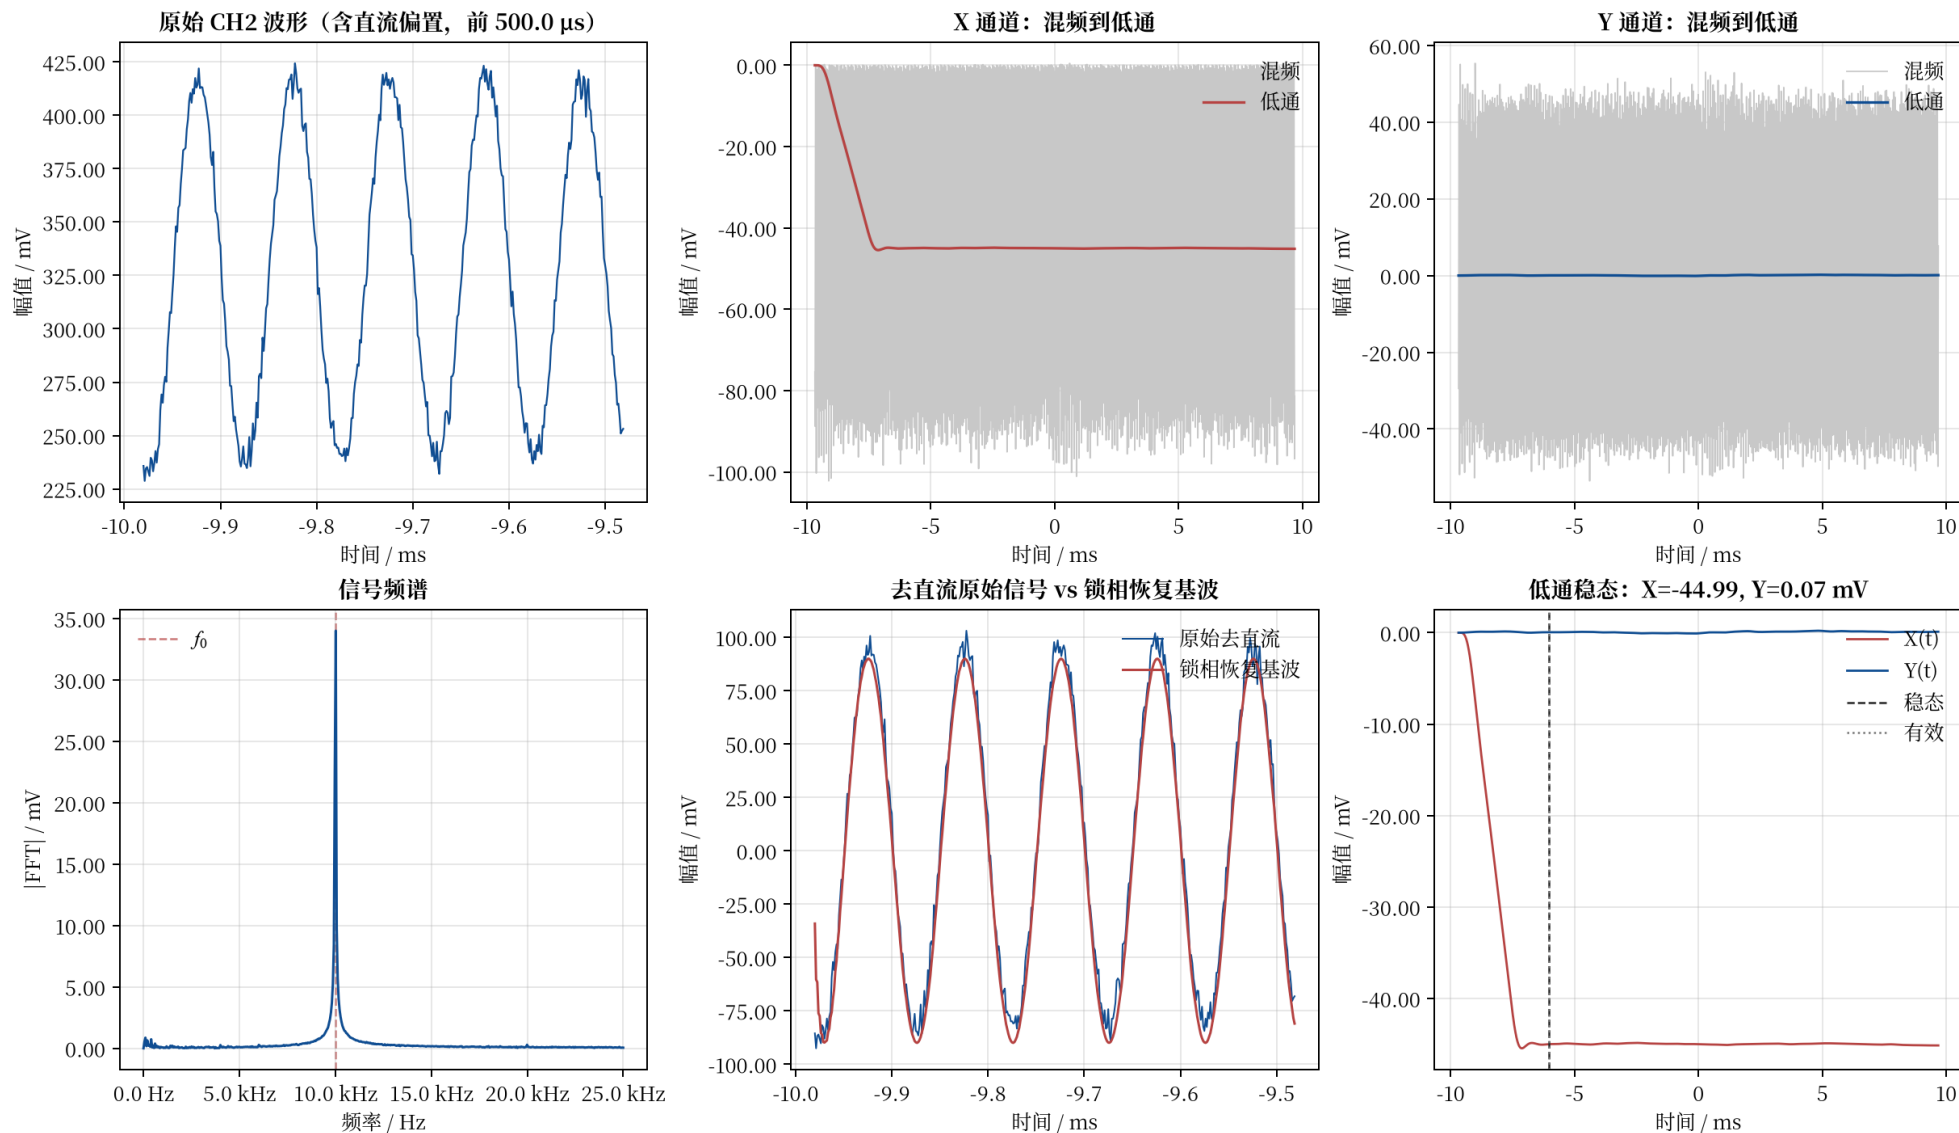

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
89.72 mV	89.98 mV	179.92°	179.91°	0.05 mV	0.04°	+30.41 dB