


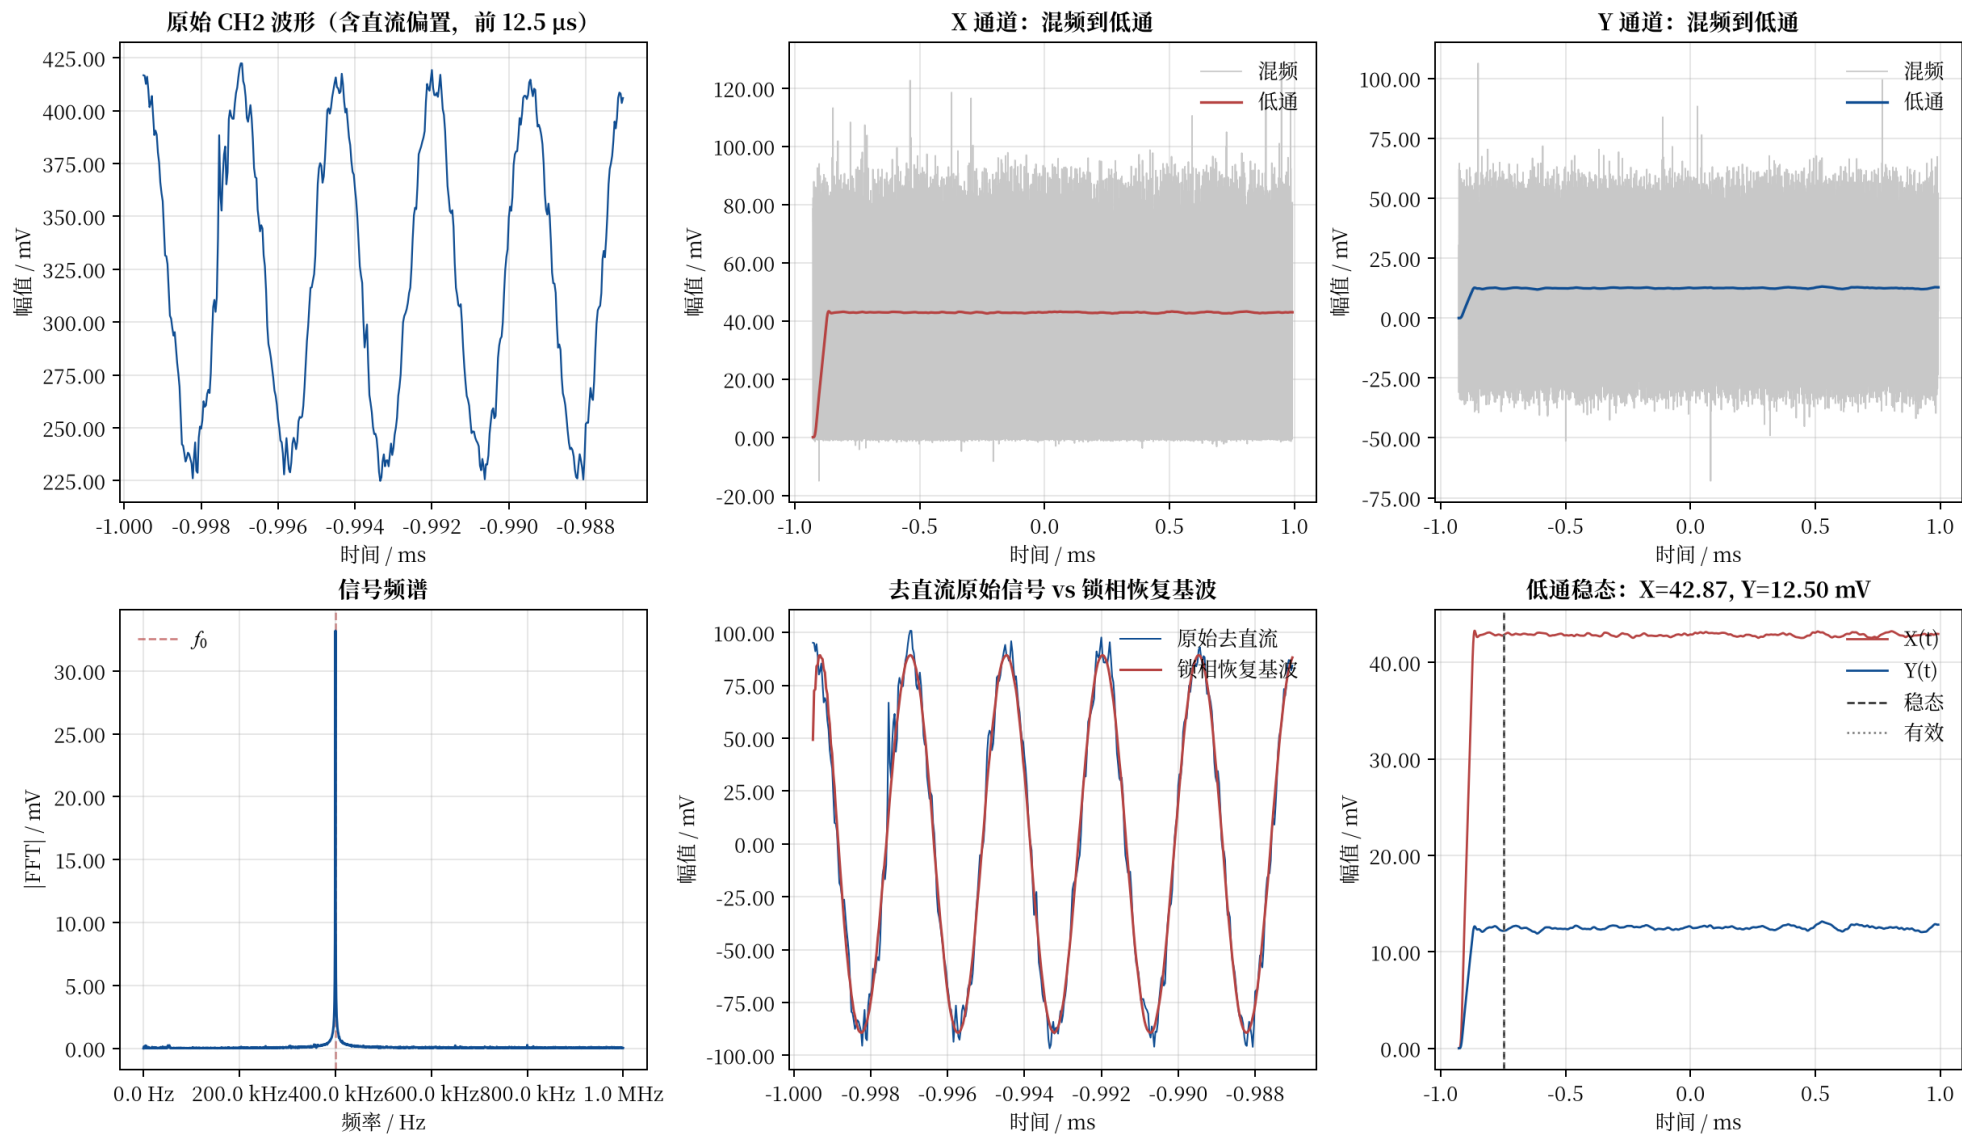

结果摘要

原始幅值	恢复幅值	原始相位	恢复相位	幅值不确定度	相位不确定度	SNR 提升
89.20 mV	89.31 mV	10.32°	10.28°	0.06 mV	0.04°	+26.75 dB