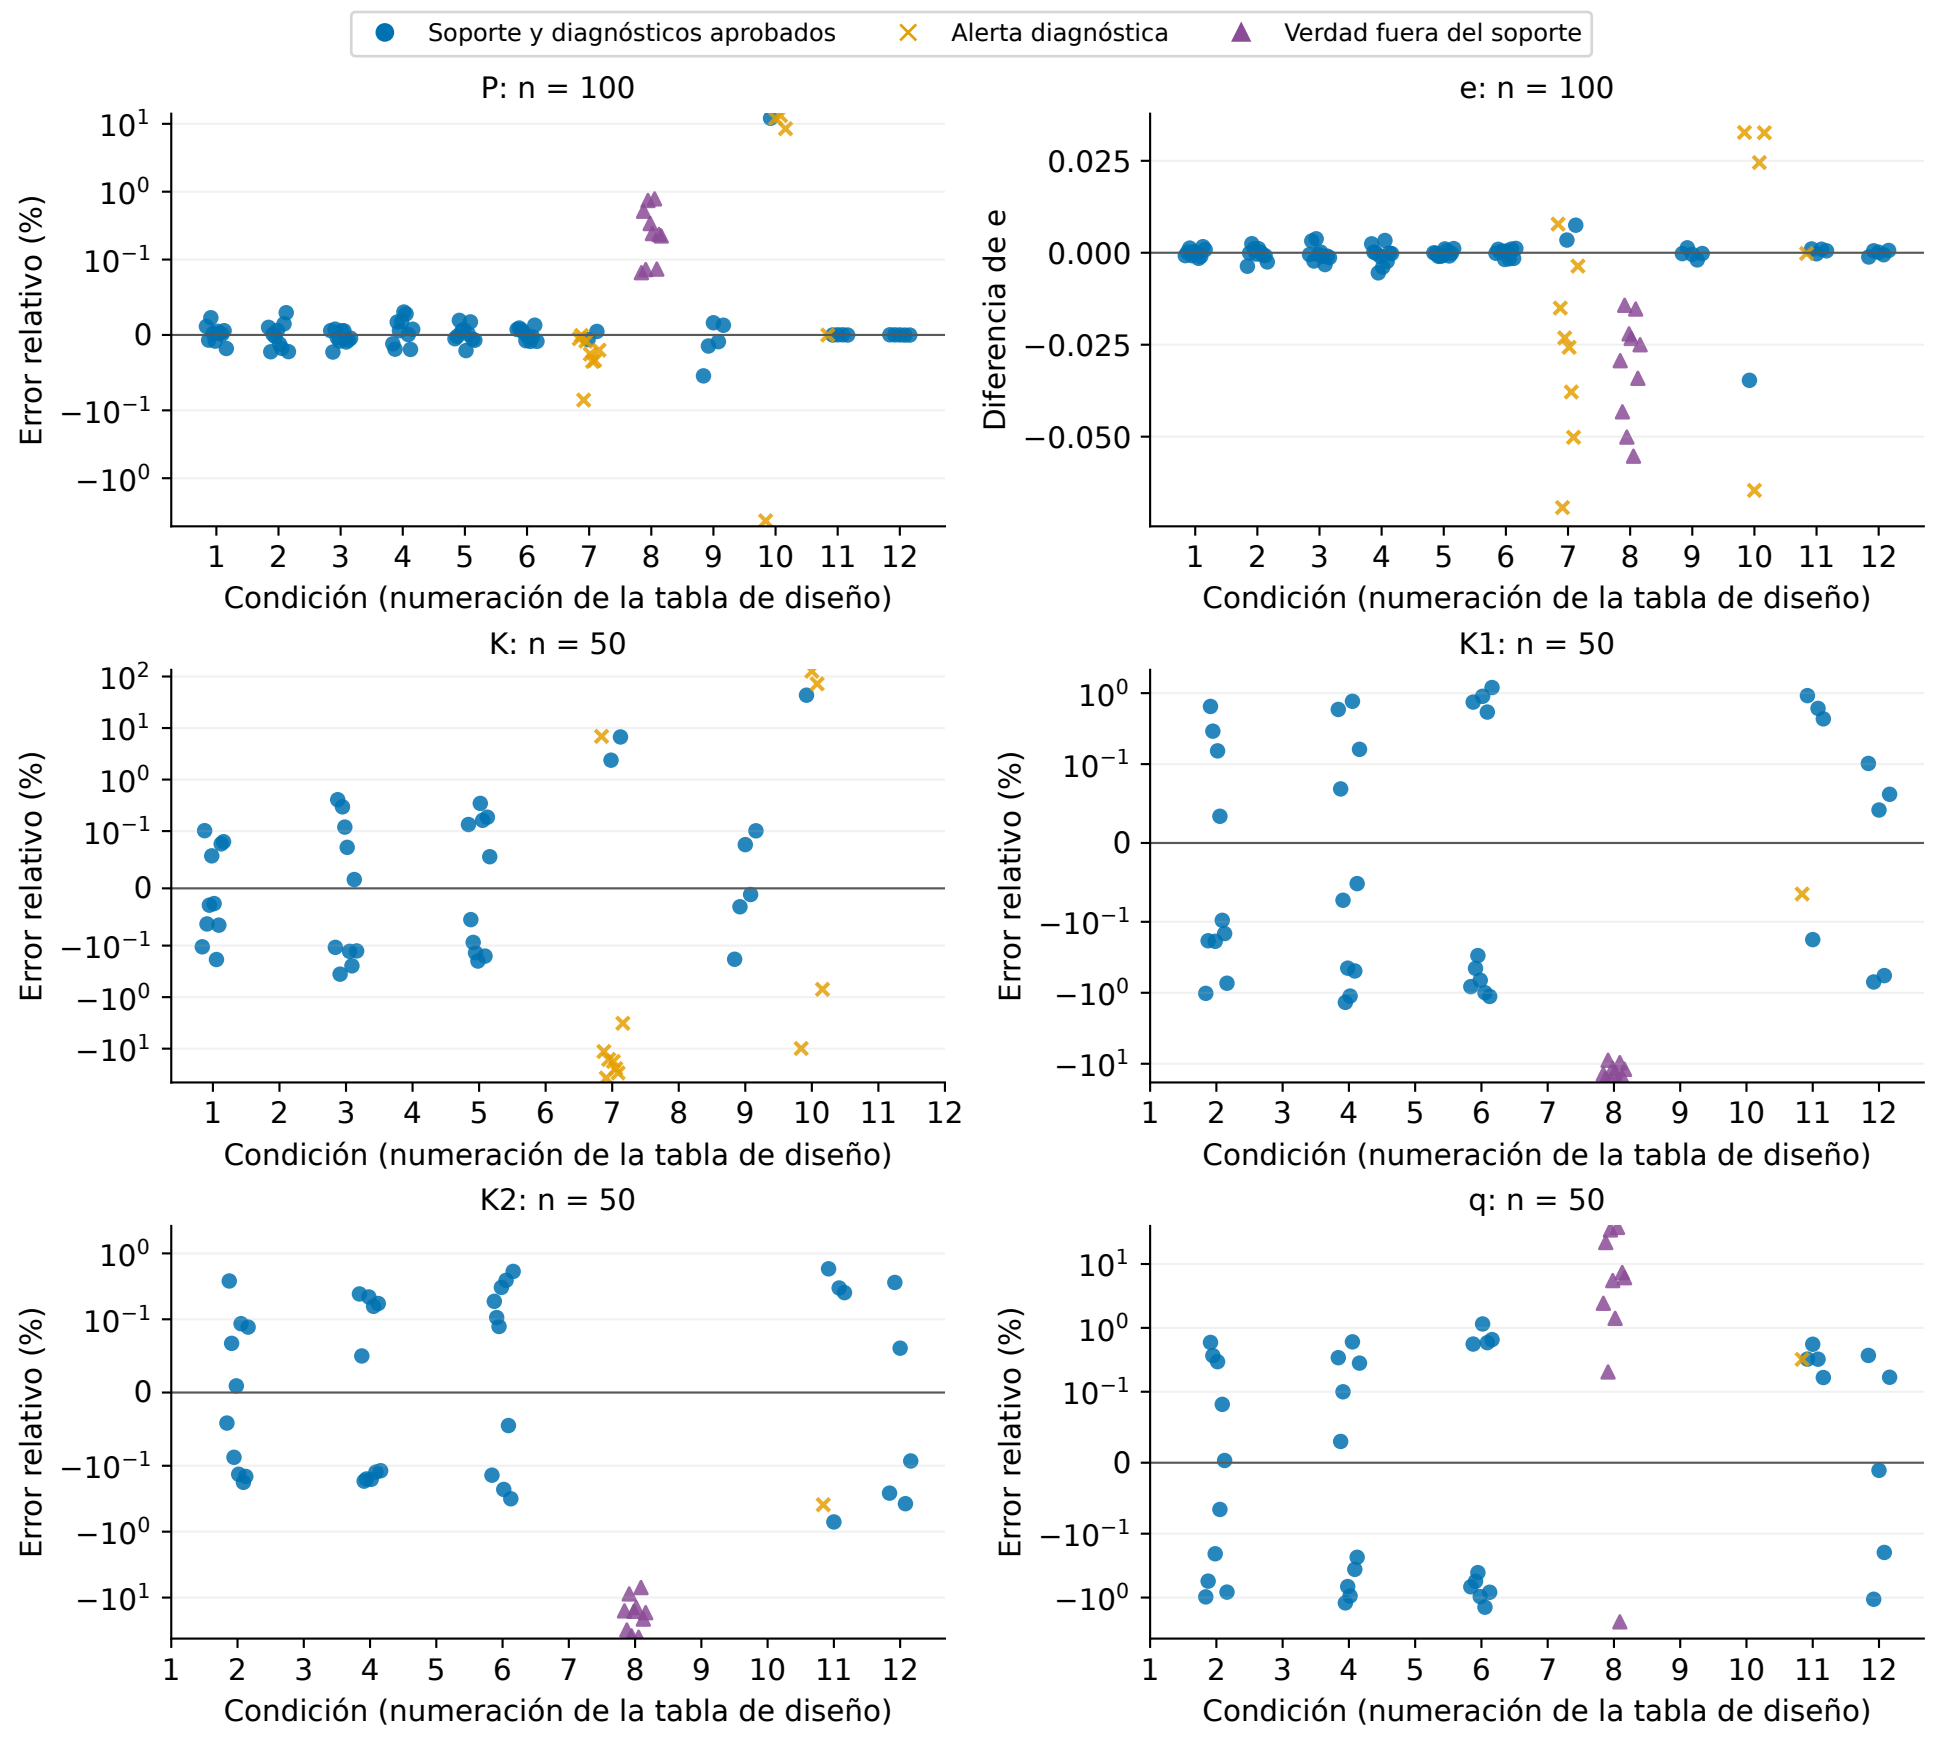
Soporte y diagnósticos aprobados
Alerta diagnóstica
Verdad fuera del soporte
P: n = 100
Error relativo (%)
Condición (numeración de la tabla de diseño)
e: n = 100
Diferencia de e
Condición (numeración de la tabla de diseño)
K: n = 50
Error relativo (%)
Condición (numeración de la tabla de diseño)
K1: n = 50
Error relativo (%)
Condición (numeración de la tabla de diseño)
K2: n = 50
Error relativo (%)
Condición (numeración de la tabla de diseño)
q: n = 50
Error relativo (%)
Condición (numeración de la tabla de diseño)