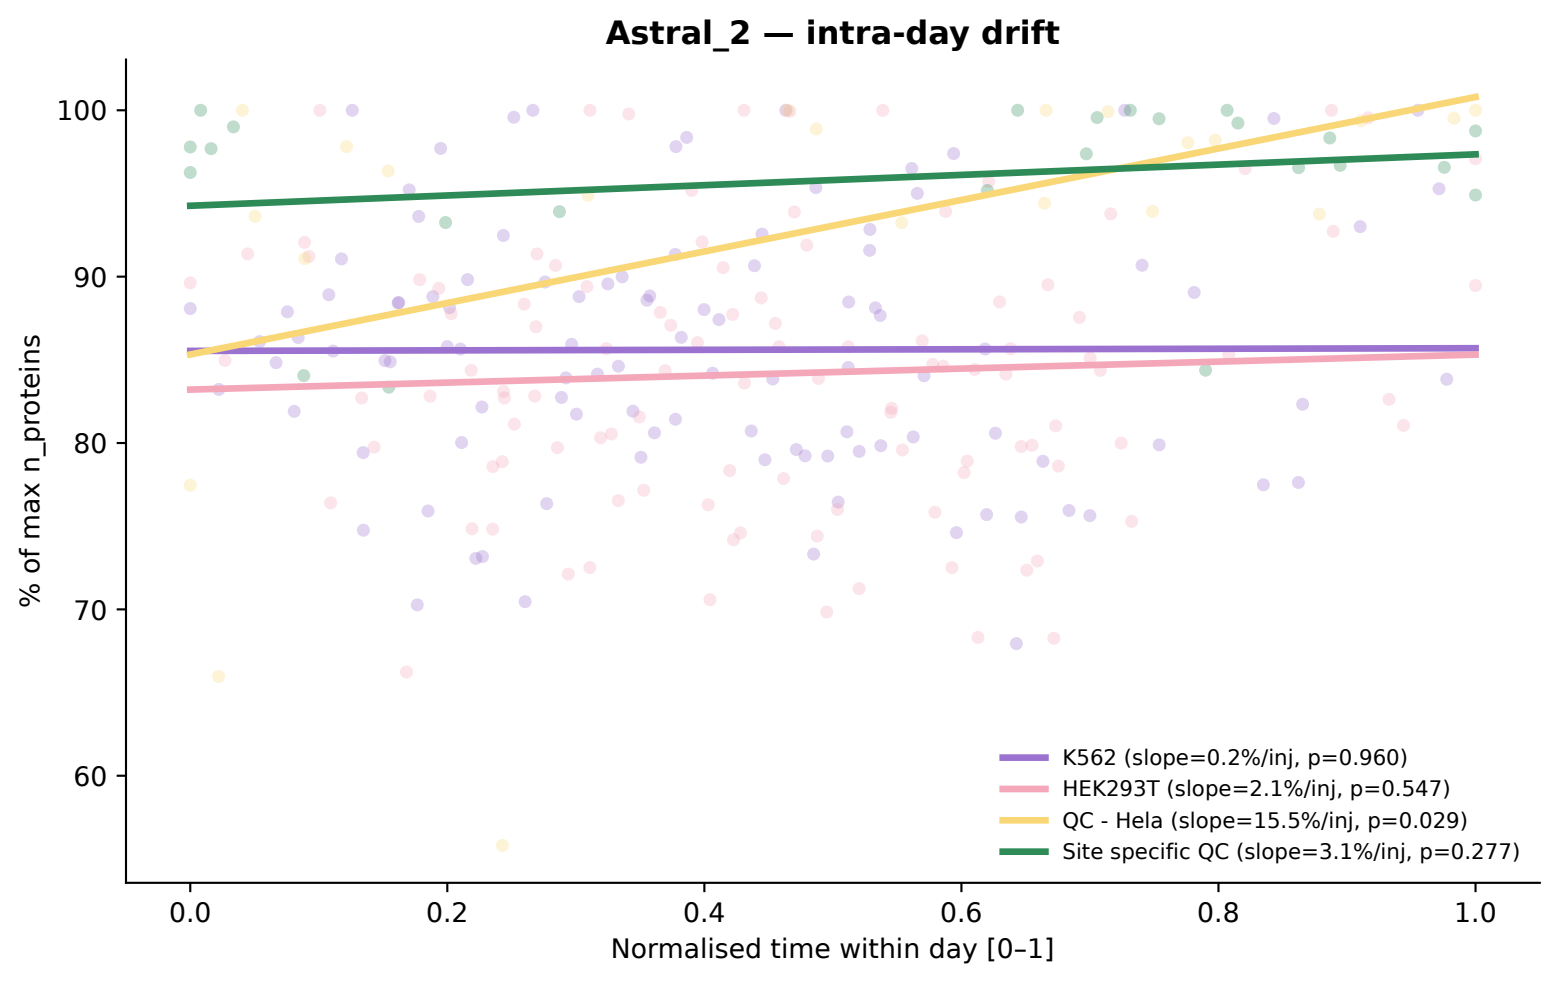
Astral_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=0.2%/inj, p=0.960)
HEK293T (slope=2.1%/inj, p=0.547)
QC - Hela (slope=15.5%/inj, p=0.029)
Site specific QC (slope=3.1%/inj, p=0.277)