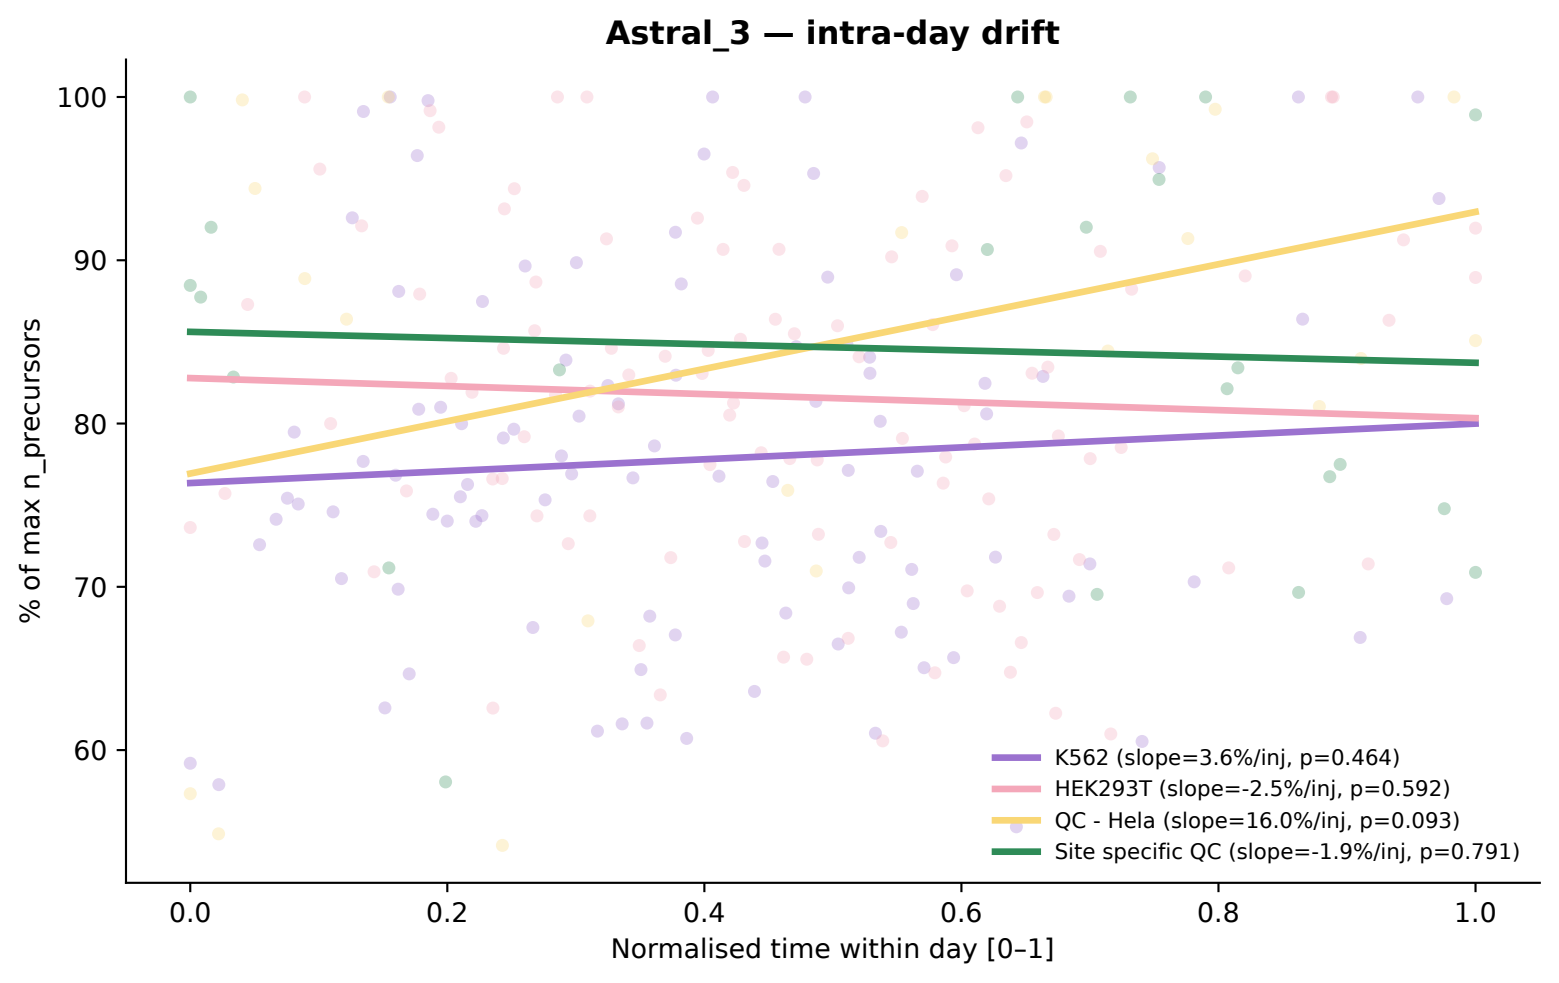
Astral_3 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=3.6%/inj, p=0.464)
HEK293T (slope=-2.5%/inj, p=0.592)
QC - Hela (slope=16.0%/inj, p=0.093)
Site specific QC (slope=-1.9%/inj, p=0.791)