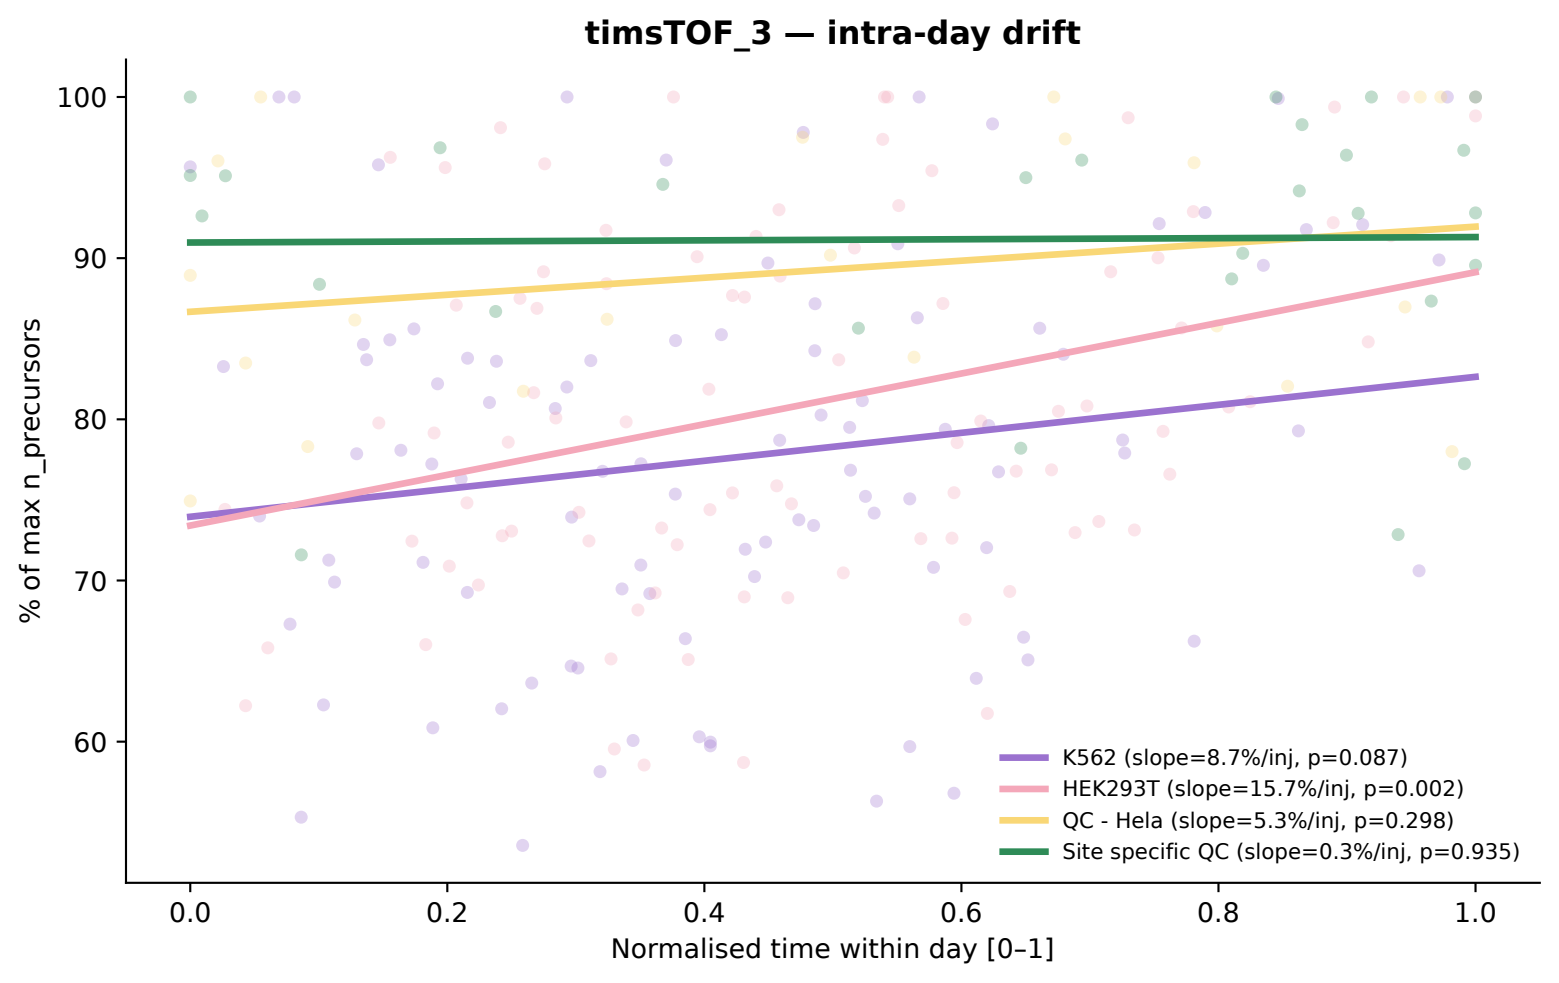
timsTOF_3 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=8.7%/inj, p=0.087)
HEK293T (slope=15.7%/inj, p=0.002)
QC - Hela (slope=5.3%/inj, p=0.298)
Site specific QC (slope=0.3%/inj, p=0.935)