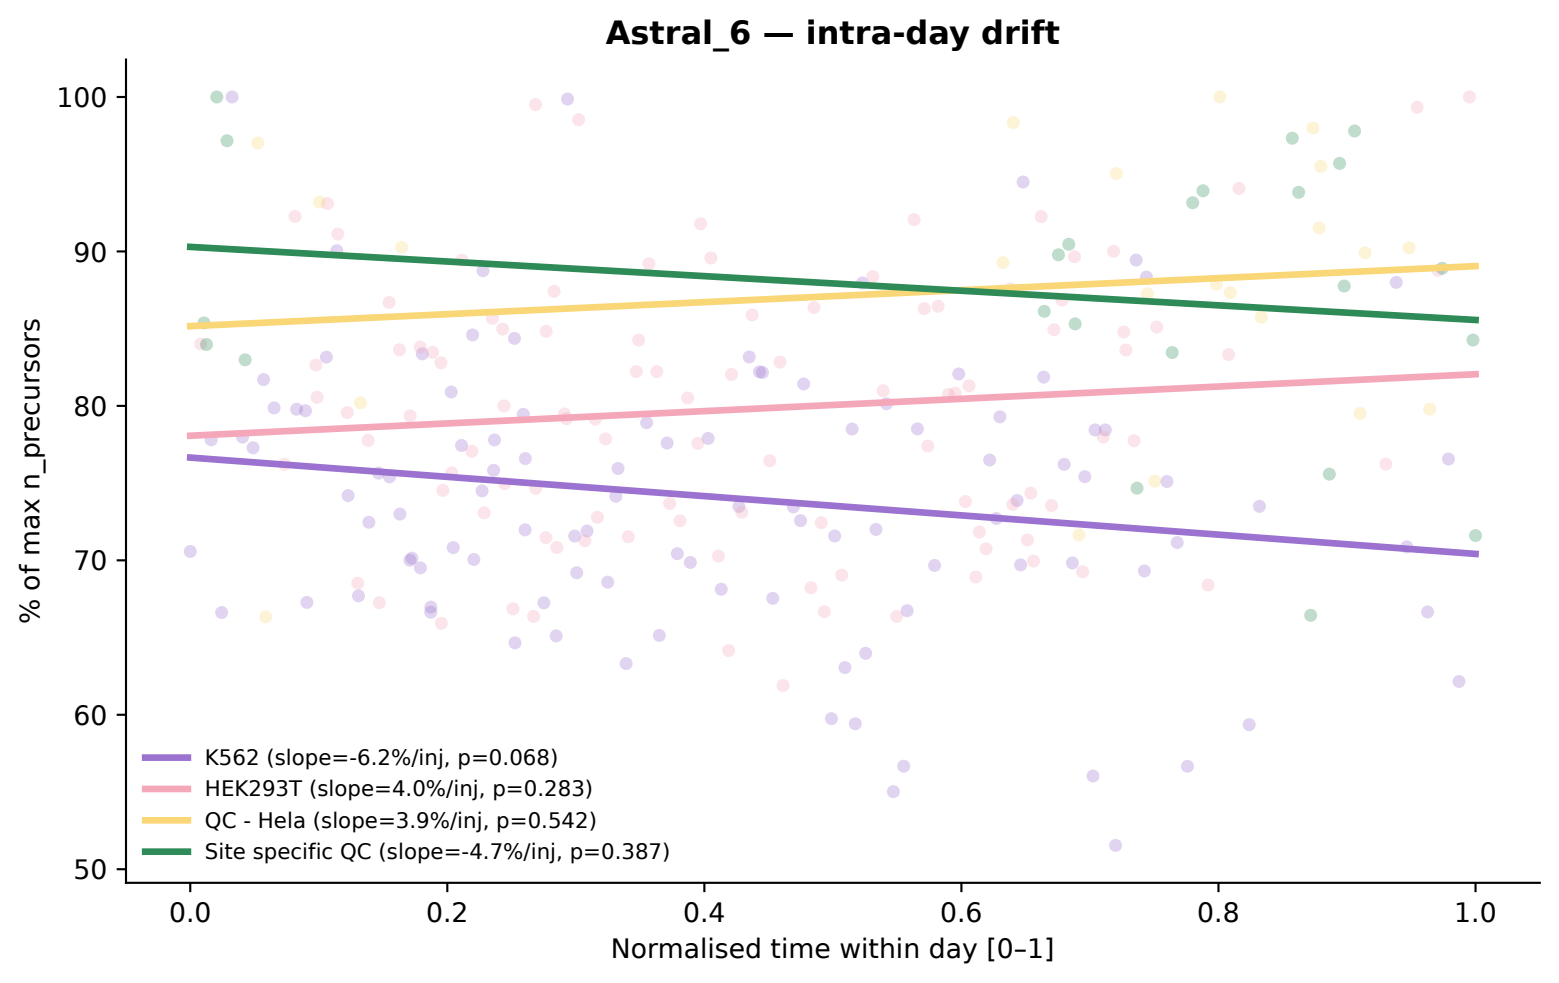
Astral_6 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-6.2%/inj, p=0.068)
HEK293T (slope=4.0%/inj, p=0.283)
QC - Hela (slope=3.9%/inj, p=0.542)
Site specific QC (slope=-4.7%/inj, p=0.387)