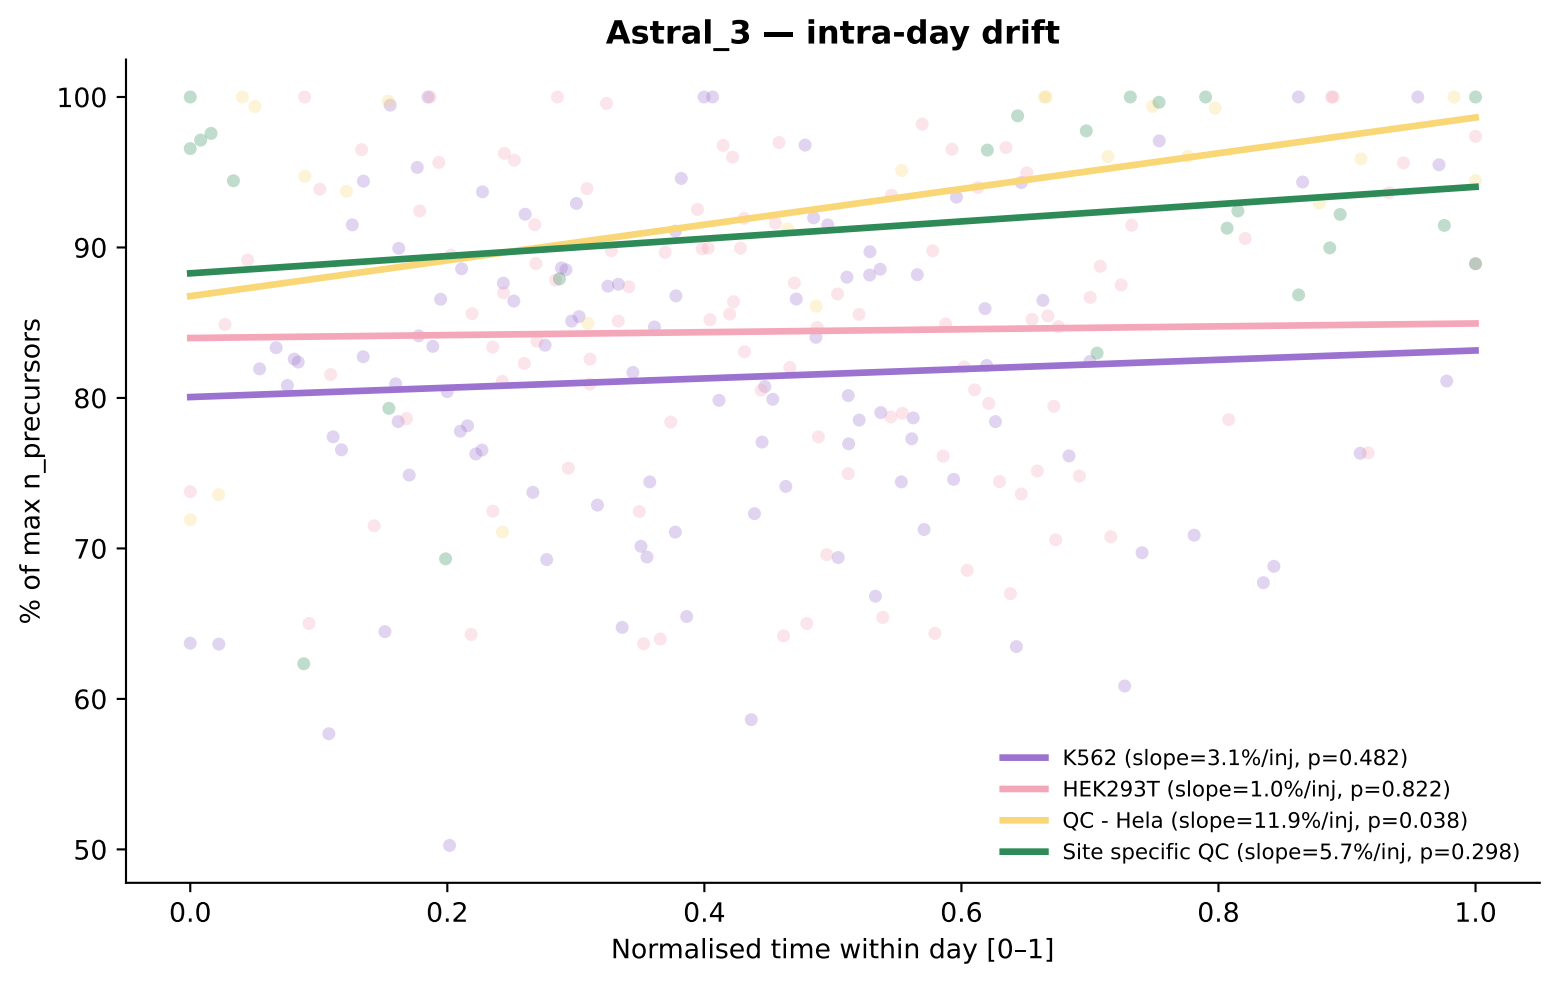
Astral_3 — intra-day drift
% of max n_precursors
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=3.1%/inj, p=0.482)
HEK293T (slope=1.0%/inj, p=0.822)
QC - Hela (slope=11.9%/inj, p=0.038)
Site specific QC (slope=5.7%/inj, p=0.298)