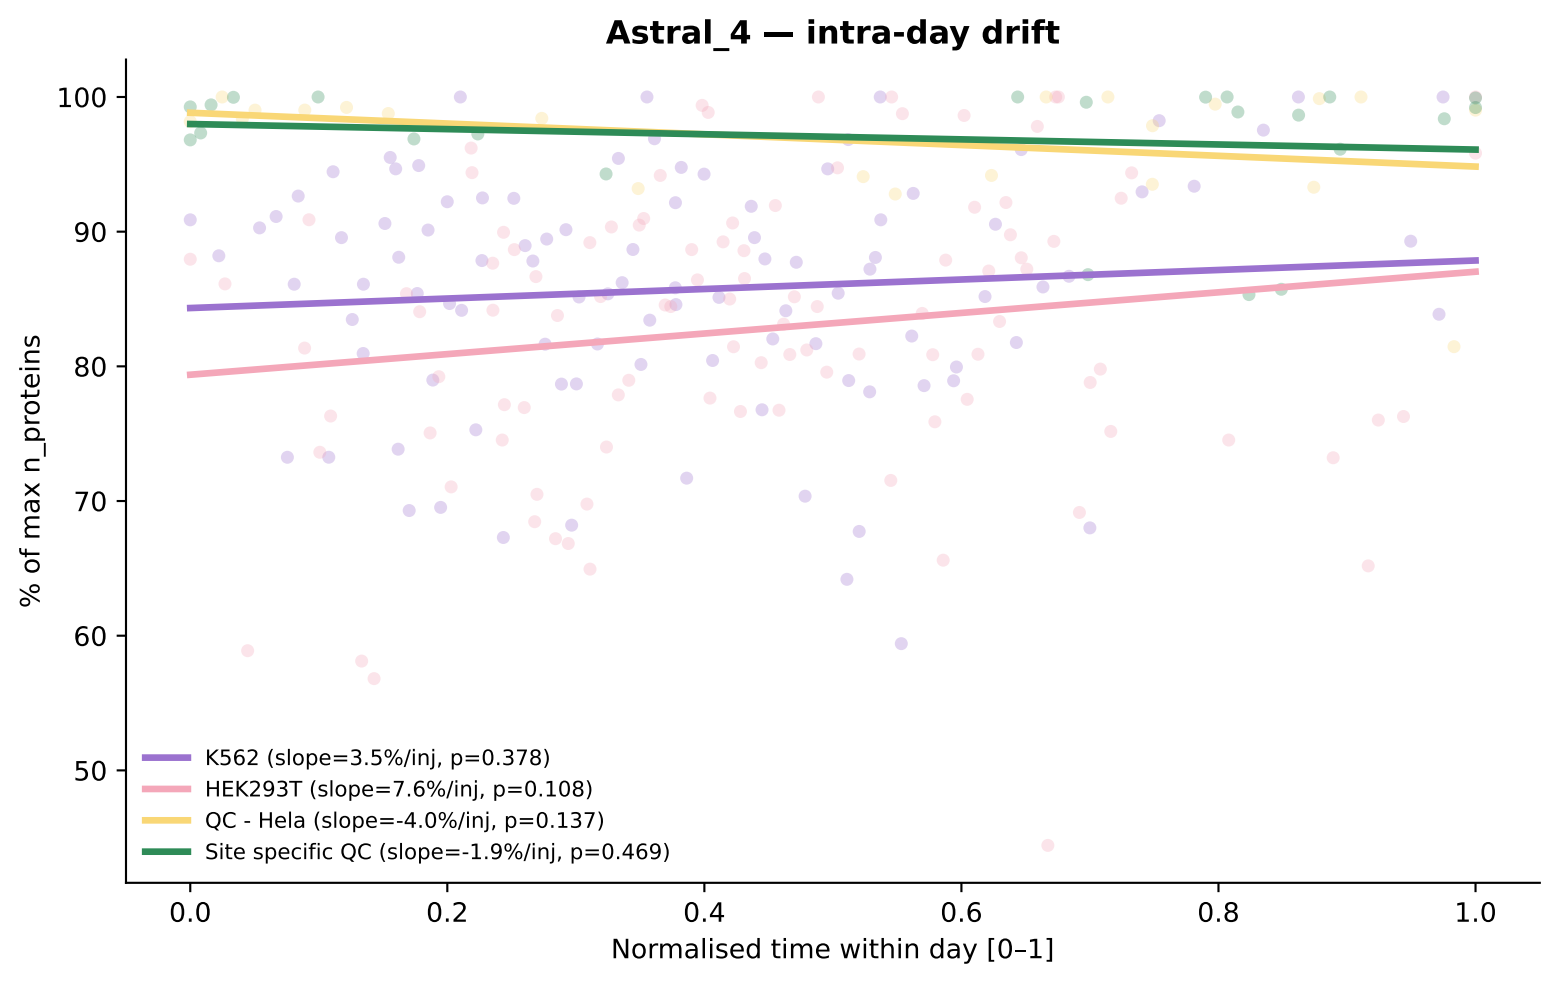
Astral_4 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=3.5%/inj, p=0.378)
HEK293T (slope=7.6%/inj, p=0.108)
QC - Hela (slope=-4.0%/inj, p=0.137)
Site specific QC (slope=-1.9%/inj, p=0.469)