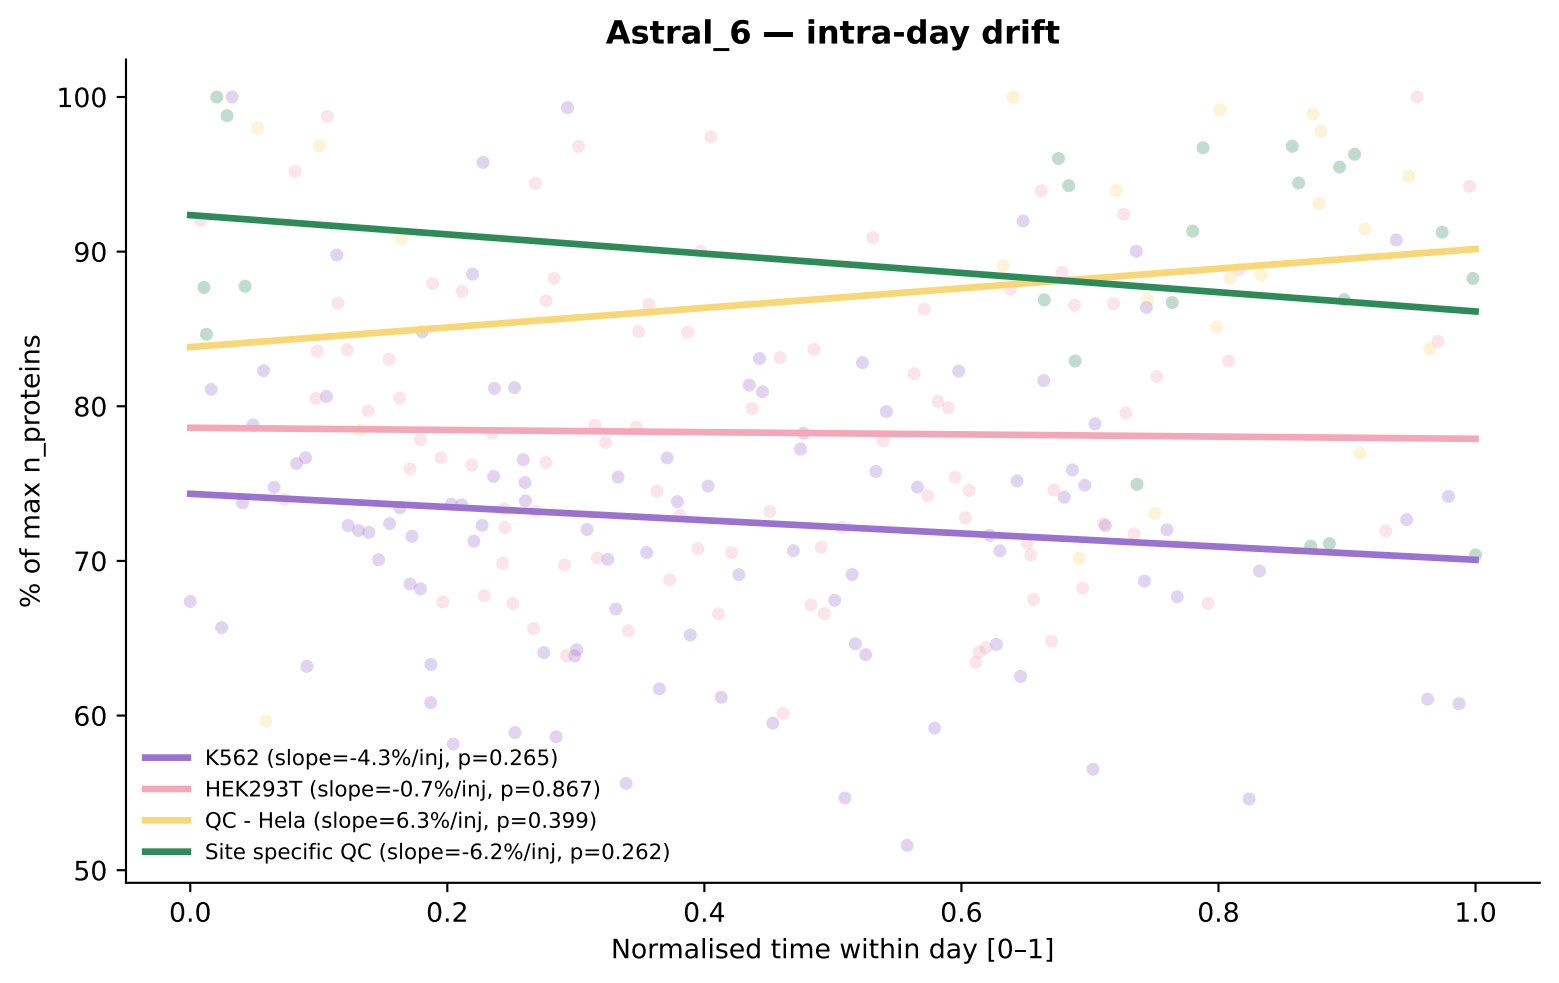
Astral_6 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
90
80
70
60
50
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-4.3%/inj, p=0.265)
HEK293T (slope=-0.7%/inj, p=0.867)
QC - Hela (slope=6.3%/inj, p=0.399)
Site specific QC (slope=-6.2%/inj, p=0.262)