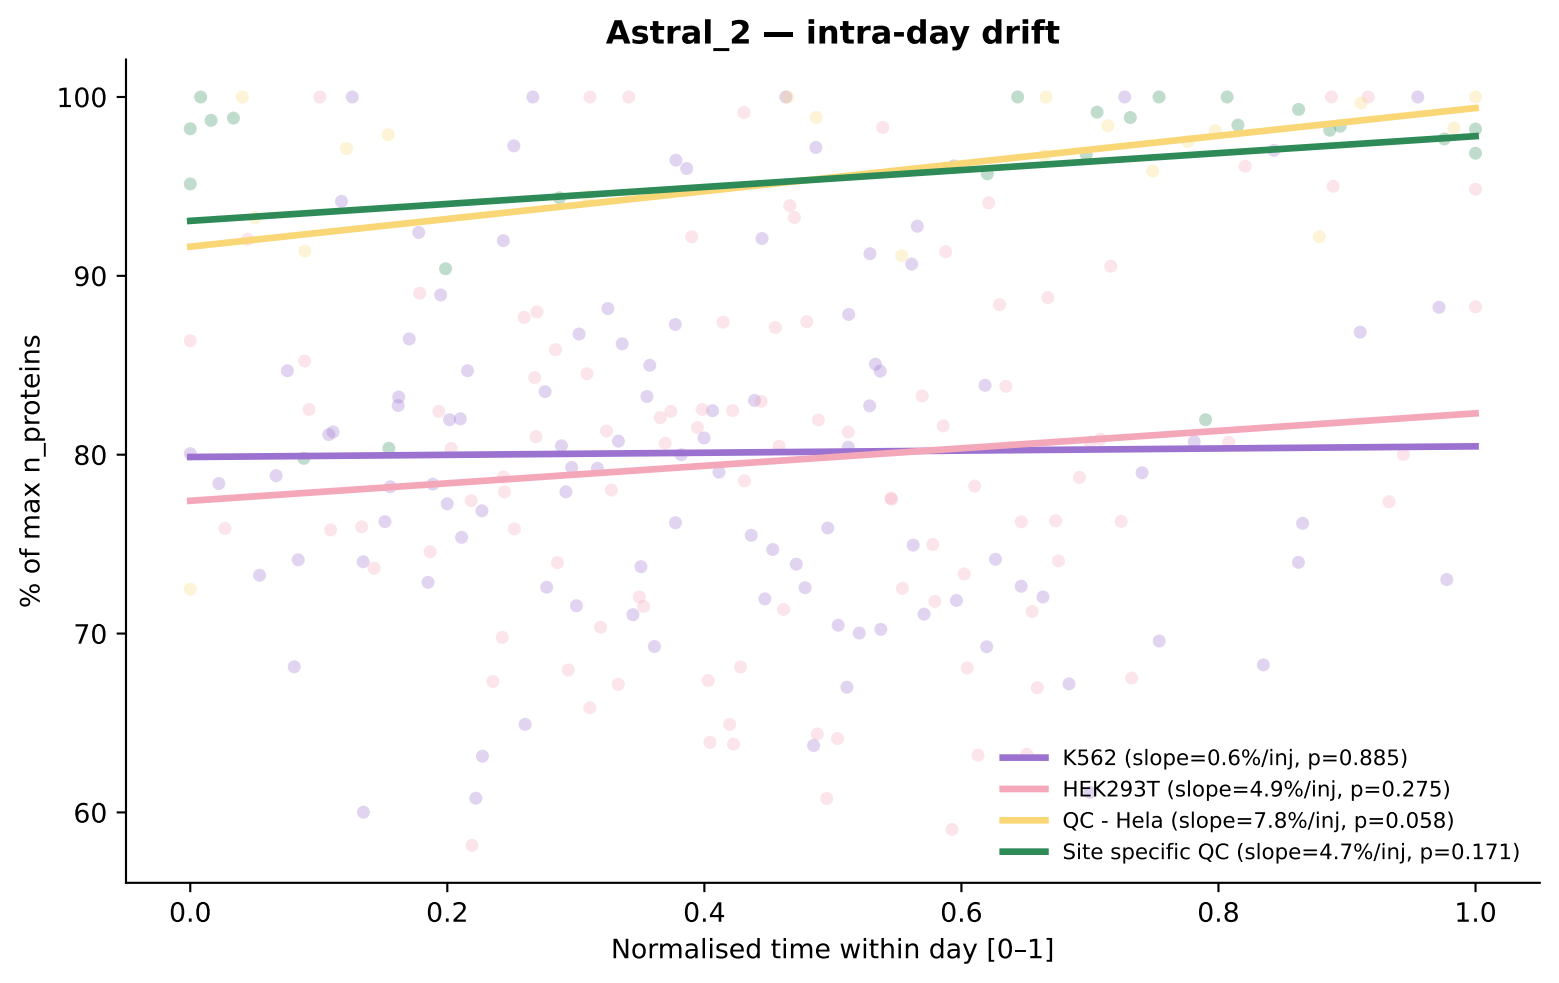
Astral_2 — intra-day drift
% of max n_proteins
Normalised time within day [0–1]
100
90
80
70
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
K562 (slope=0.6%/inj, p=0.885)
HEK293T (slope=4.9%/inj, p=0.275)
QC - Hela (slope=7.8%/inj, p=0.058)
Site specific QC (slope=4.7%/inj, p=0.171)