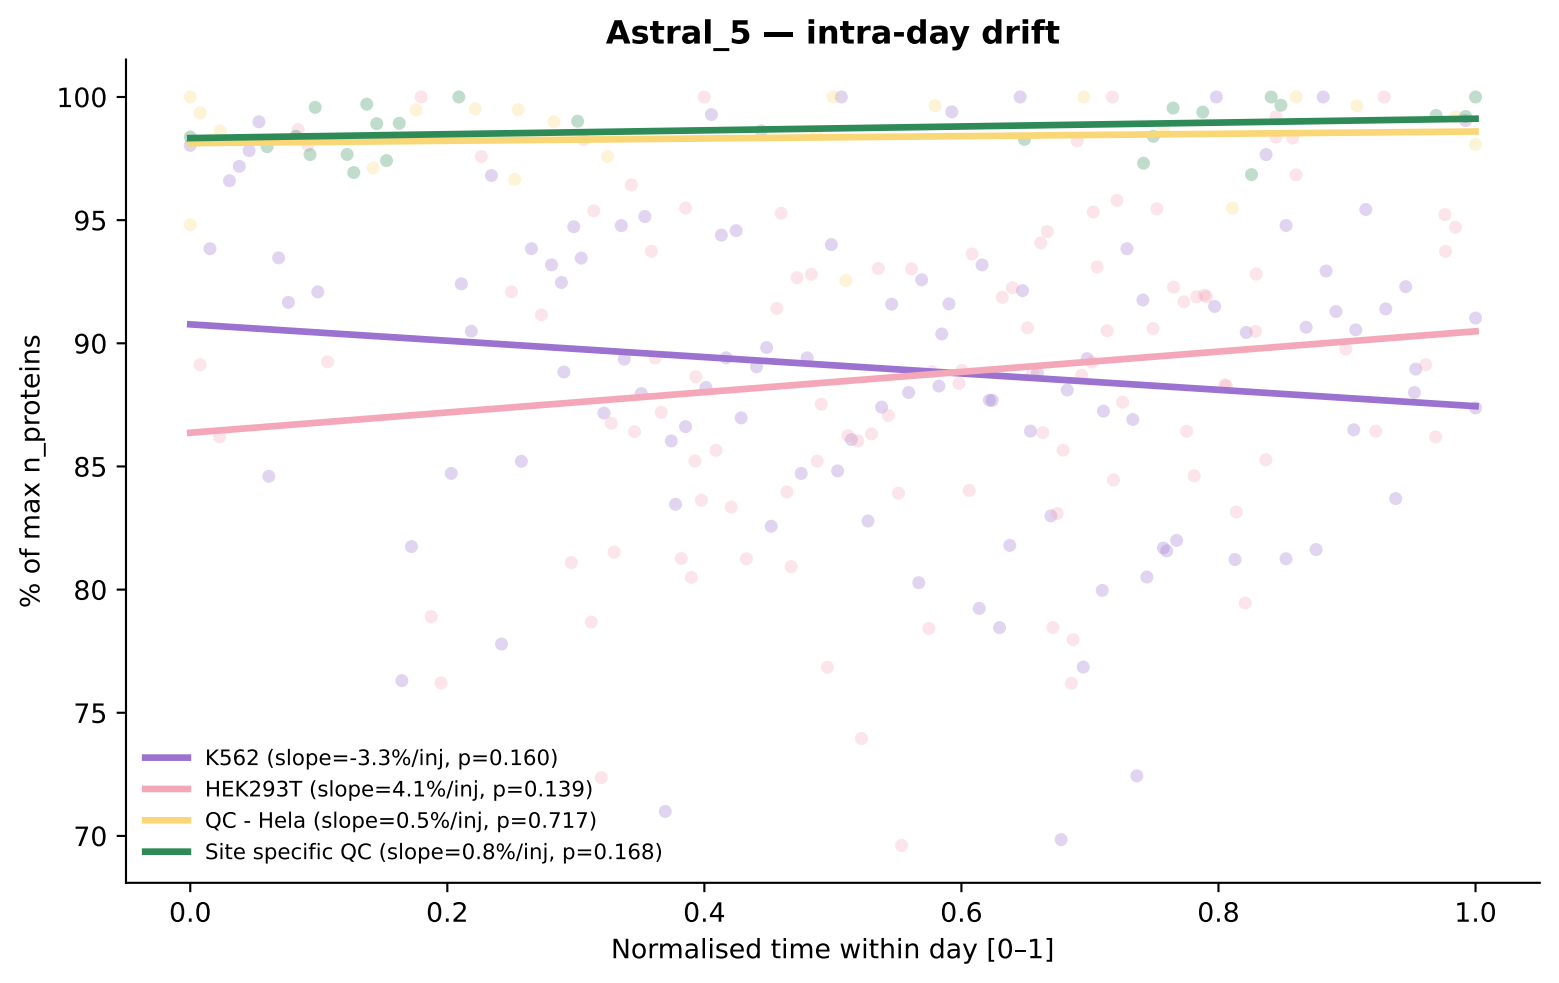
Astral_5 — intra-day drift
% of max n_proteins
100
95
90
85
80
75
70
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalised time within day [0–1]
K562 (slope=-3.3%/inj, p=0.160)
HEK293T (slope=4.1%/inj, p=0.139)
QC - Hela (slope=0.5%/inj, p=0.717)
Site specific QC (slope=0.8%/inj, p=0.168)