

# 人工肛門装具交換手順

## ✂ 用意するもの

装具（面板と袋）、人肌程度のお湯を入れた洗面器、脱脂綿またはガーゼ、ごみ袋、鏡  
液体石鹸（弱酸性）、ティッシュペーパー、はさみ、定規、クリップ、マジック

【必要時用意するもの】 剥離剤、被膜剤、パウダー、皮膚保護材、消臭剤等

## ✂ 交換前の準備

- 患者を椅子に浅く腰掛けさせ、患者にストーマ部分が見えるように、鏡をセットする
- 患者の衣類が、交換時に汚染しないように、上着は、クリップ等で下がらないようにとめ、ゴミ袋をストーマ下のズボンなどに挟み込む

## ✂ 交換手順


### ①装具をお腹から外す

患者の頭側から剥がす。皮膚保護材の隅を引き上げながら指で皮膚を面板から押し下げるようにゆっくりと剥がす。その後脱脂綿または剥離剤を使用してゆっくりと下に向けて剥がしていく。


**ポイント** 面板を濡らすようにすると、剥がれやすい。




### ②剥いだ面板の裏を見る

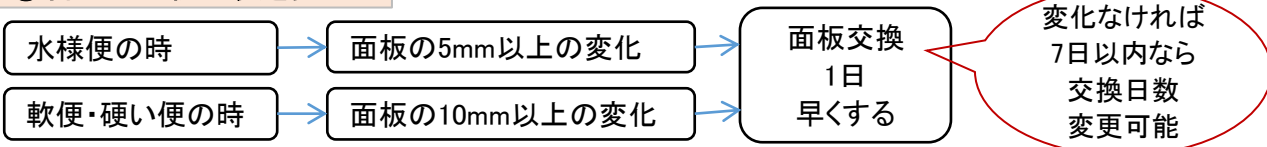


### ③皮膚を洗う

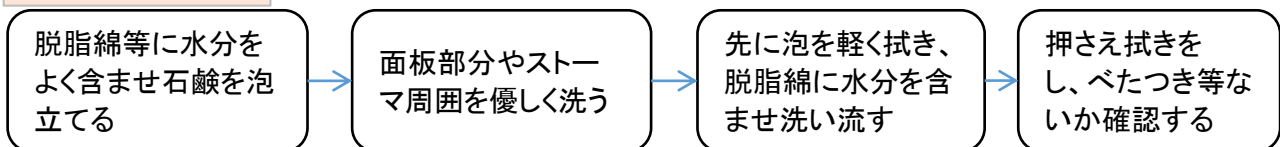

**ポイント** 皮膚にびらんがないか、しみる場所はないかも確認する。



### ④面板をつける

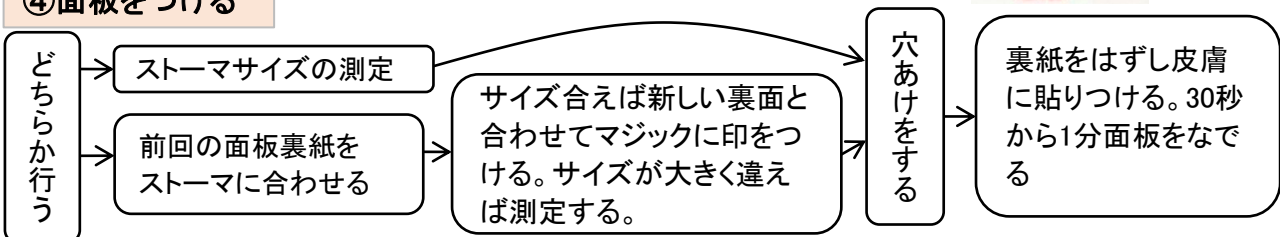

**ポイント** 被膜剤や皮膚保護材、パウダーは必要があればここで使用する。  
穴あけは水様便は1～2mm、軟便や硬便は2～3mm大きくあける。

### ⑤二品系装具の場合

袋の排泄口を閉じ、勘合部を合わせて円状に指を動かし取り付け。少し引張ってはずれないか確認する。

### ⑤単品系装具の場合 面板装着のコツ

面板を真ん中で軽く折り曲げて中心をストーマの中心に合わせる。その状態で面板を広げて貼ると大きくズレなく貼れる。