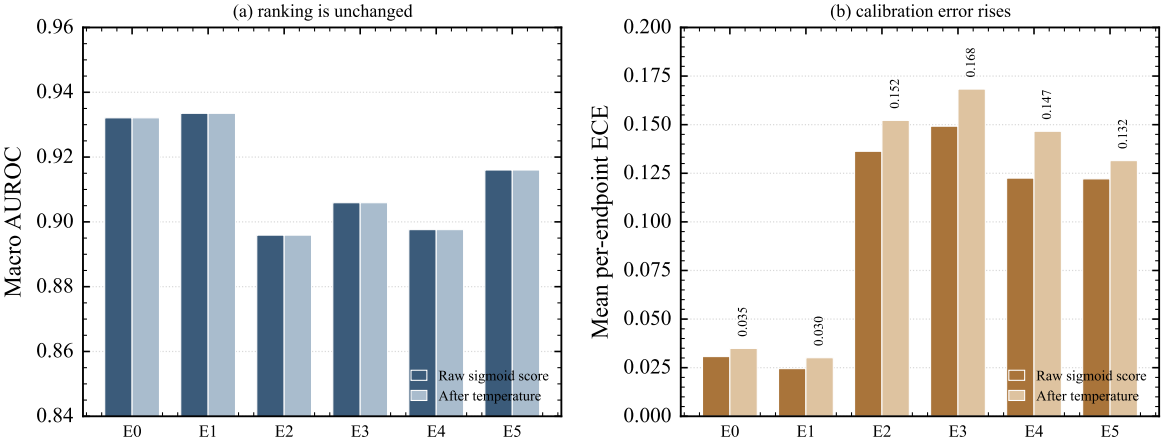
(a) ranking is unchanged
Macro AUROC
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
E0
E1
E2
E3
E4
E5
Raw sigmoid score
After temperature
(b) calibration error rises
Mean per-endpoint ECE
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0.035
0.030
0.152
0.168
0.147
0.132
E0
E1
E2
E3
E4
E5
Raw sigmoid score
After temperature