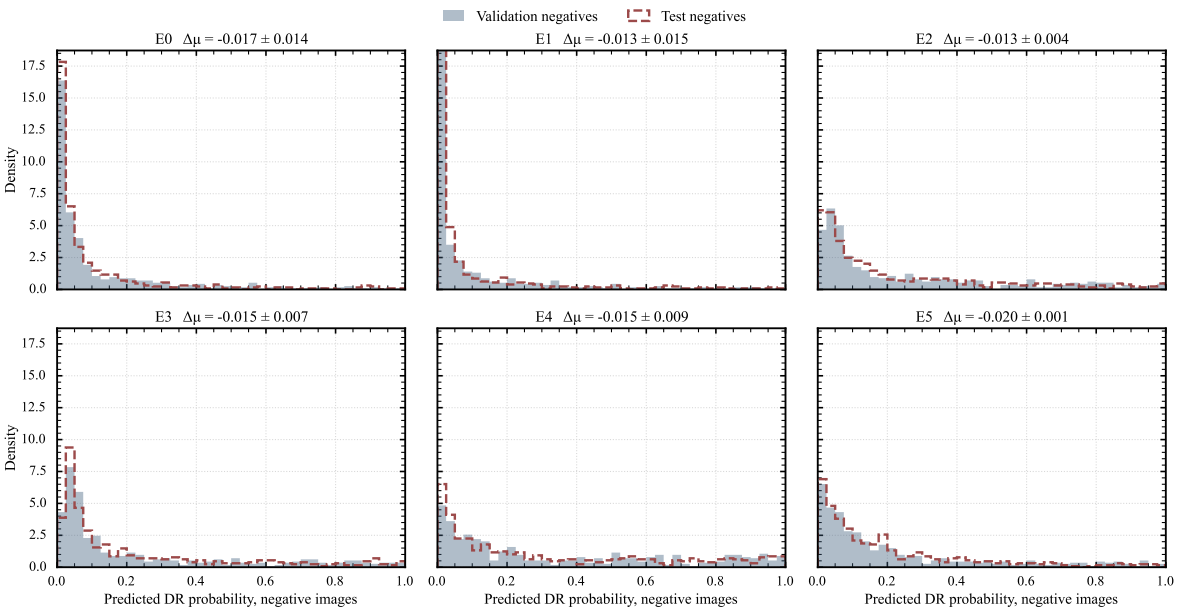
Validation negatives
Test negatives
E0 Δμ = -0.017 ± 0.014
E1 Δμ = -0.013 ± 0.015
E2 Δμ = -0.013 ± 0.004
E3 Δμ = -0.015 ± 0.007
E4 Δμ = -0.015 ± 0.009
E5 Δμ = -0.020 ± 0.001
Density
Predicted DR probability, negative images