


药物特异响应的测量可靠性极低
绝对丰度重测相关 0.92, 而 Δ 只有 0.12

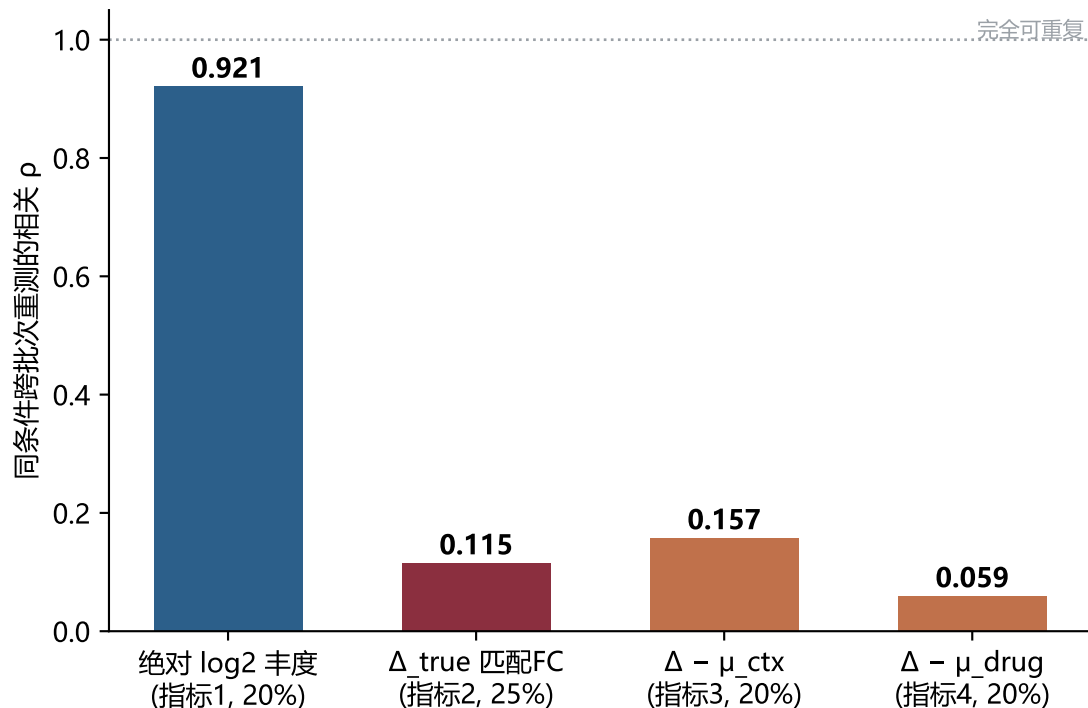

复制对定义：同化合物 + 同菌株/培养基/温度/时间，且板号或数据来源不同，共 4384 对。 μ 仅由训练折计算。

ρ 低说明信噪比弱、复杂模型易过拟合；但因预测与真值共享同一条对照噪声， $\sqrt{\rho}$ 不可当作评分上限。数据：scripts/audit/noise_ceiling.py