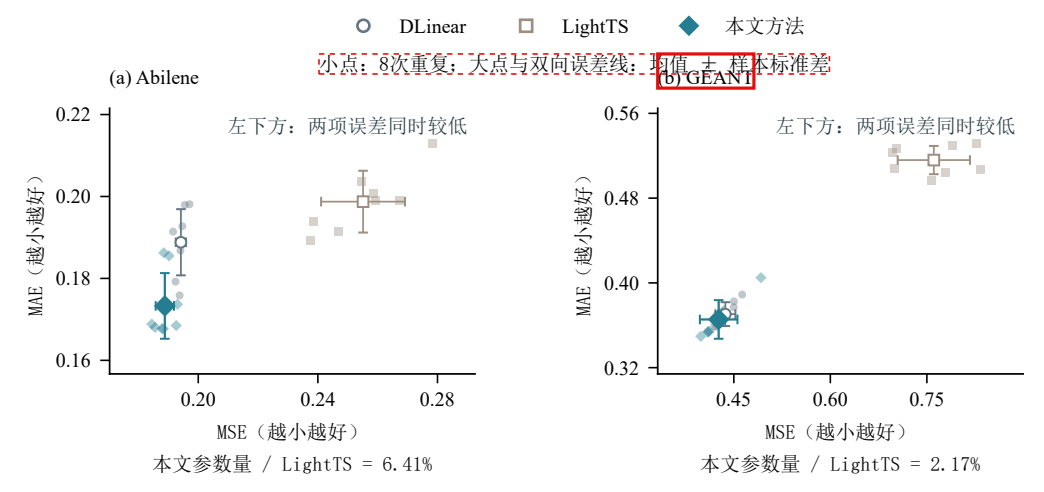
DLinear
LightTS
本文方法
小点：8次重复；大点与双向误差线：均值 ± 样本标准差
(a) Abilene
(b) GÉANT
左下方：两项误差同时较低
左下方：两项误差同时较低
MAE（越小越好）
MAE（越小越好）
0.22
0.20
0.18
0.16
0.56
0.48
0.40
0.32
0.20
0.24
0.28
0.45
0.60
0.75
MSE（越小越好）
MSE（越小越好）
本文参数量 / LightTS = 6.41%
本文参数量 / LightTS = 2.17%