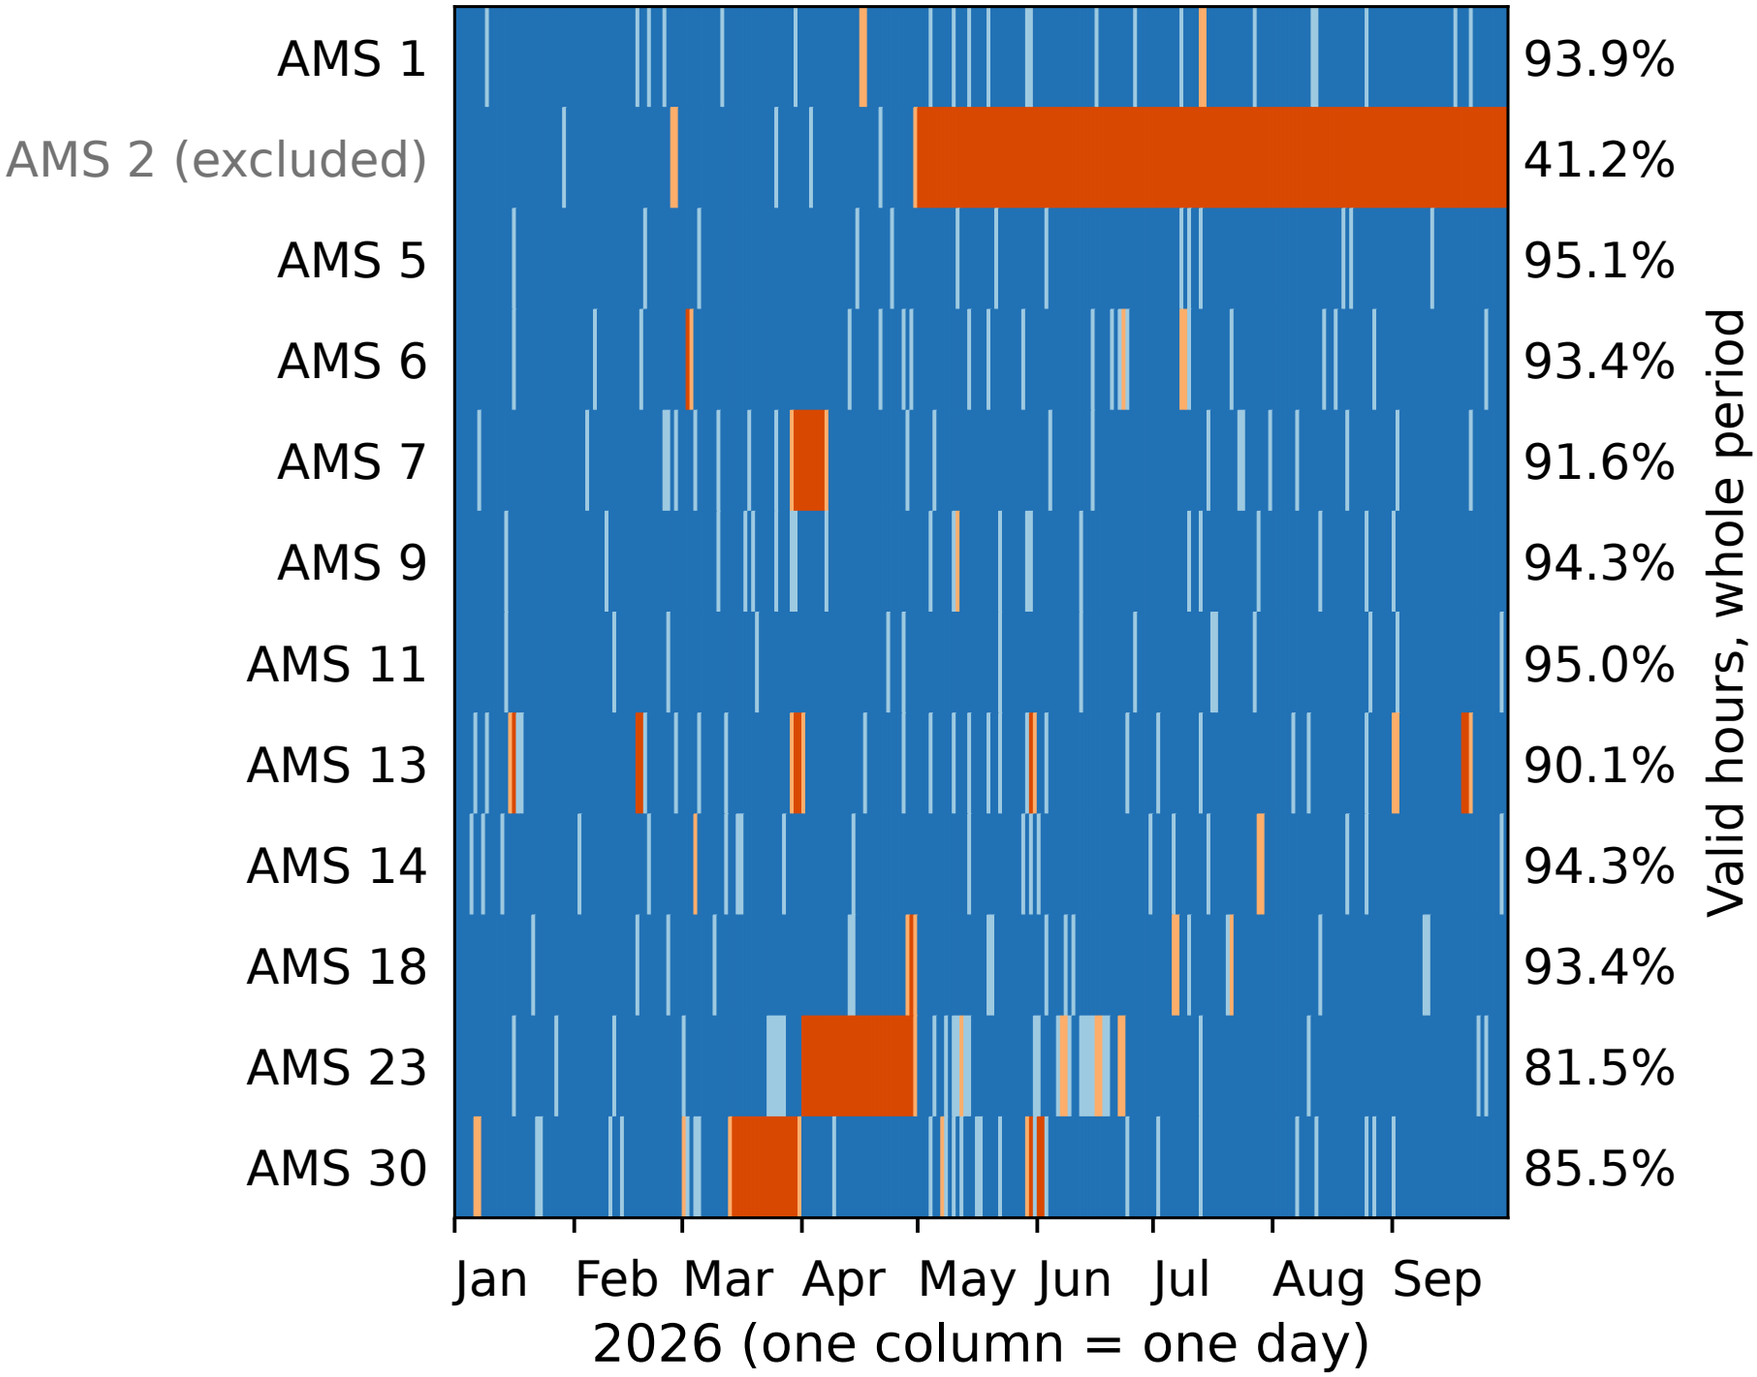

AMS 1
AMS 2 (excluded)
AMS 5
AMS 6
AMS 7
AMS 9
AMS 11
AMS 13
AMS 14
AMS 18
AMS 23
AMS 30
93.9%
41.2%
95.1%
93.4%
91.6%
94.3%
95.0%
90.1%
94.3%
93.4%
81.5%
85.5%
Valid hours, whole period
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
2026 (one column = one day)
Valid hourly CH4 observations per day (proportion of 24 h)
0 h (0%)
1-11 h (4-46%)
12-22 h (50-92%)
23-24 h (96-100%; normal operation with one daily zero/span hour)