

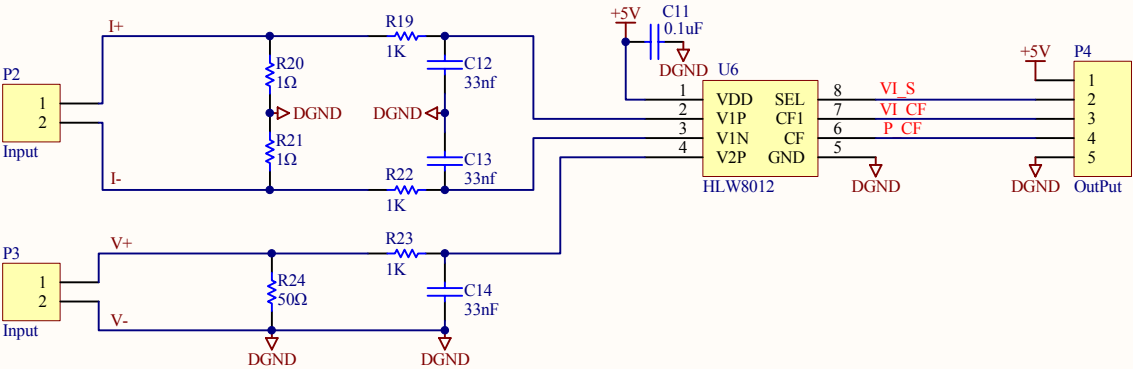


采样方式：隔离采样（互感器）

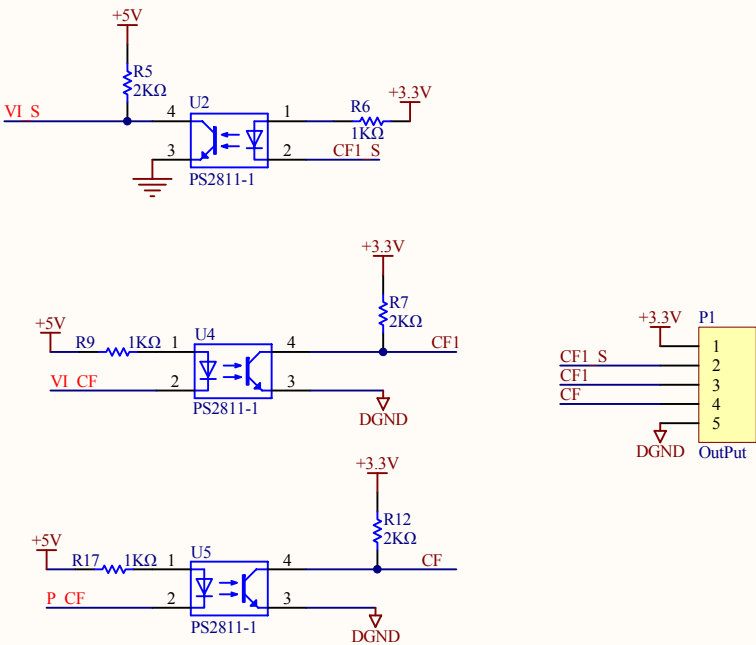

根据互感器输出的电流值不同，R20、R21、R2的阻值可做适当性调整

采样方式：非隔离采样

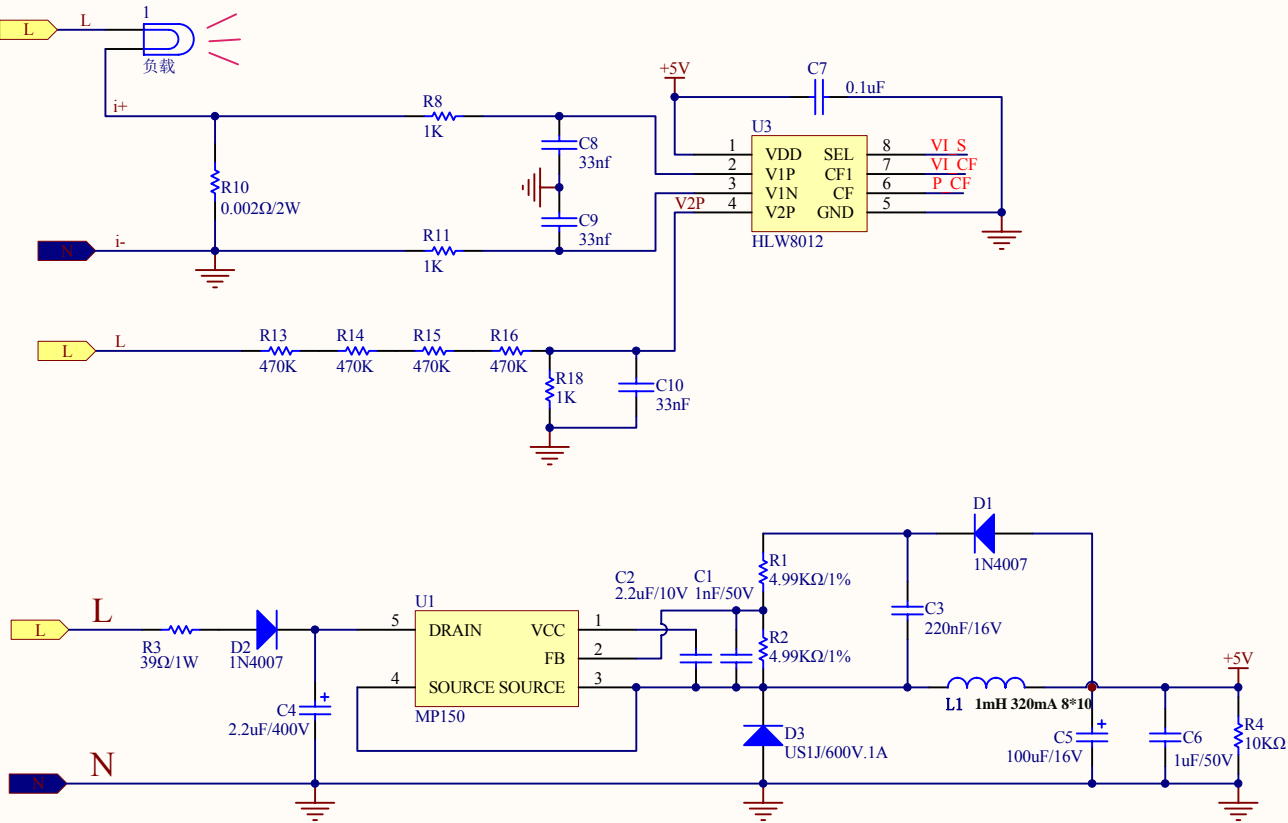

Title: HLW8012 DEMO 板原理图	
Author: Tuqiang	Size: A4
Data: 2014-01-15	Revesion: V2.0
DrawnBy: Tuqiang	
深圳市合力为科技有限公司 www.hiliwi.com	