QUELLEN UND ABHÄNGIGKEITEN

Was sagen die bisherigen Treffer?

Ein grafischer Einstieg in den geprüften Ausschnitt der Massen- und Konstantenrechnung.

Der Elektronentreffer nach der Konstantenkorrektur ist kein unabhängiger Vorhersagetest. Heim beschreibt, die gemessene Elektronenmasse und Ladung zusammen mit hbar und c einzusetzen und daraus Konstanten zurückzurechnen. Der Tabellenanhang verweist auf dieses Verfahren. [1]

Was geht hinein, was kommt heraus?

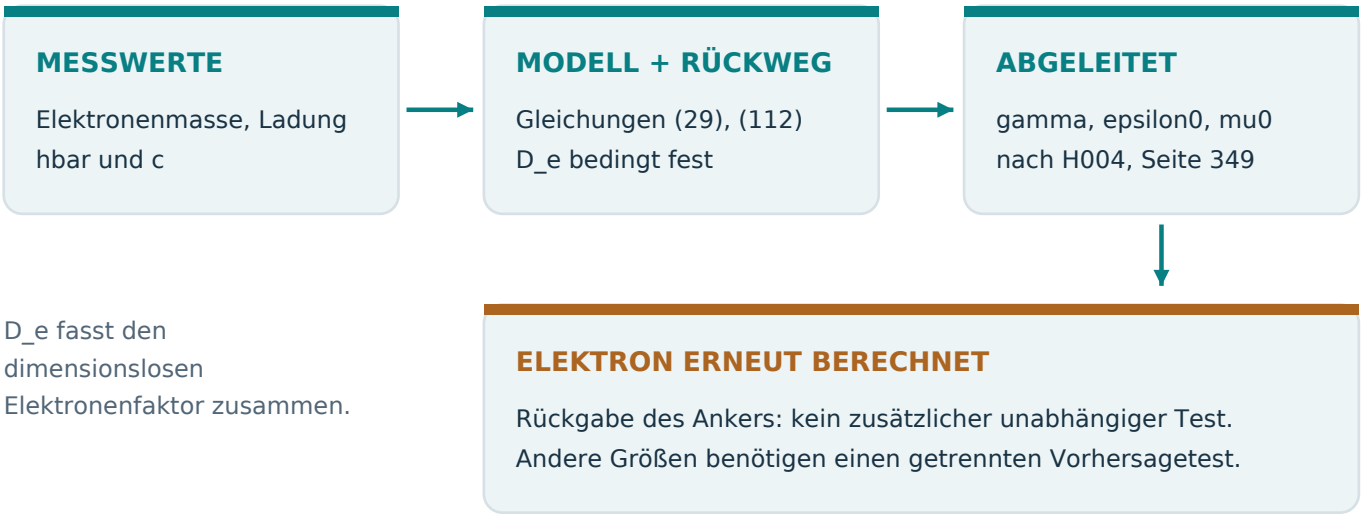

Eigene Darstellung nach H004, Druck 349/371. Keine vollständige Theorieübersicht.

Was darüber hinaus belegt ist

F_S: 17 zugeordnete Teilchenkomponenten; im Tabellenstand 16 Masseneinträge wegen gemeinsamem pi+/-Wert. Das sind keine 17 nachgewiesenen unabhängigen Messbedingungen. Die ursprüngliche F_S-Eingabeliste bleibt offen. [2]

Y-Faktoren: Alle Y_k=1 ist eine ausdrücklich genannte Tabellenannahme, damit auch Y41-44=1. Eine unabhängige Herleitung dieser Festlegung ist dadurch nicht belegt. [2]

Nächster aussagekräftiger Test: Einen historischen Eingabesatz festlegen und eine zusätzliche Größe prüfen, die weder direkt noch indirekt zur Anpassung verwendet wurde. Eine Rückrechnung allein ist kein Gegenbeweis gegen das Modell.

ZAHLEN UND REICHWEITE

Passen die Druckwerte zusammen?

Zwei getrennte Konsistenzchecks. Punkte: Zentralwerte. Balken: die jeweils benannte Spanne.

Lichtgeschwindigkeit: Druckwerte sind vereinbar

Aus epsilon0 und mu0
Angenommene Druckrundung

PDG 1974
Messwert +/- 1 Standardabweichung

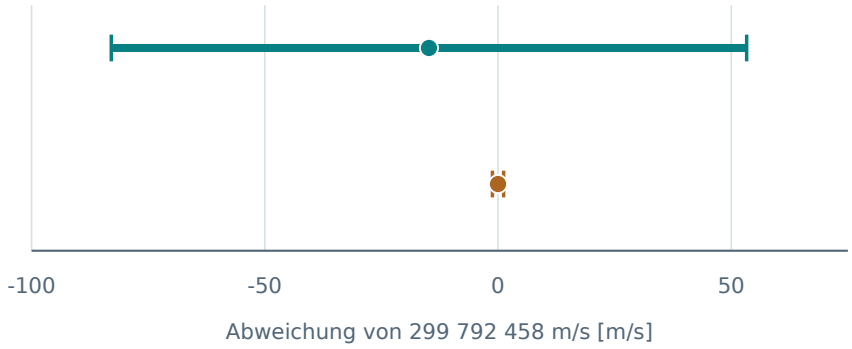

Rundungsbereich und Messunsicherheit sind unterschiedliche Angaben.

Elementarladung: kleine bedingte Abweichung

Gedruckte Ladung
H004, Seite 371: Rundungsbereich

Aus Gleichung (29)
H003-Brücke + H004-Endkonstanten

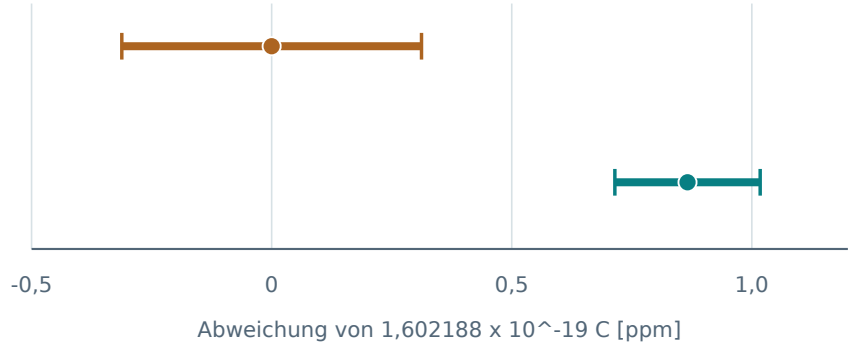

Beide Balken: angenommene Druckrundung. Endpunkte numerisch ausgewertet.

Einordnung

Die Ladungsdifferenz beträgt rund **0,87 ppm**. Unter der geprüften Editionsbrücke überlappen die angenommenen Rundungsbereiche nicht. Die damalige Messunsicherheit lag bei rund 2,9 ppm (eine Standardabweichung). Das ist ein bedingter Darstellungsbefund, kein empirischer Widerlegungsnachweis. [1,3]

Methodik: Rundung auf die nächste letzte Druckstelle angenommen. c-Produktprüfung mit exakten Brüchen; Ladungsendpunkte bei 60/90 Dezimalstellen stabil, ohne zertifizierte Intervallrechnung. Originale ungerundete Eingaben und vollständige historische Kalibrierung fehlen weiterhin.

Quellen: [1] Heim, Bd. II, lokale Ausgabe 1996 (H004), Druck 253, 301-302, 344, 349, 371; Bd. I, Ausgabe 1998 (H003), Druck 242, 247-248. [2] H004, Einführung 1-3, Druck 288-291, 342-343, 371-376. [3] PDG, Review of Particle Properties, April 1974 (M006), Druck 15. Quellhashes und Detailbelege: Berichte FS_PROVENANCE und CONSTANTS_ANCHOR vom 18.10.2026 unter 06_docs/. Grafiken und Einordnung: eigene Rekonstruktion.