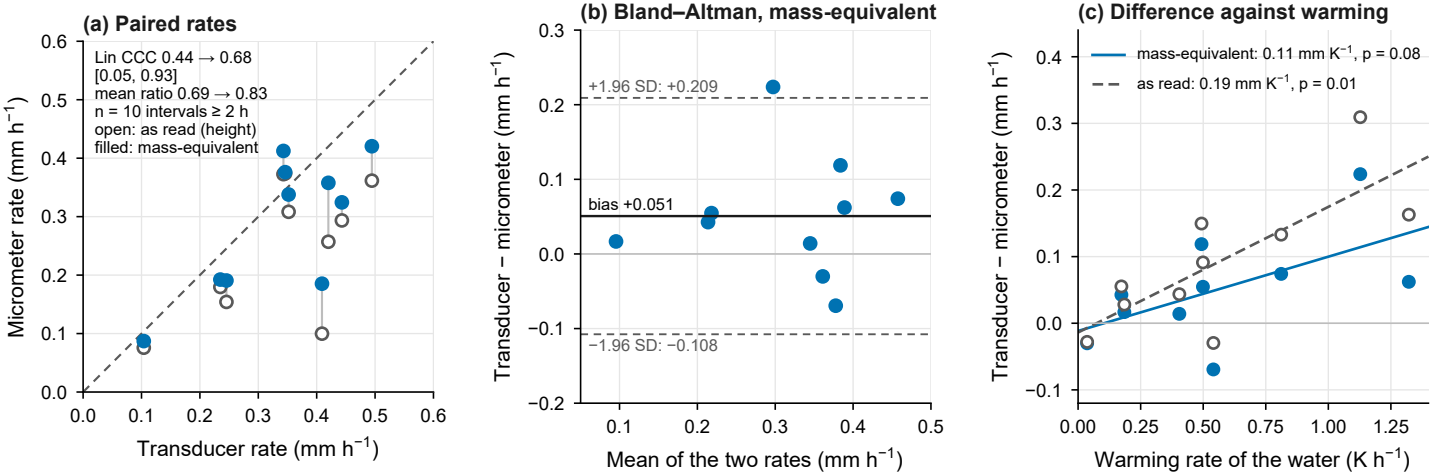
(a) Paired rates
Lin CCC 0.44 → 0.68
[0.05, 0.93]
mean ratio 0.69 → 0.83
n = 10 intervals ≥ 2 h
open: as read (height)
filled: mass-equivalent
Micrometer rate (mm h−1)
Transducer rate (mm h−1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
(b) Bland–Altman, mass-equivalent
+1.96 SD: +0.209
bias +0.051
−1.96 SD: −0.108
Transducer − micrometer (mm h−1)
Mean of the two rates (mm h−1)
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
(c) Difference against warming
mass-equivalent: 0.11 mm K−1, p = 0.08
as read: 0.19 mm K−1, p = 0.01
Transducer − micrometer (mm h−1)
Warming rate of the water (K h−1)
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25