



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	電子吊秤	品牌／型號／規格	AHT-II-500																								
編	號	SM14	允	差	±2kg																							
精	度	0.1kg	保	管	單	位																						
校	驗	類	別	☐ 內校	☐ 外校	校	驗	週	期	一年																		
				☒ 免校	汰	換	週	期	-																			
送修紀錄																												
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員																					
校驗紀錄																												
校	驗	日	校	驗	單	位	校		驗	內	容	合	格	判	定	判	定	人	預	計	下	次	校	驗	日	期	備	註
2020/03/02			安	和	衡	器	80BF0707000047		OK		江		冠		毅		2021/03/02		新		購							
移轉紀錄																												
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交	接	人	交	接	單	位	原因備註												
2023.5.4		江	冠	毅	廠	存	單	位	黃	形	承					移資產												



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	電子吊秤	品牌／型號／規格	AHT-II-500		
編	號	M014	允	差	±2kg	
精	度	0.1kg	保	管	單	位
校 驗 類 別		☐ 內校 ☐ 外校	校 驗 週 期		一年	
		☒ 免校	汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2020/03/02	安和衡器	80BF0707000047	OK	江冠毅	2021/03/02	新購
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	




台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表



名	稱	電子吊秤	品牌／型號／規格	AHT-II-500		
編	號	M014	允	差	±2kg	
精	度	0.1kg	保	管	單	位
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校	校	驗
				☐ 免校	汰	換
				週	期	一年
				週	期	-
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校	驗	日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人
2020/03/02	安和衡器	80BF0707000047	OK	江冠毅	2021/03/02	新購
移轉紀錄						
日	期	移	交	人	移交單位	交接人

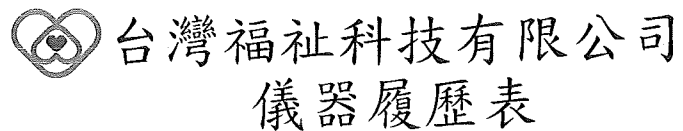

儀器履歷表

105/12/01V01. TB-T17

安和衡器有限公司

樹八 1614

電子秤重量檢正紀錄

1. 客戶名稱：台灣福祉科技有限公司
2. 地址：新北市樹林區八德街 230 號
3. 產品型號：AHT-II
4. 秤量/感量：500kg / 0.1kg
5. 檢定日期：2020 年 03 月 02 日(一)
6. 器 號：18117
7. 檢正紀錄：



標 準 值	顯 示 值	器 差
100kg	100.0kg	±0.0kg
200kg	200.0kg	±0.0kg
300kg	300.0kg	±0.0kg
400kg	400.0kg	±0.0kg
500kg	499.99kg	-0.1kg
以下空白		

壹.測量時環境溫度：攝氏 19 度。

貳.檢正用標準器：以經濟部標準局校正合格之標準砝碼

公司簽章：安和衡器有限公司

校正人員簽章：王韋中

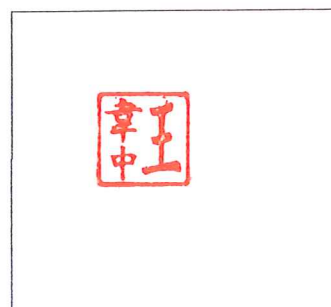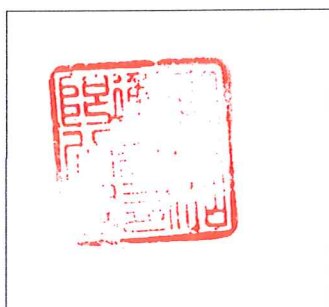

經濟部標準檢驗局校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下

此致

1/2

安和衡器有限公司

No. 80BF0707000047

申請日期	107年12月05日	申請者名稱	安和衡器有限公司
負責人	王上睿	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第05399號
電話	02-22686408	地址	新北市土城區亞洲路39號
所有人	安和衡器有限公司	所有人地址	新北市土城區亞洲路39號

下列器具經校驗結果：

器名	廠牌	器號或記號	器量	材質	校驗結果
法碼		A	20kg	鑄鐵	20.0001kg
法碼		B	20kg	鑄鐵	20.0004kg
法碼		C	20kg	鑄鐵	20.0004kg
法碼		D	20kg	鑄鐵	19.9998kg
法碼		E	20kg	鑄鐵	20.0004kg
法碼		F	20kg	鑄鐵	19.9998kg
法碼		G	20kg	鑄鐵	20.0002kg
法碼		H	20kg	鑄鐵	20.0004kg
法碼		I	20kg	鑄鐵	19.9996kg
法碼		J	20kg	鑄鐵	19.9998kg

校畢日期： 107 年 12 月 06 日

校驗地點： 臺北市士林區承德路5段78號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MET-070-100

第七組組長
蔡孟祁

局長授權簽發

經濟部標準檢驗局校驗服務報告書

表列各器業經校驗完畢，茲將校驗結果記錄如下

此致

2/2

安和衡器有限公司

No. 80BF0707000047

申請日期	107年12月05日	申請者名稱	安和衡器有限公司
負責人	王上睿	度量衡器營業許可執照號碼	標度字第05399號
電話	02-22686408	地址	新北市土城區亞洲路39號
所有人	安和衡器有限公司	所有人地址	新北市土城區亞洲路39號

下列器具經校驗結果：

器名	廠牌	器號或記號	器量	材質	校驗結果
法碼		1	100kg	鑄鐵	99.99kg
法碼		2	500kg	鑄鐵	499.95kg
法碼		3	500kg	鑄鐵	499.96kg
法碼		4	1000kg	鑄鐵	999.93kg
		以下空白			
		--			
		--			
		--			
		--			
		--			

校畢日期：107年12月06日

校驗地點：臺北市士林區承德路5段78號

備註：

注意事項：

- 一、受校驗器具請於三日內提回。
- 二、逾期不提回者視同棄權由本局處理之。
- 三、器具存放期間內遇人力不可抗拒之災害損失本局概不負責賠償責任。

MET-070-100

第七組組長
蔡孟祁

局長授權簽發