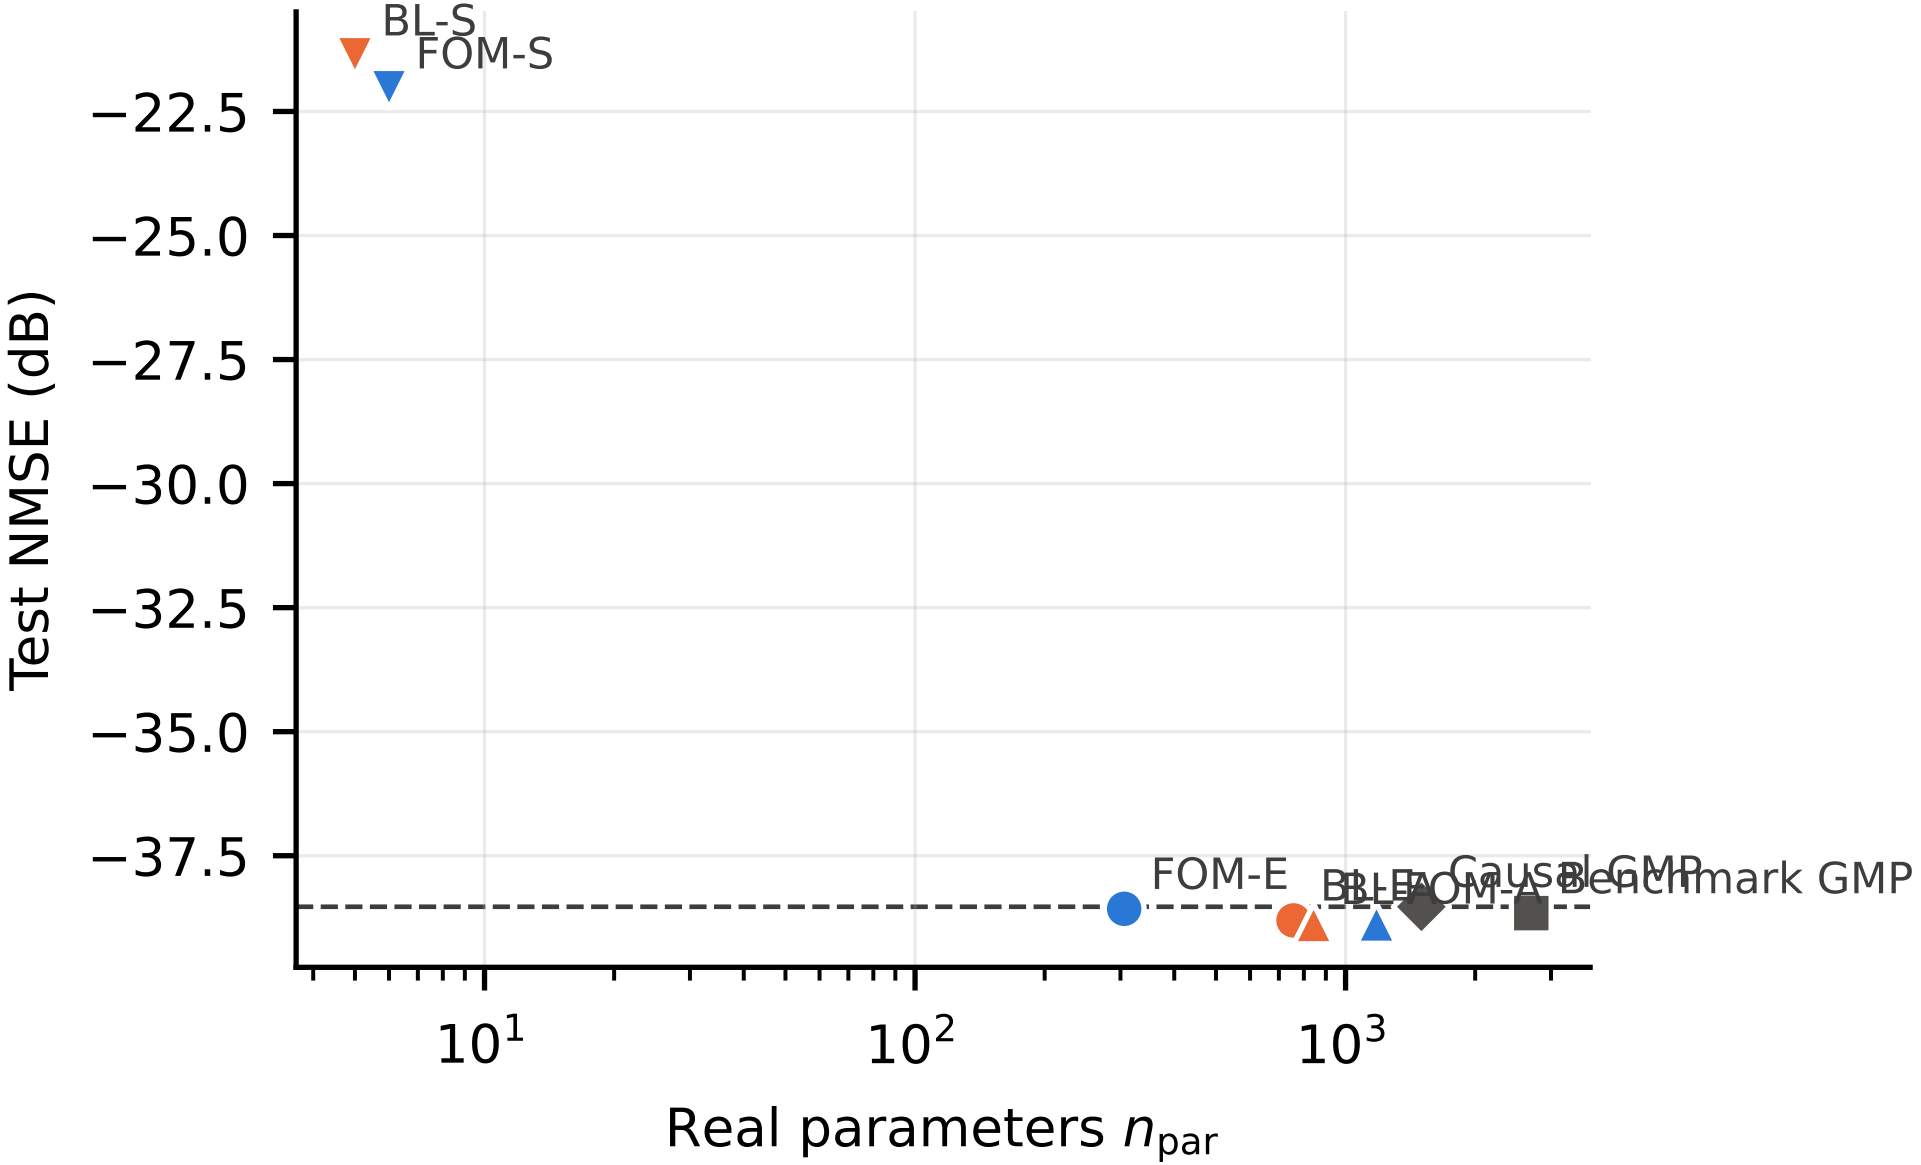
BL-S
FOM-S
−22.5
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
−35.0
−37.5
Test NMSE (dB)
FOM-E
BL-E
FOM-A
Causal GMP
Benchmark GMP
10^1
10^2
10^3
Real parameters n_{par}