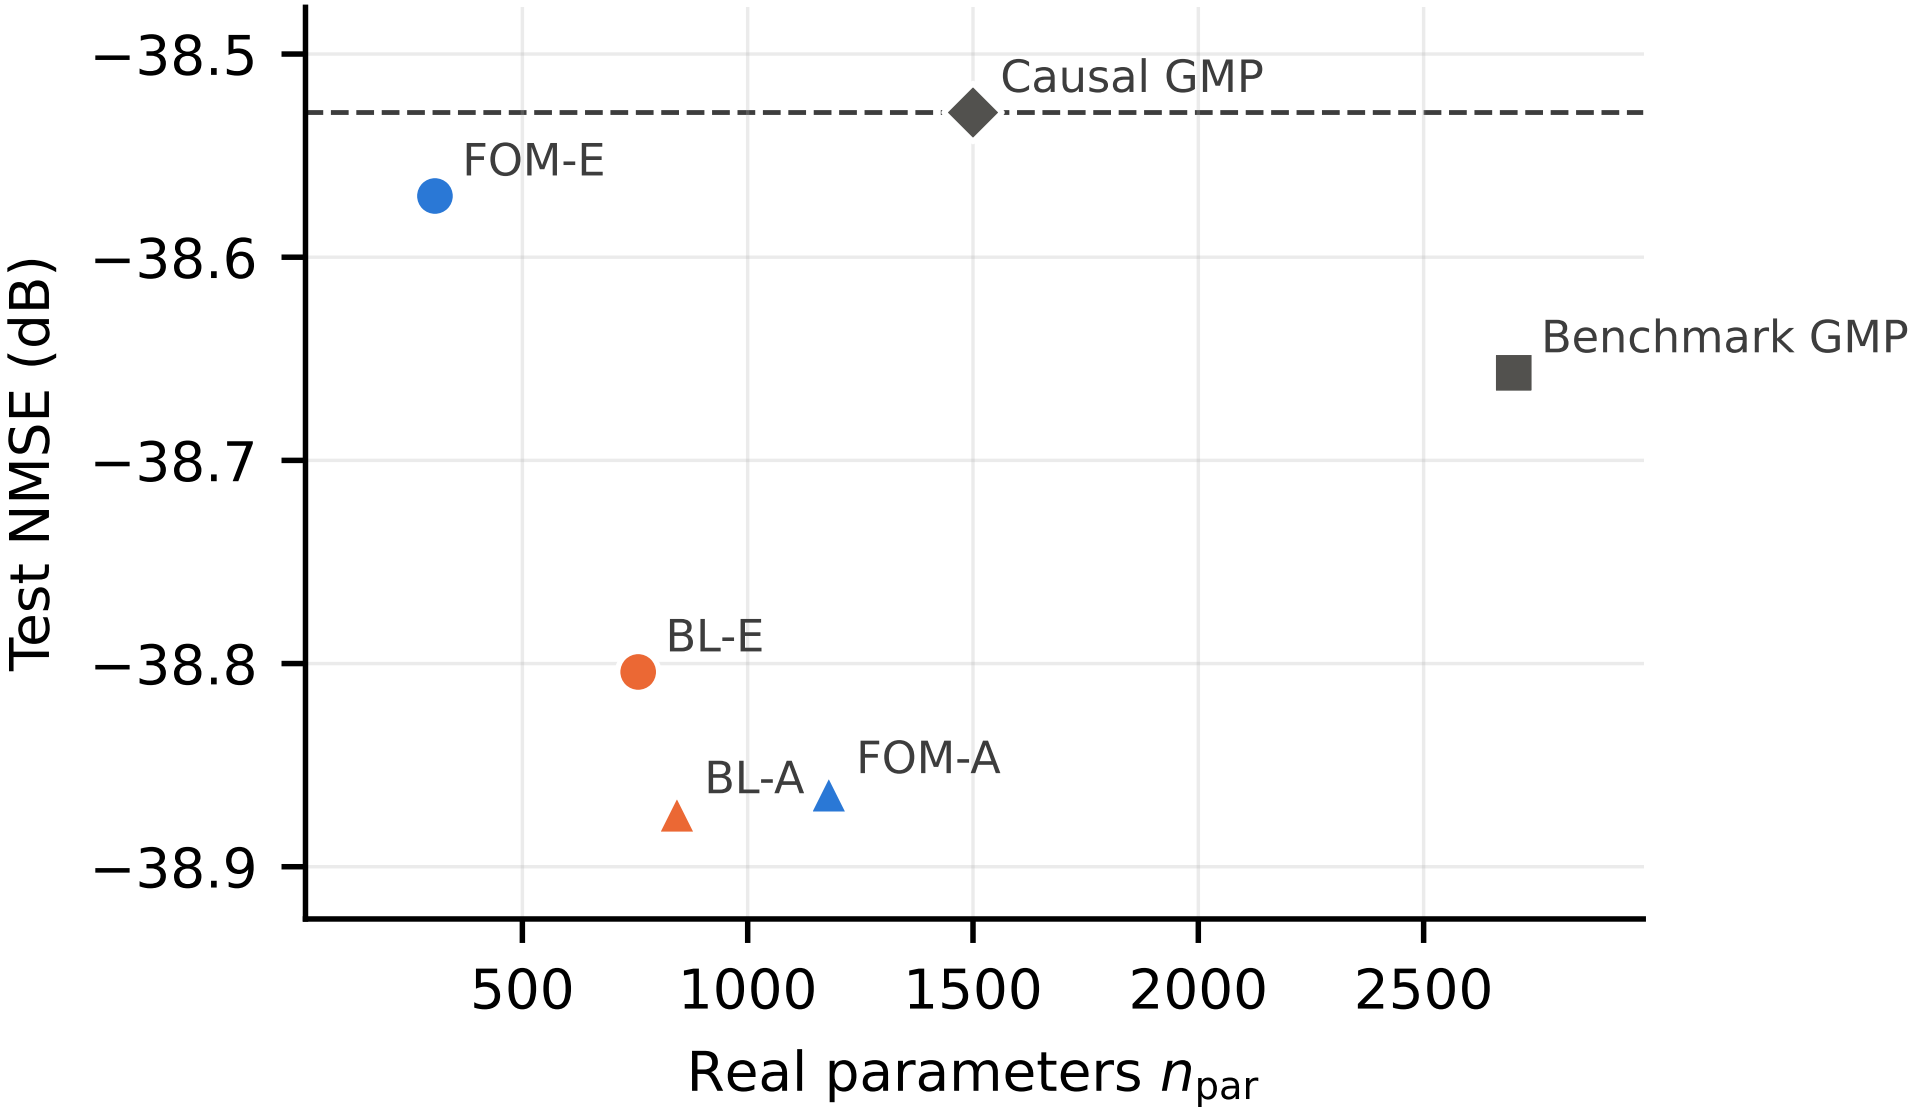
−38.5
−38.6
−38.7
−38.8
−38.9
Test NMSE (dB)
Causal GMP
FOM-E
Benchmark GMP
BL-E
BL-A
FOM-A
500
1000
1500
2000
2500
Real parameters n_{par}