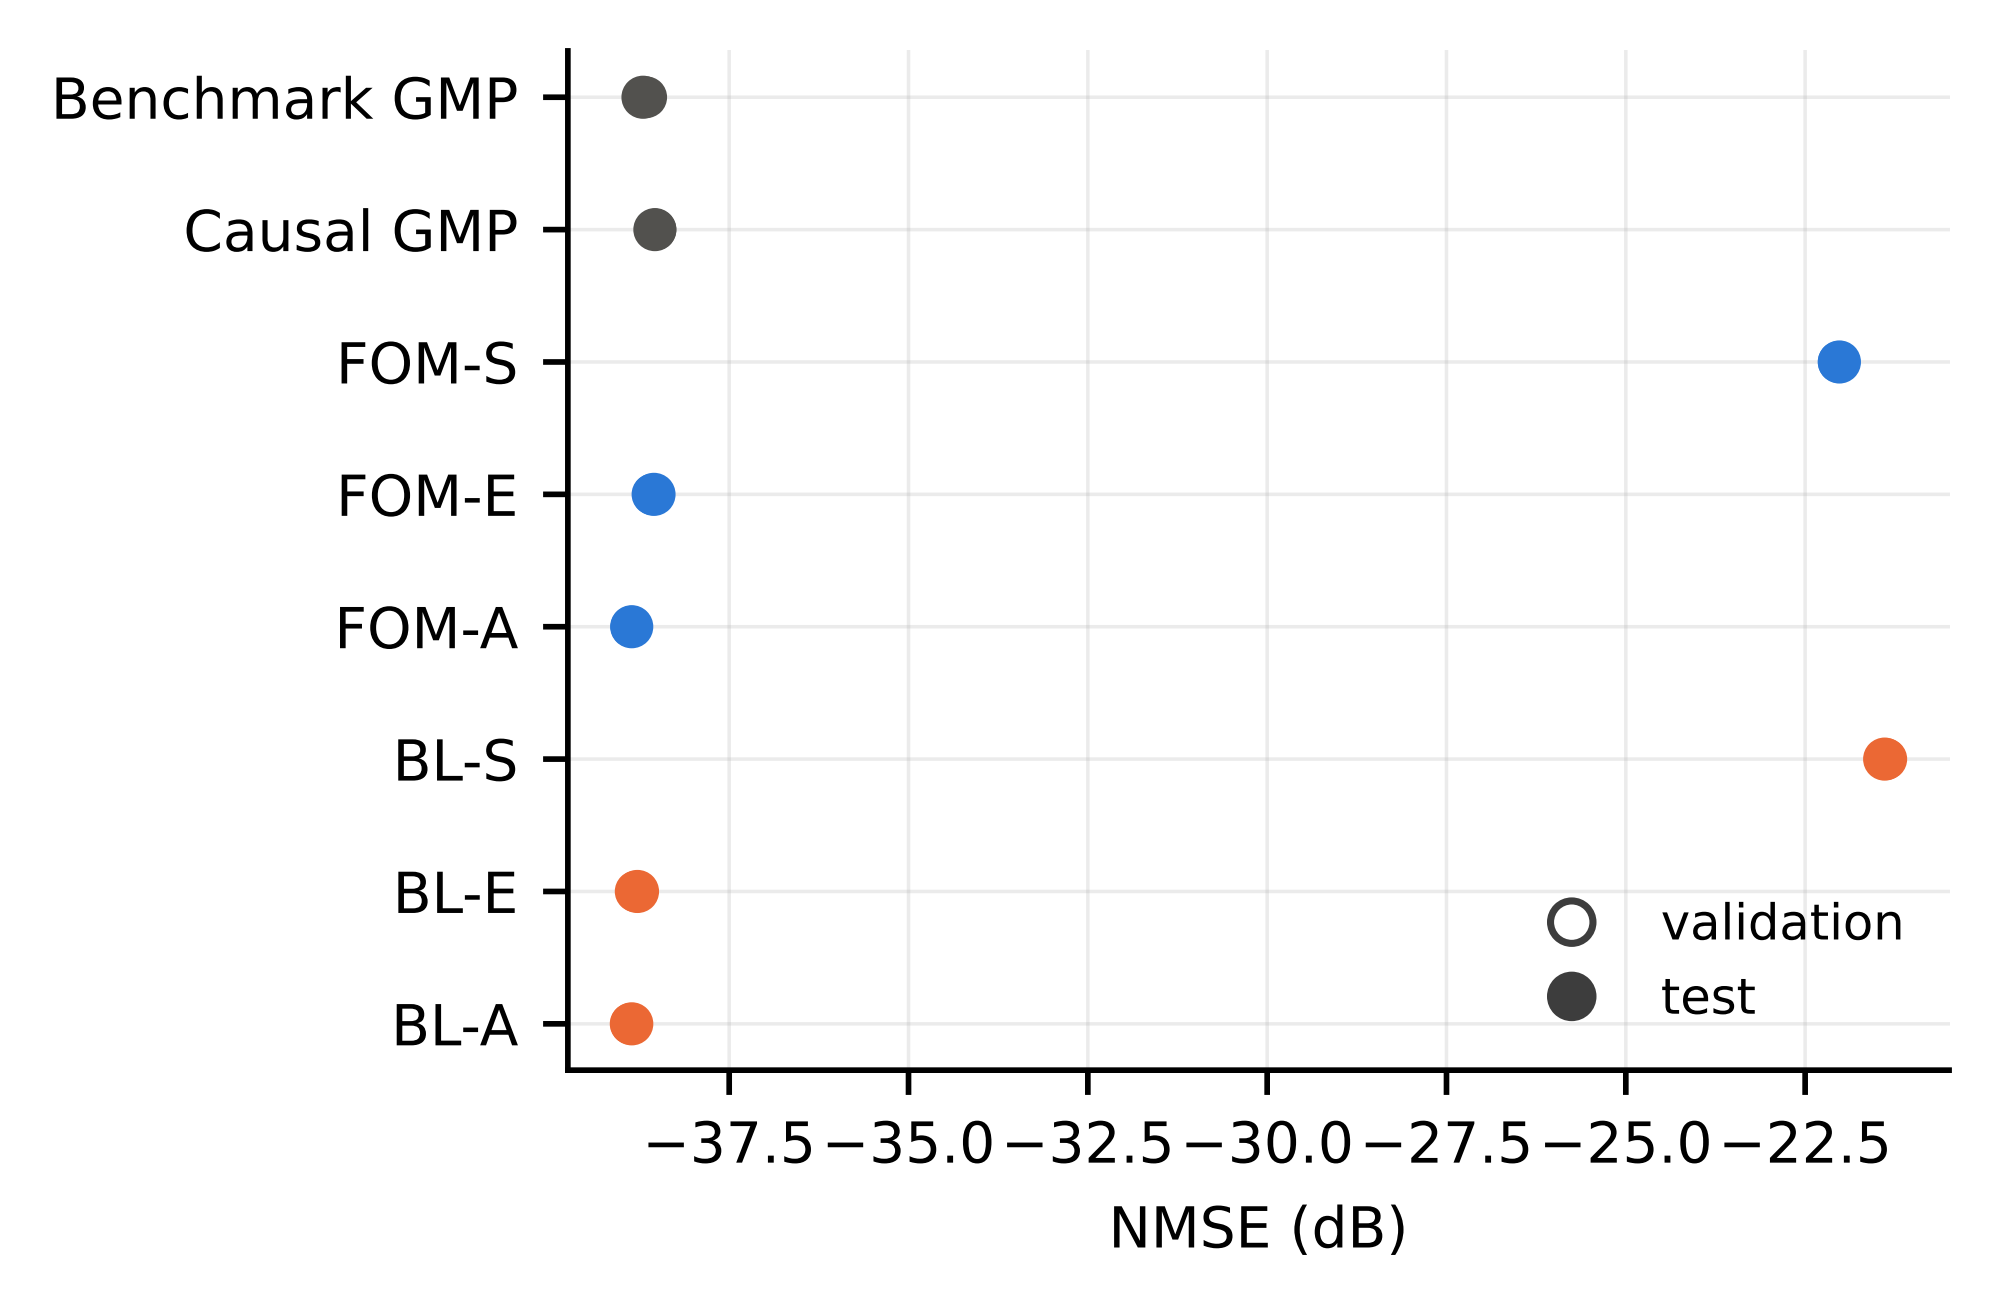
Benchmark GMP
Causal GMP
FOM-S
FOM-E
FOM-A
BL-S
BL-E
BL-A
validation
test
−37.5
−35.0
−32.5
−30.0
−27.5
−25.0
−22.5
NMSE (dB)