


CPET Aid kan tage fejl


Nøjagtighed: 75%

CPET Aid Resultat:

Maksimal ydeevne muligvis ikke opnået: $R < 1,1$

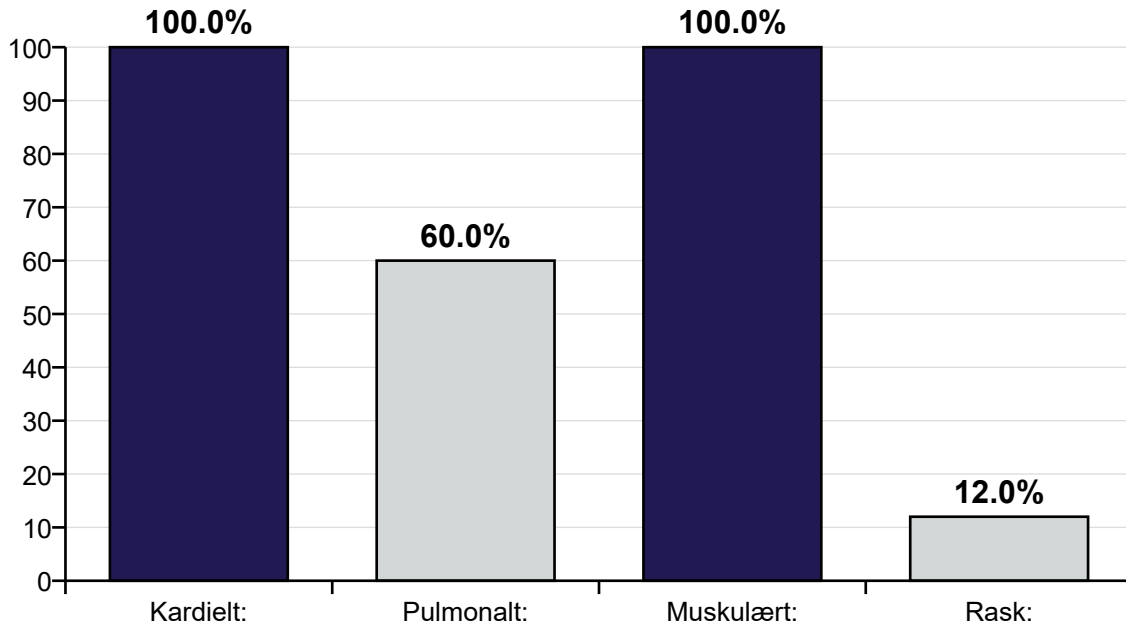

Et søjlediagram hvor sandsynlighederne for det pågældende fysiologiske system er det begrænsende for patienten.

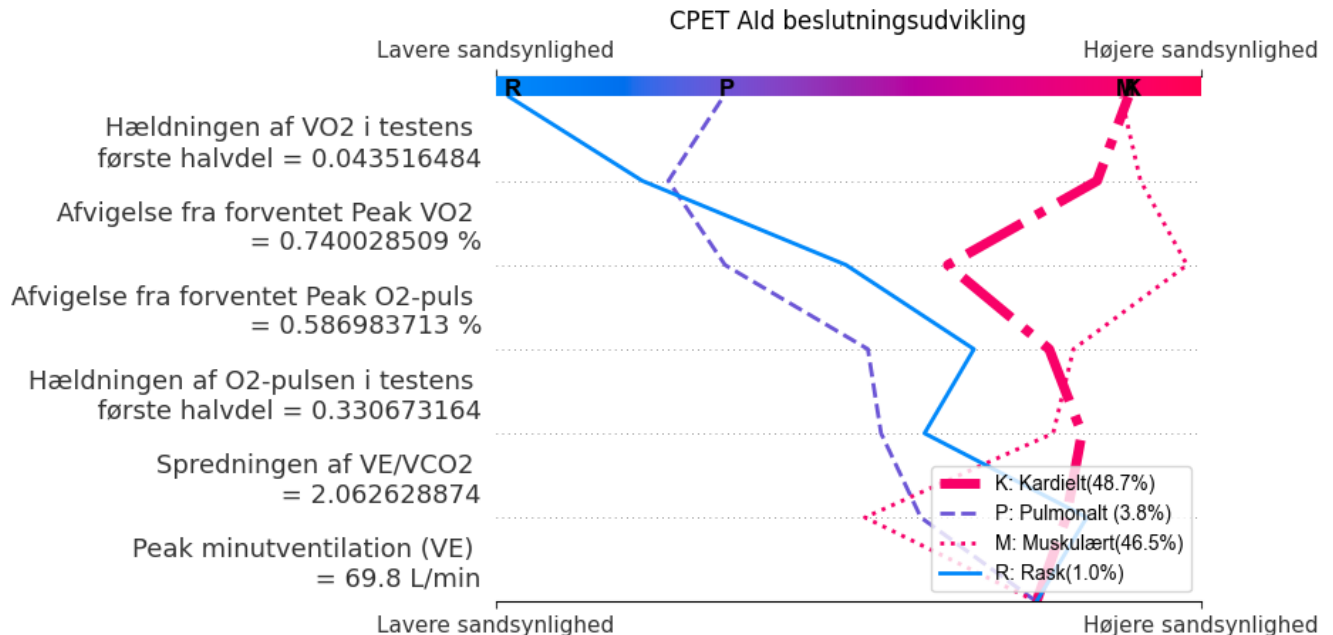

Et beslutsningsplot, der viser udviklingen af CPET Aids beslutning i takt med hver parametre har sin indvirkning. Disse parametre bør sammenholdes med det tilhørende 9-panel plot. De ovennævnte parametre er vægtet på baggrund af deres similaritet med tilsvarende patienter med de fire indikationer, og relaterer sig dermed ikke til de fysiologiske normalområder.