


CPET Aid kan tage fejl


Nøjagtighed: 75%

CPET Aid Resultat:

Maksimal ydeevne muligvis ikke opnået: $R < 1,1$

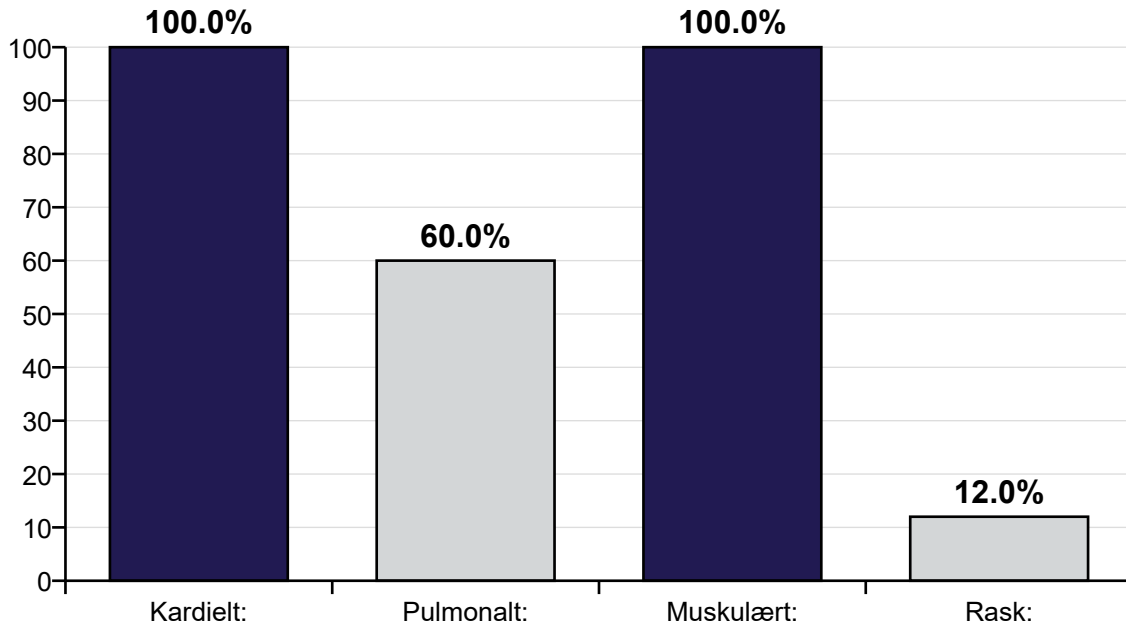

Et søjlediagram hvor sandsynlighederne for det pågældende fysiologiske system er det begrænsende for patienten.

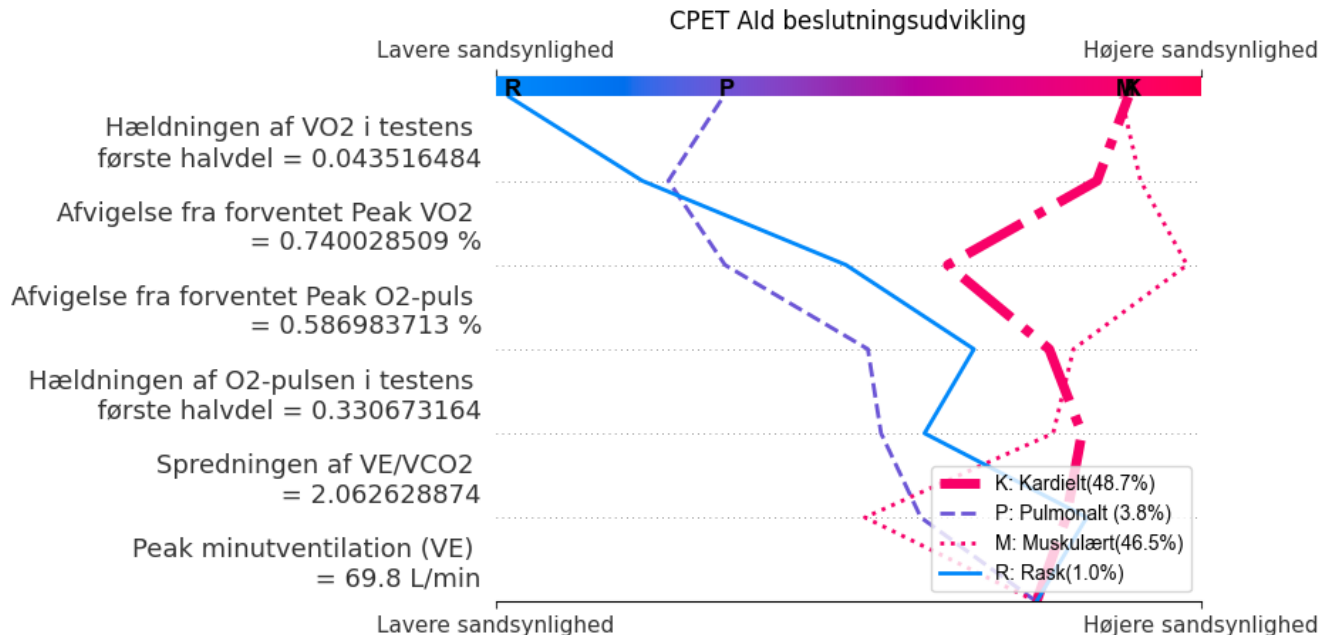

Et beslutsningsplot, der viser udviklingen af CPET Aids beslutning i takt med hver parametre har sin indvirkning. De ovennævnte parametre er vægtet på baggrund af deres similaritet med tilsvarende patienter med de fire indikationer, og relaterer sig dermed ikke til de fysiologiske normalområder