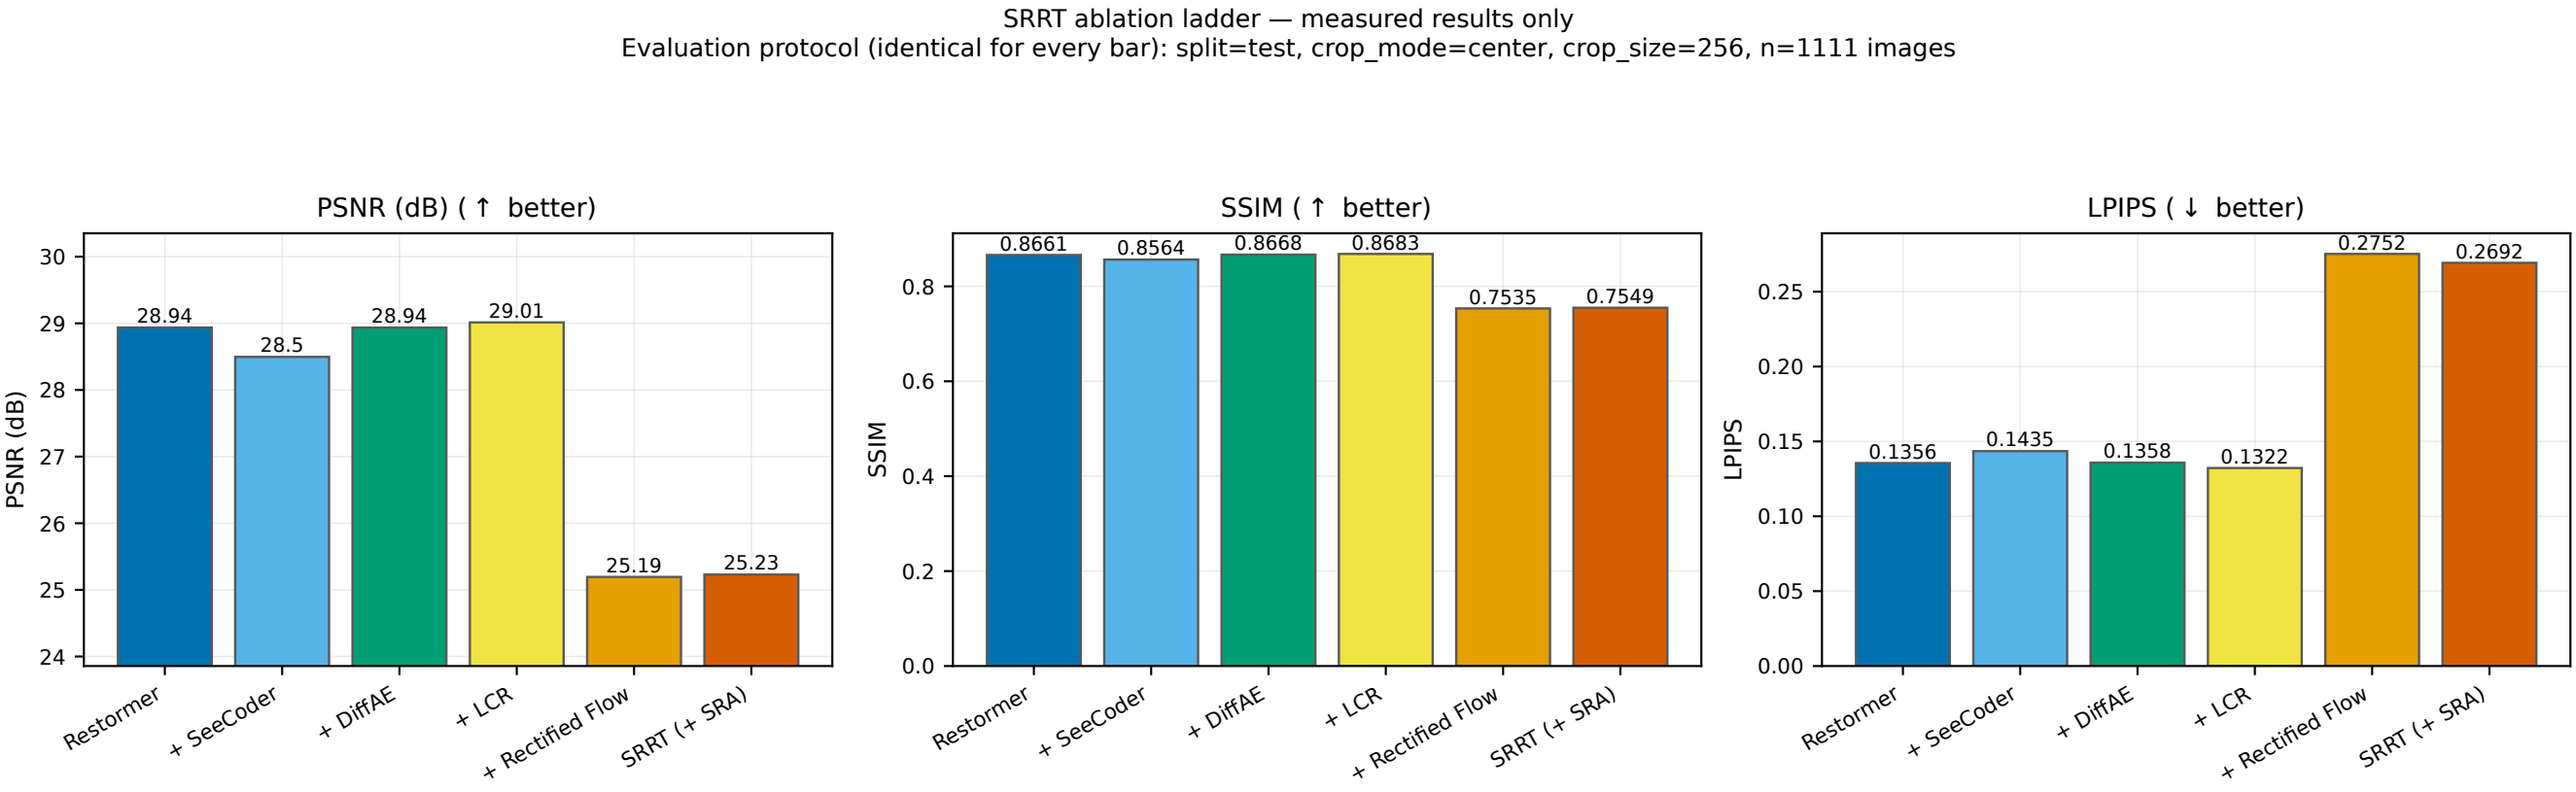
SRRT ablation ladder — measured results only
Evaluation protocol (identical for every bar): split=test, crop_mode=center, crop_size=256, n=1111 images
PSNR (dB) (↑ better)
PSNR (dB)
30
29
28
27
26
25
24
28.94
28.5
28.94
29.01
25.19
25.23
SSIM (↑ better)
SSIM
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.8661
0.8564
0.8668
0.8683
0.7535
0.7549
LPIPS (↓ better)
LPIPS
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.1356
0.1435
0.1358
0.1322
0.2752
0.2692
Restormer
+ SeeCoder
+ DiffAE
+ LCR
+ Rectified Flow
SRRT (+ SRA)