

MMS
Measurement Systems




Hombre Fecha/hora de investigación: 07/03/1999 Número de investigación: 50
Clínica privada.

Fecha/hora de impresión:
Flowmaster:

07/16/95 / 10:17

07 OF MR11

**RODRÍGUEZ
RUBIO**

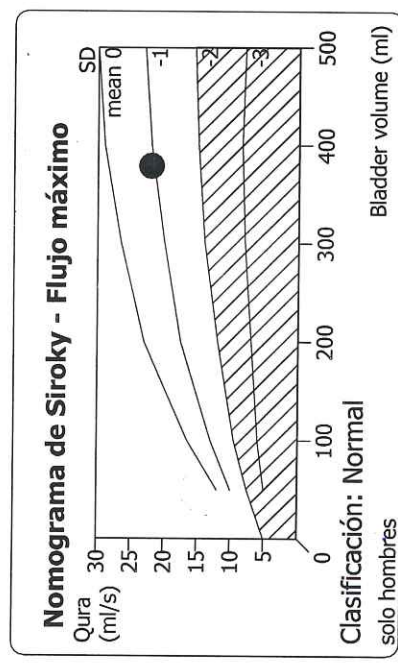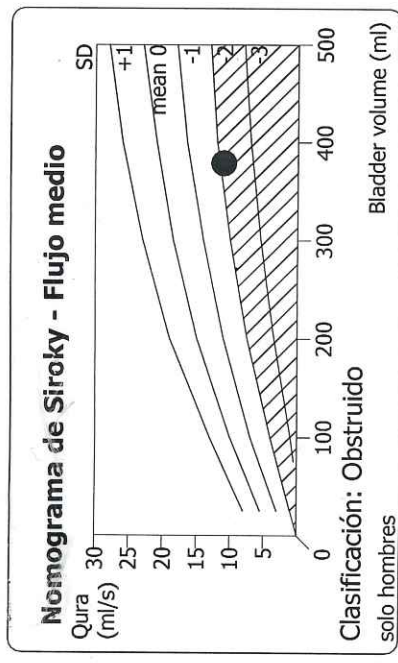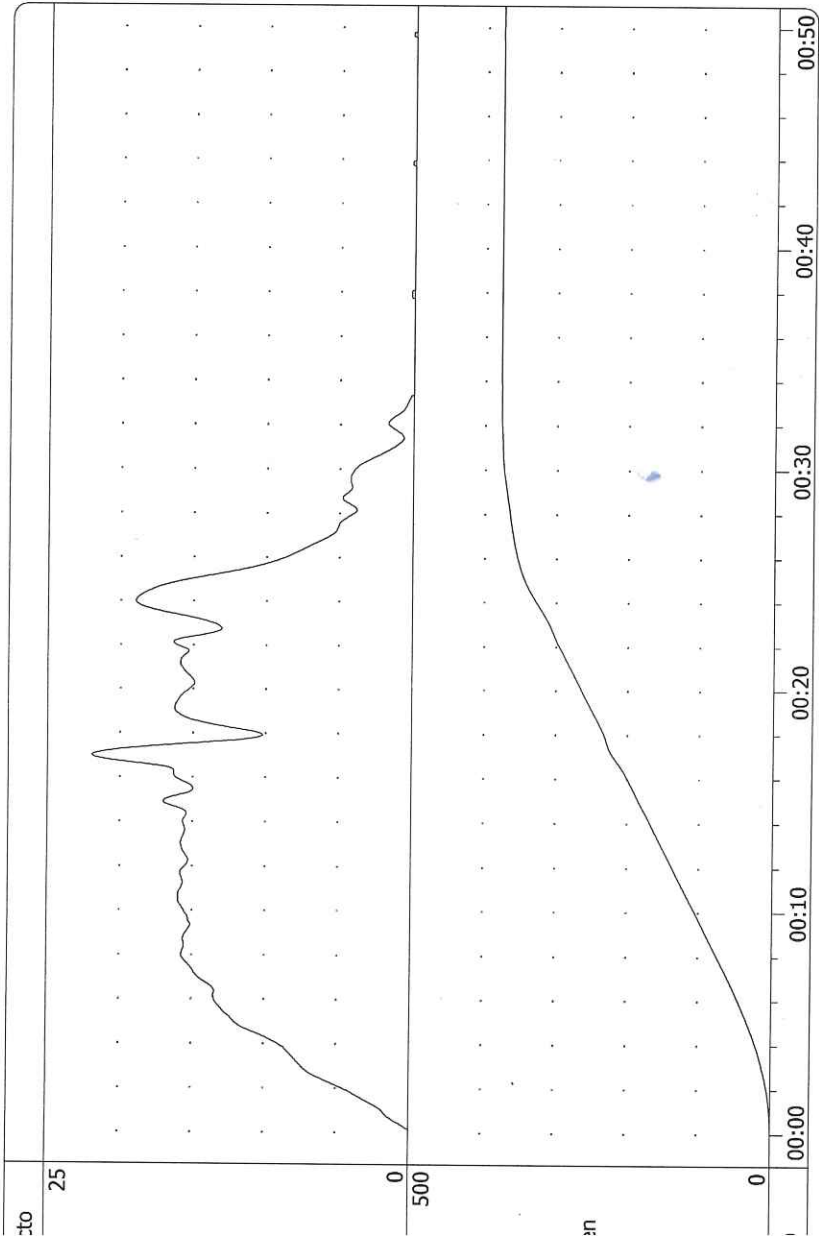

ultados

velocidade média	: 11,2 ml/s
velocidade máxima	: 22,0 ml/s
tempo a fluxo máximo	: 16,8 s
tempo em vazio	: 379,0 ml
tempo de fluxo	: 33,0 s
tempo de vazio	: 33,0 s
intervalos	: 1

Comentarios